

**«Система офтальмологическая хирургическая Centurion Vision System с принадлежностями»,
производства Alcon Laboratories, Inc., США**



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

I. Система офтальмологическая хирургическая Centurion Vision System,

базовая комплектация:

1) Консоль.



2) Защитный чехол.





4) Защитный чехол на столик






Информация получена с официального сайта


зору в сфере

Фед





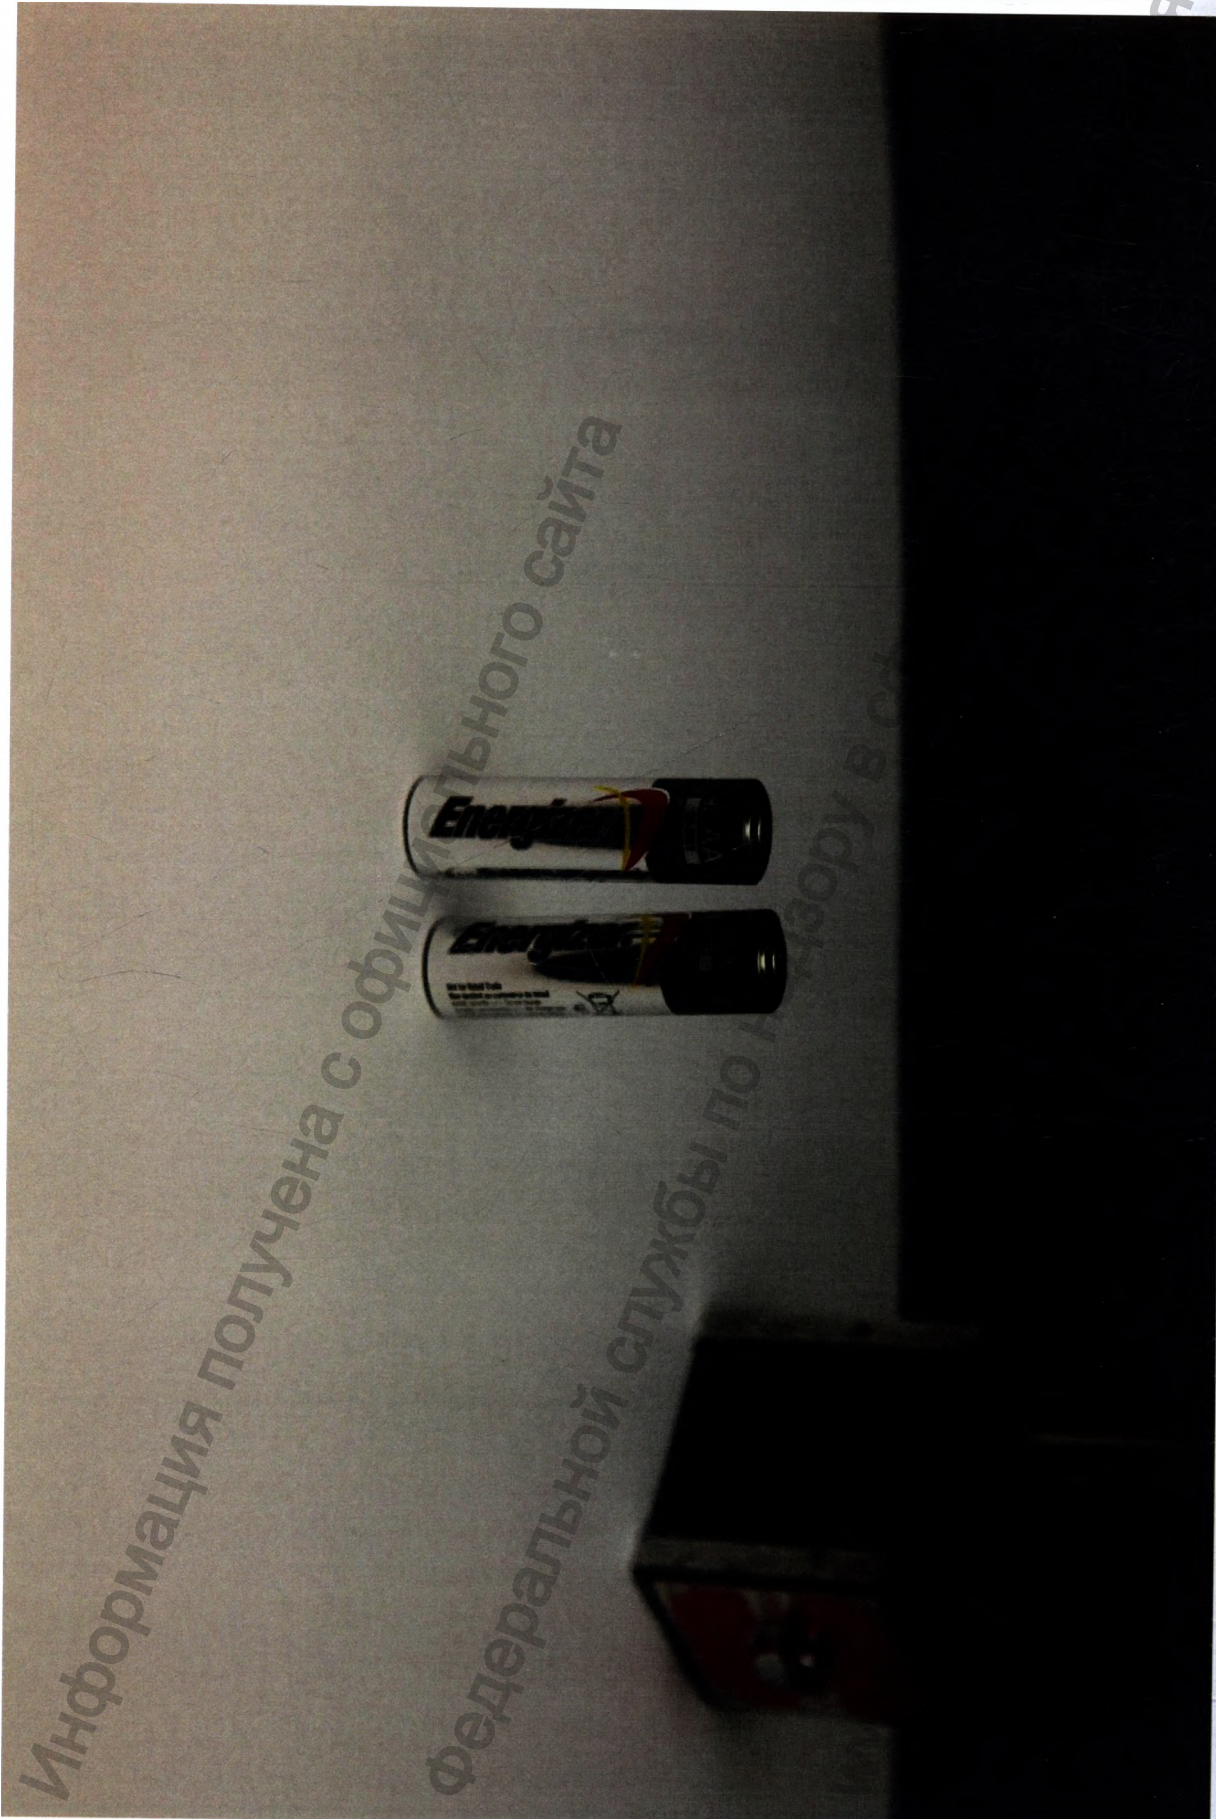

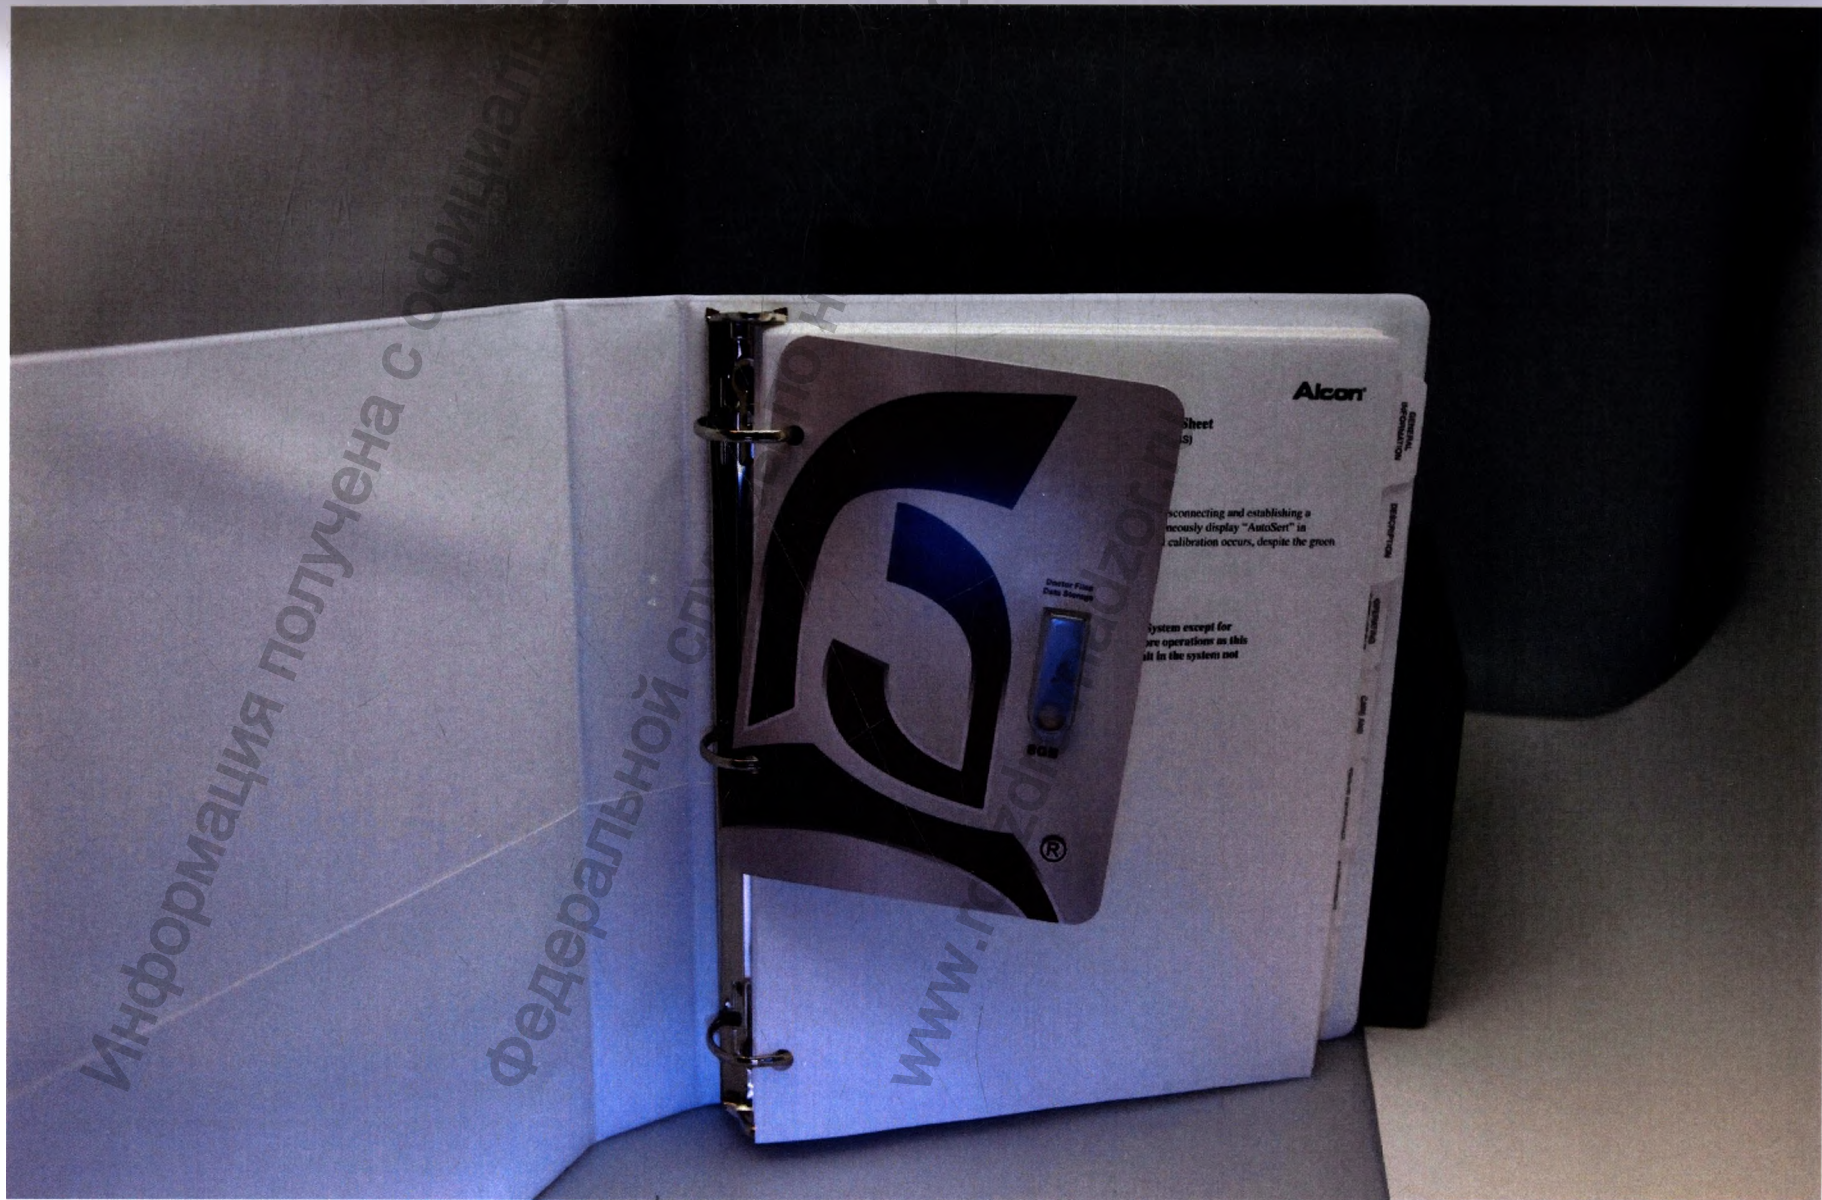

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии

www.gost.ru





мешком для сбора жидкости, чехол (на фото не представлен) (фотография 2)



II. Система офтальмологическая хирургическая Centurion Vision System, функциональная комплектация:

1) Консоль.



2) Защитный чехол.





Информация по...

4) Защитный чехол на стюлик



Информация по... с офф... тально...
Фе






Информация получена с официального сайта

зору в сфере




8) Батарейки для пульта дистанционного управления ЛА – 2 шт.



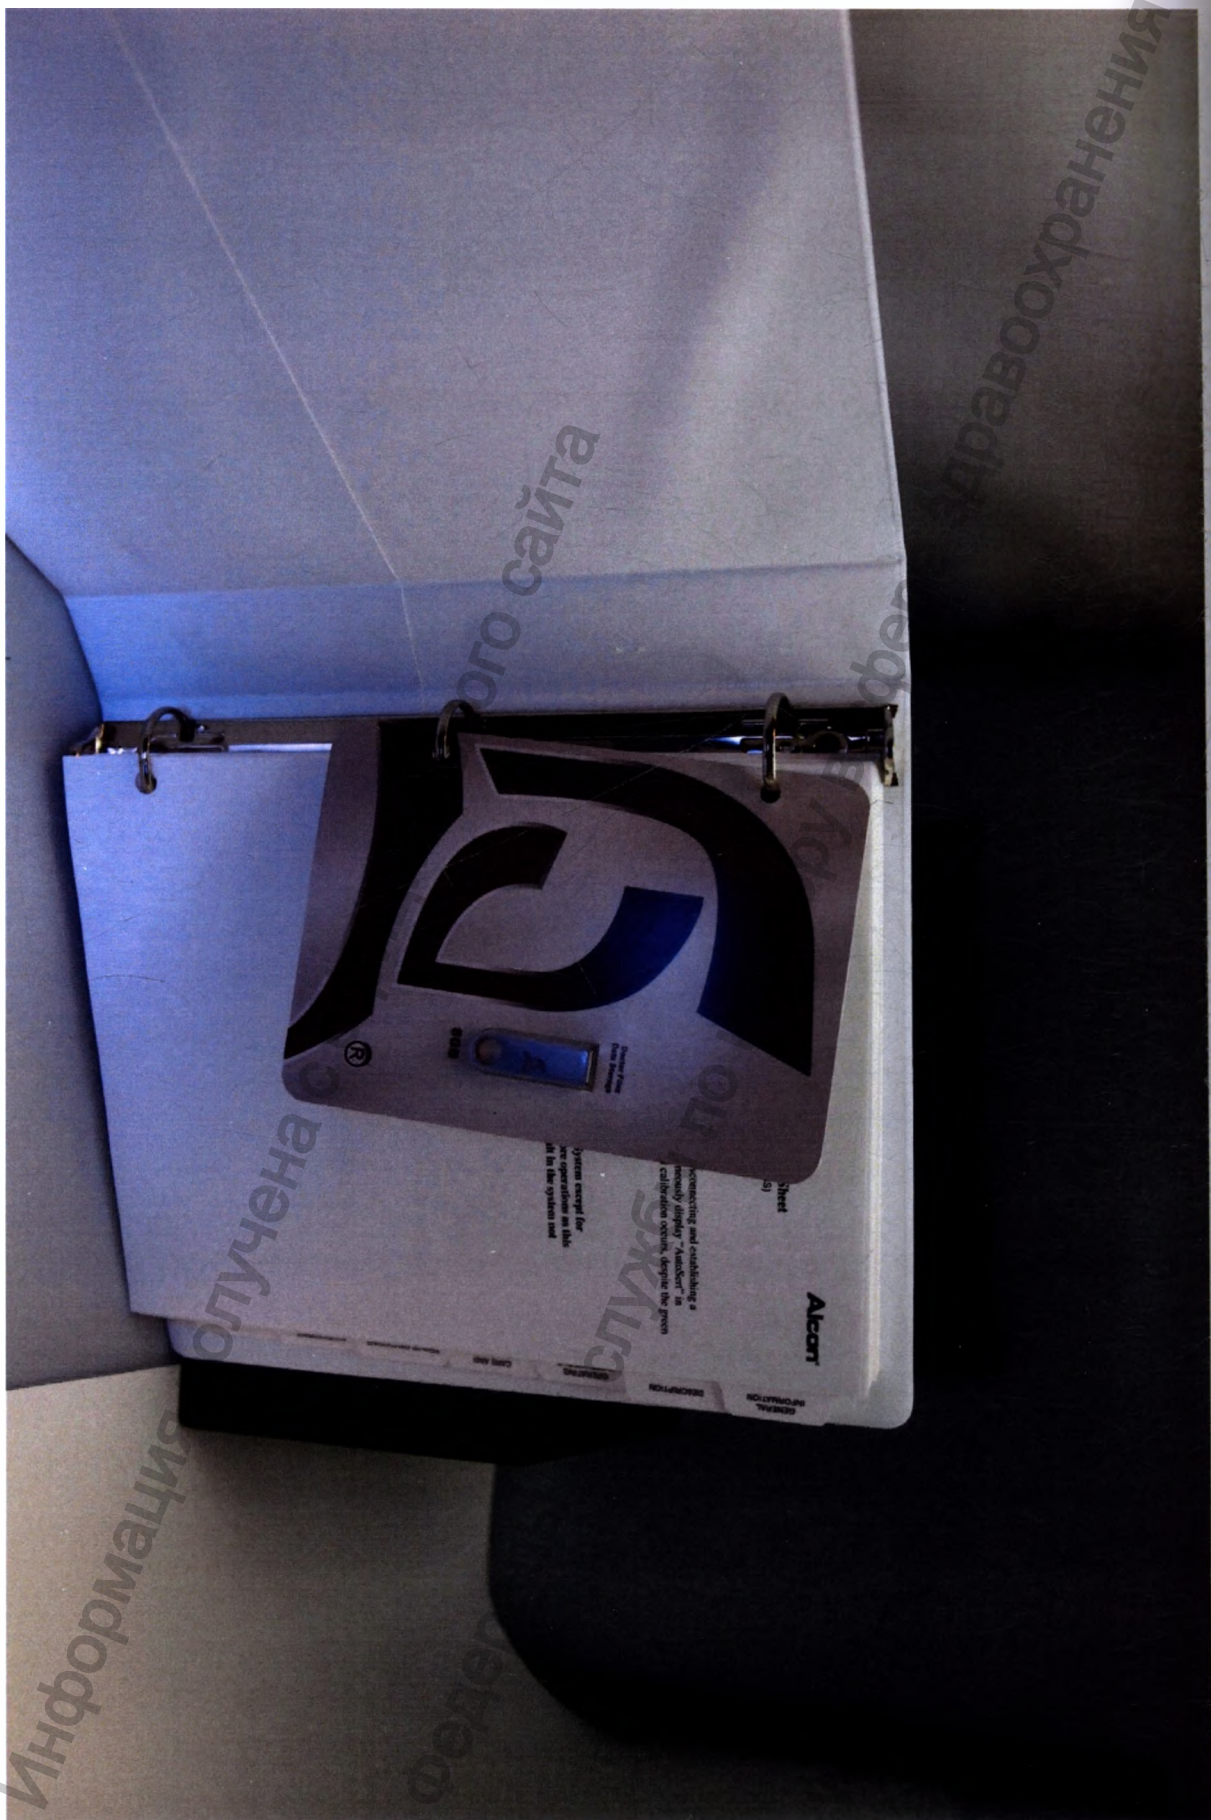



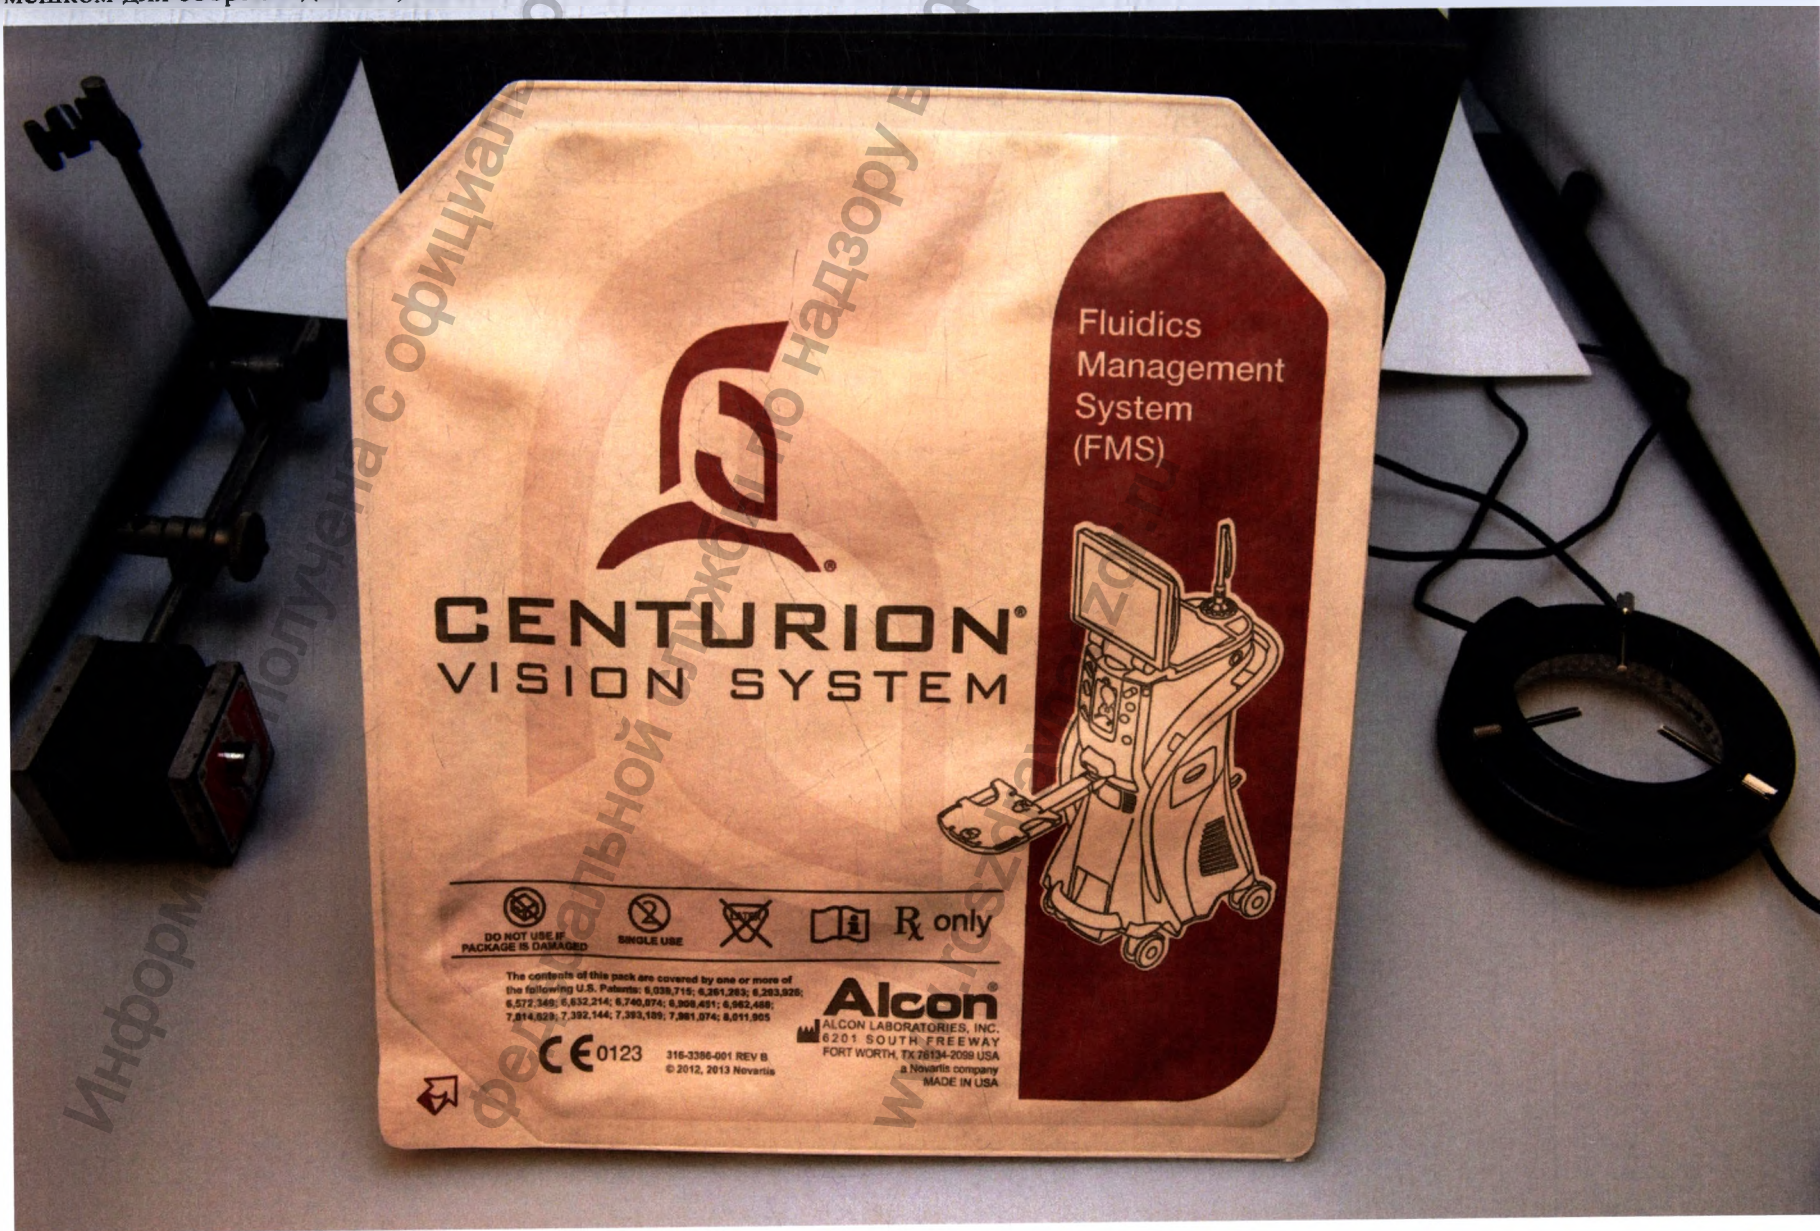

DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED SINGLE USE Rx only

The contents of this pack are covered by one or more of the following U.S. Patents: 6,938,715; 6,291,283; 6,283,828; 6,572,348; 6,832,214; 6,740,874; 6,908,451; 6,982,488; 7,814,828; 7,382,144; 7,393,189; 7,881,874; 8,011,905


Alcon
ALCON LABORATORIES, INC.
6201 SOUTH FREEWAY
FORT WORTH, TX 76134-2098 USA
a Novartis company
MADE IN USA

CE 0123 316-3396-001 REV B
© 2012, 2013 Novartis

мешком для сбора жидкости, чехол (на фото не представлен) (фотография 2)



Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

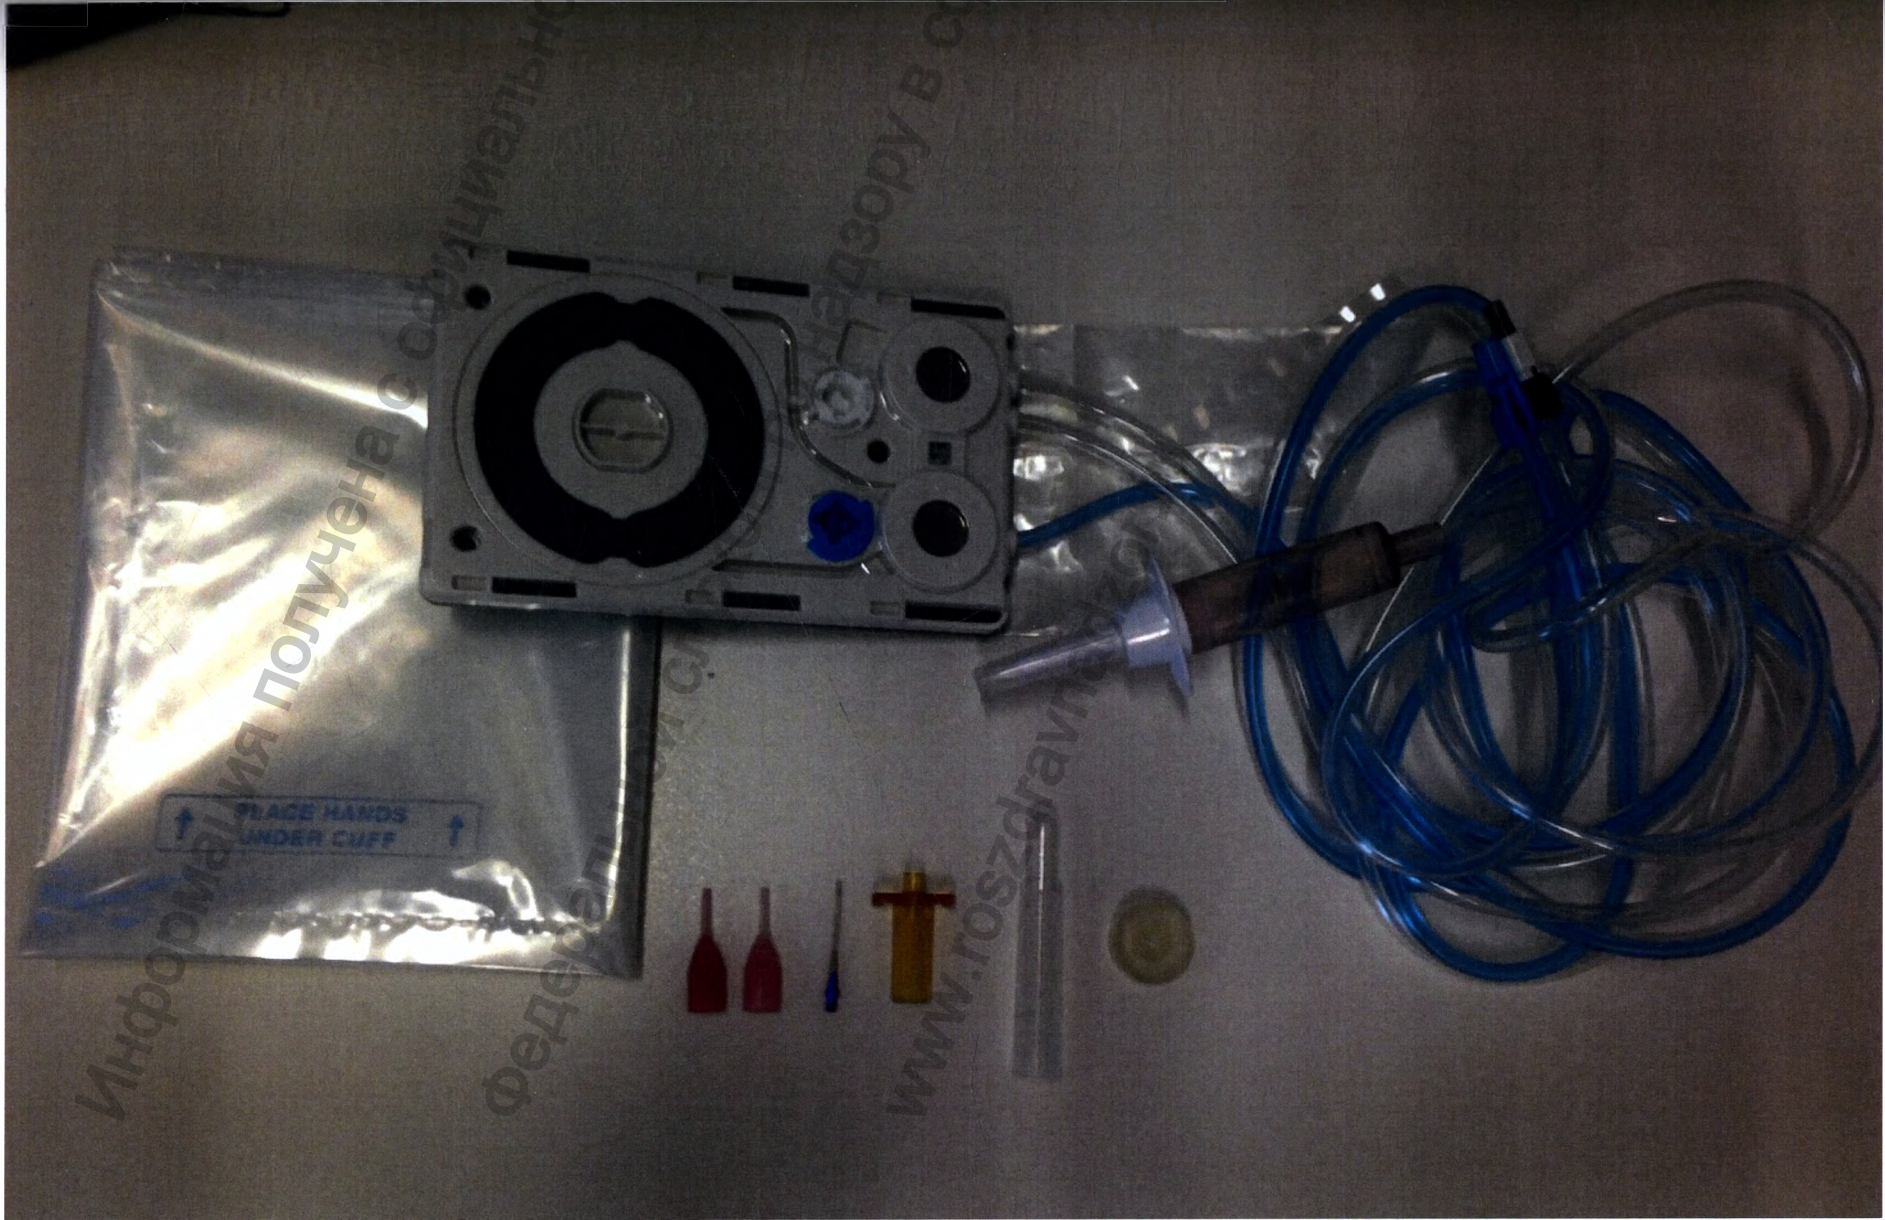

Система офтальмологическая хирургическая Centurion Vision System multifunctional platform:

1) Console.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2) Защитный чехол.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



Информация получена из официального сайта

Информаци

Федеральн

www.gosz

Правоохранения






Информация получена с официального сайта


вору в сф

Фед





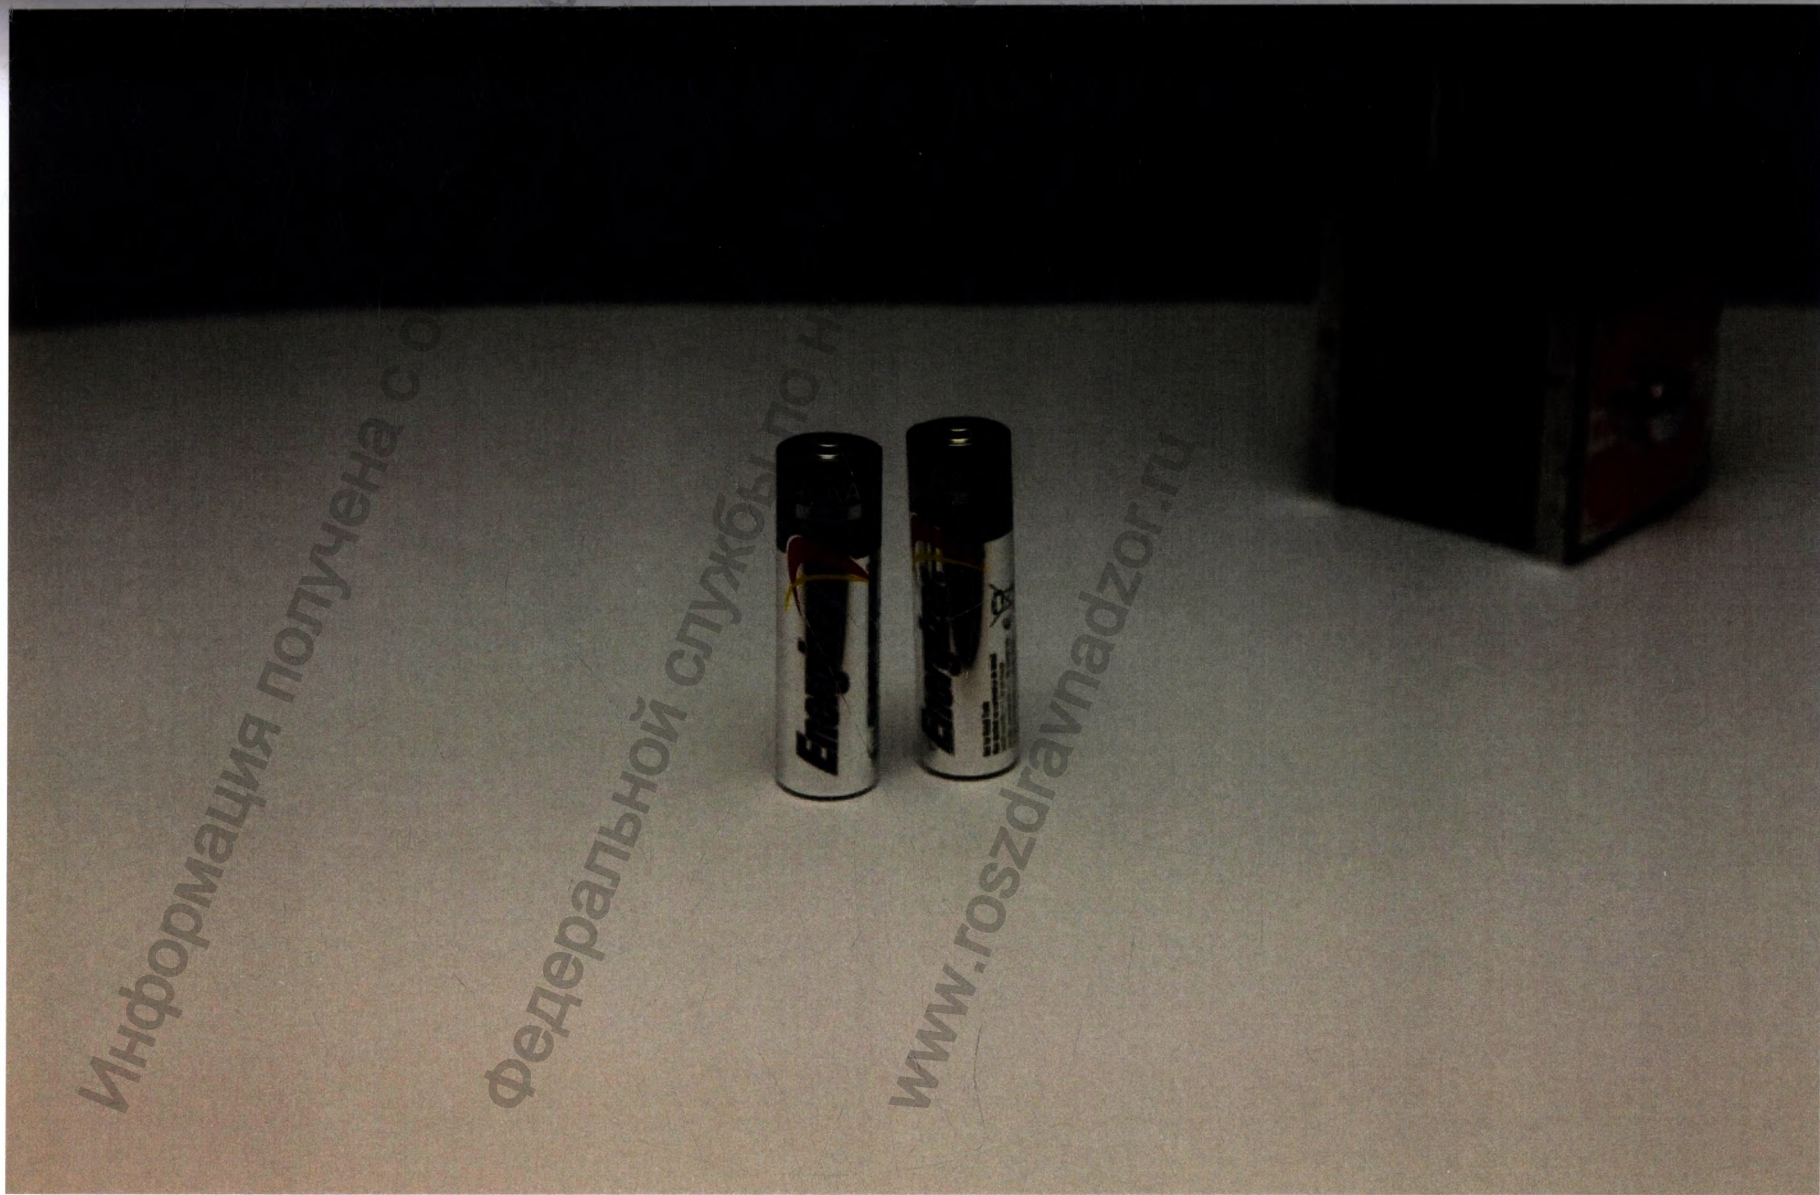

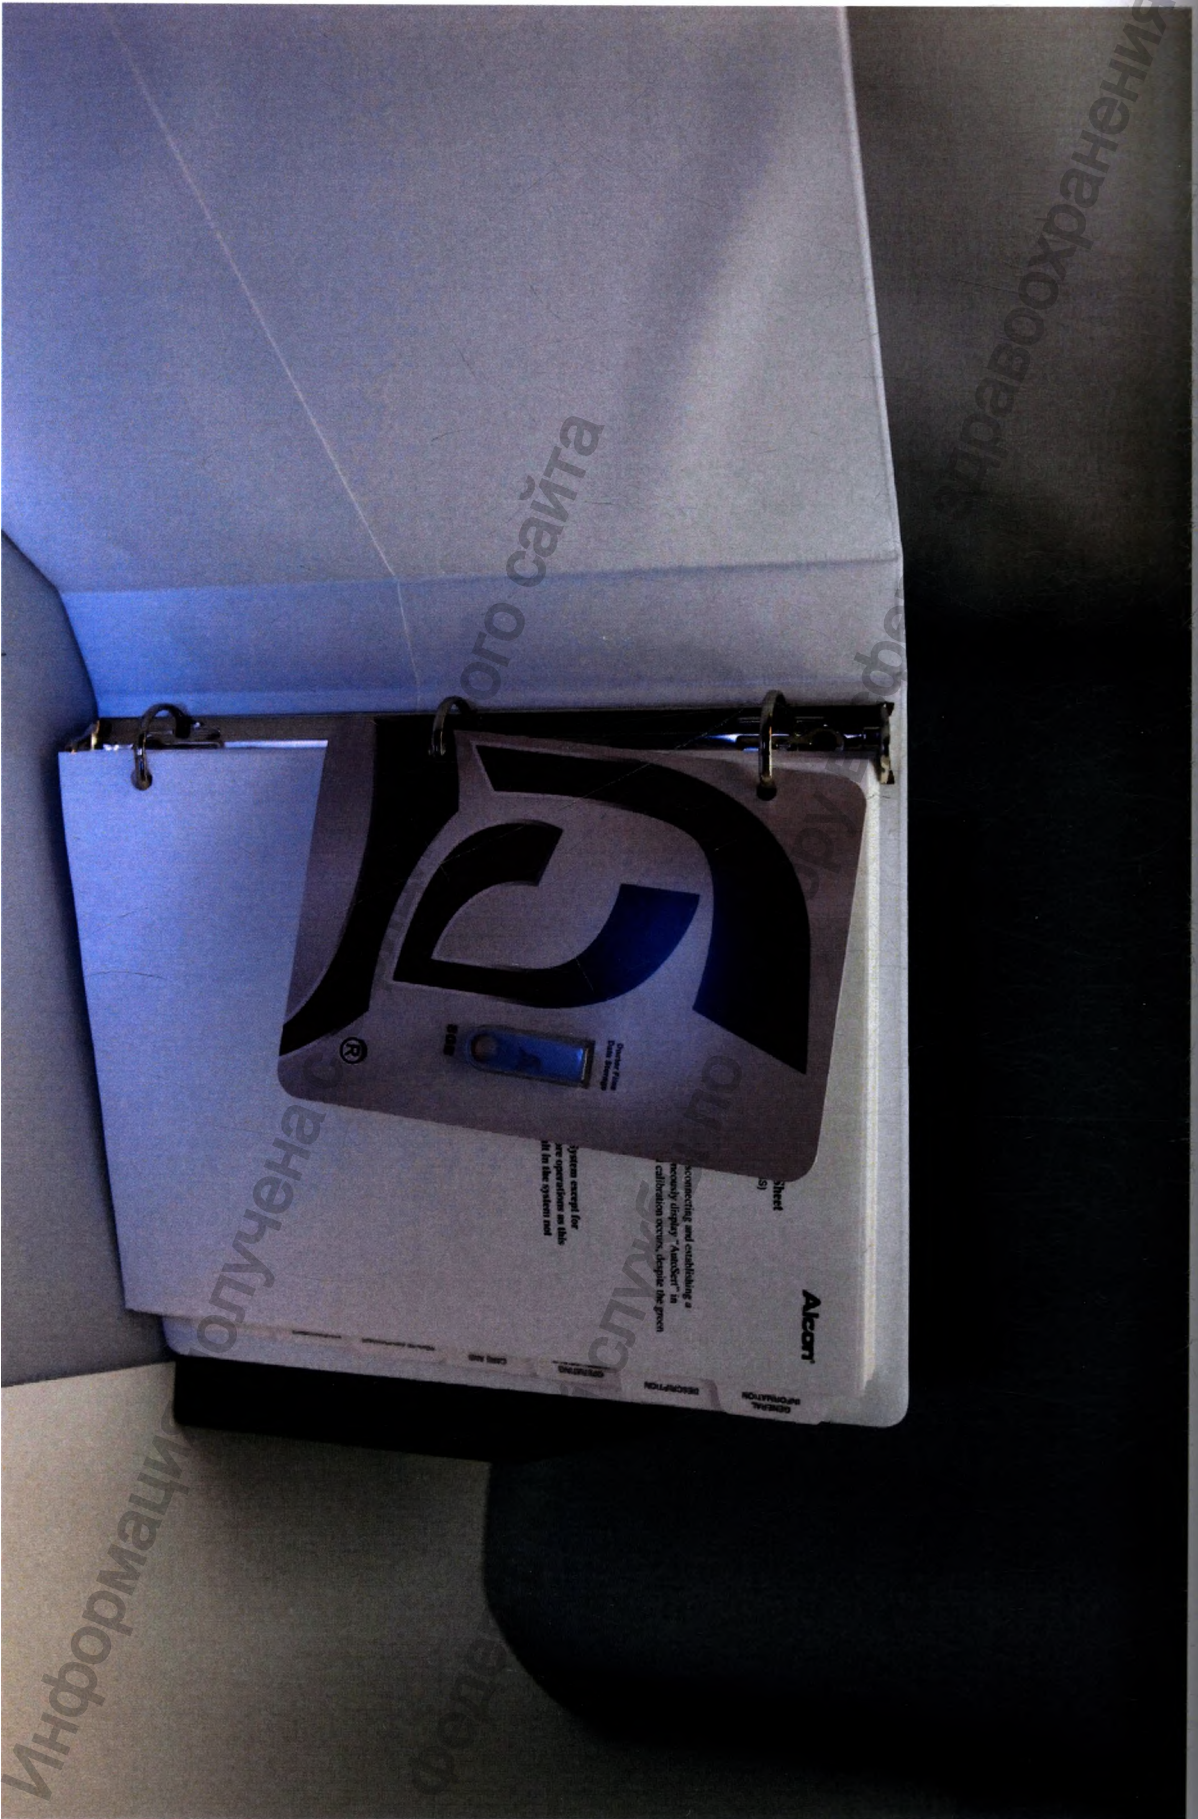



11) Набор базовый — 1 шт. в составе кассета с ирригационно-аспирационным пюбингом, ирригационной системой, ирригационным адаптером и мешком для сбора жидкости, чехол




11) Набор базовый – 1 шт. в составе кассета с ирригационно-аспирационным тобином, ирригационной системой, ирригационным адаптером и мешком для сбора жидкости, чехол (на фото не представлен) (фотография 2)




Информация получена с официального сайта
Федерального центра
надзора

12.-15.). Наборы для фактоэмульсификации с принудительной ирригацией Active — 6 шт, в составе кассета с ирригационно-аспирационным пюбнгом, ирригационной системой, ирригационным адаптером и мешком для сбора жидкости, чехол, инфузионные сливы- 2 шт, тест-камера, ключ для игл

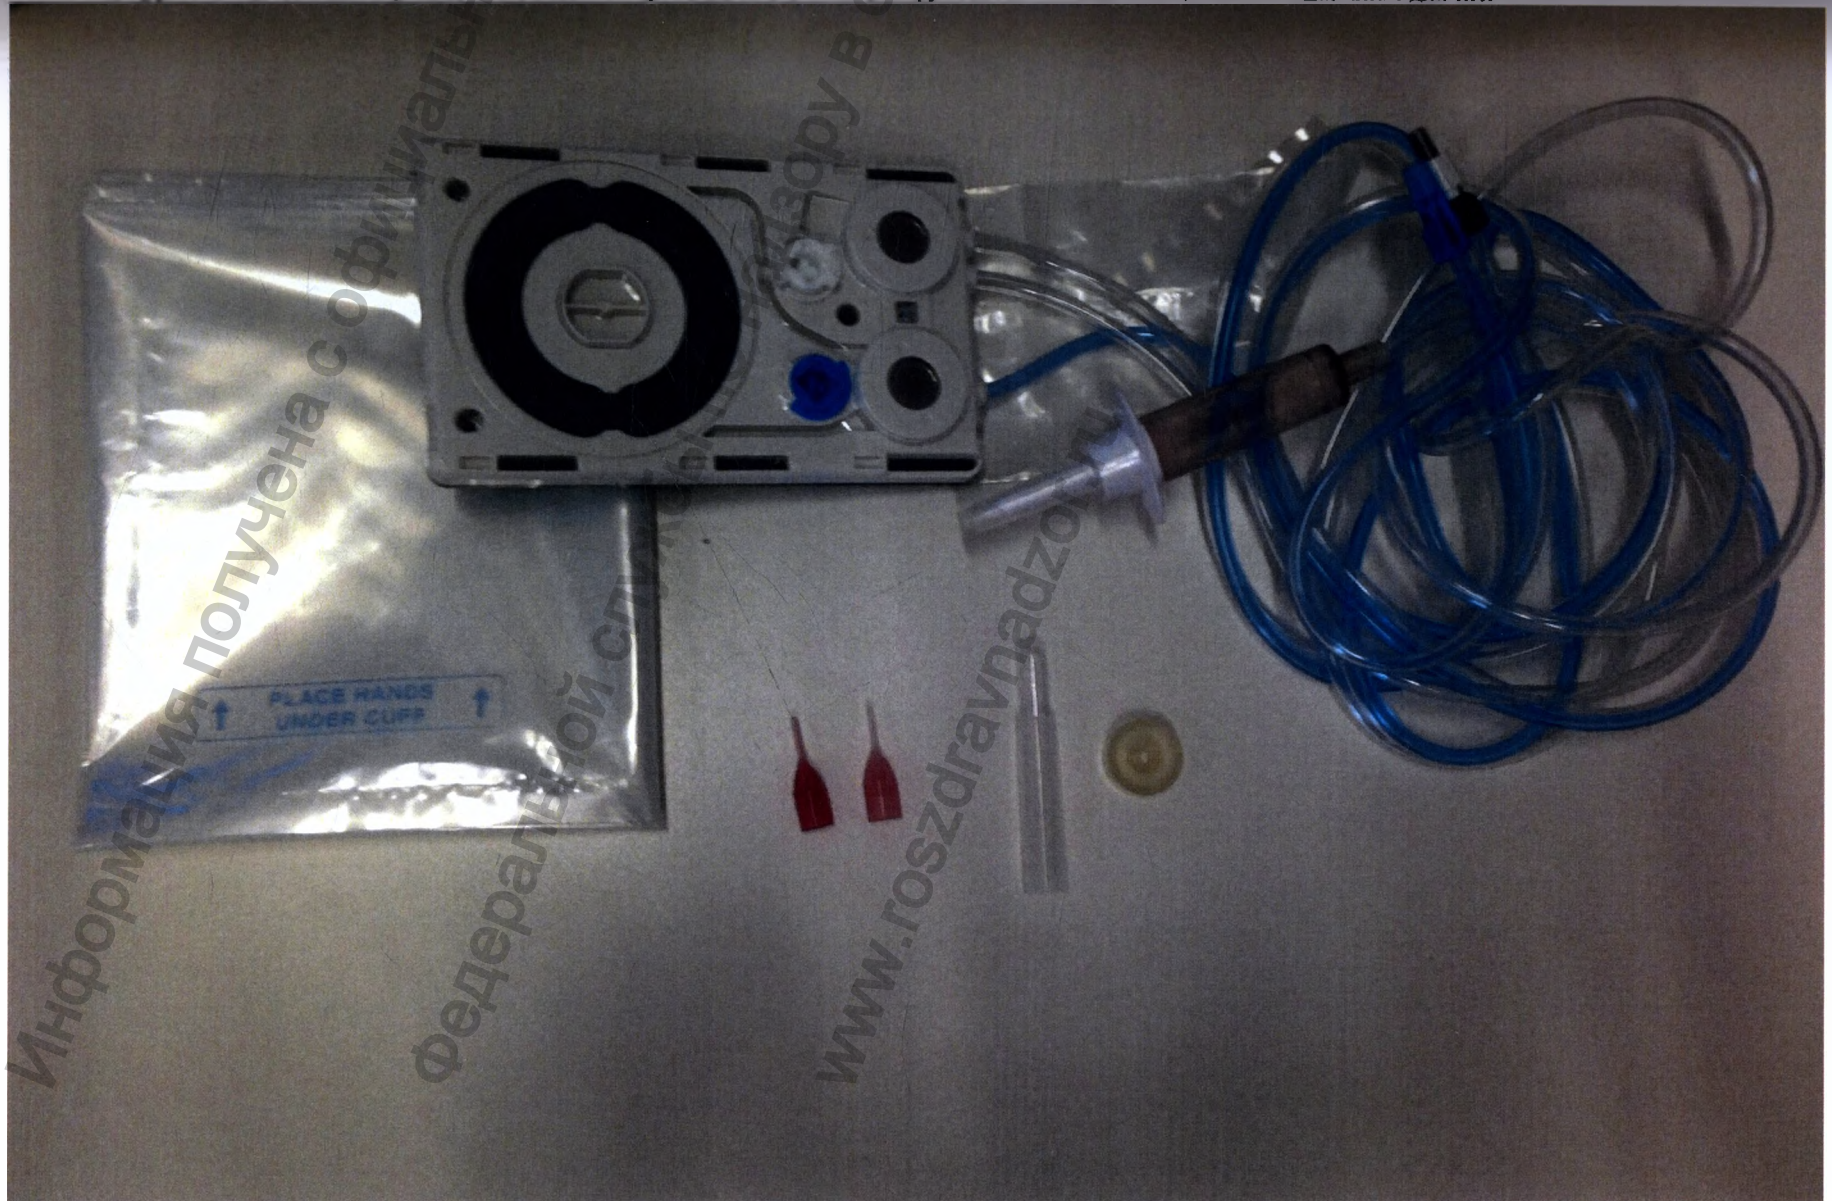

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdraznadzor.ru

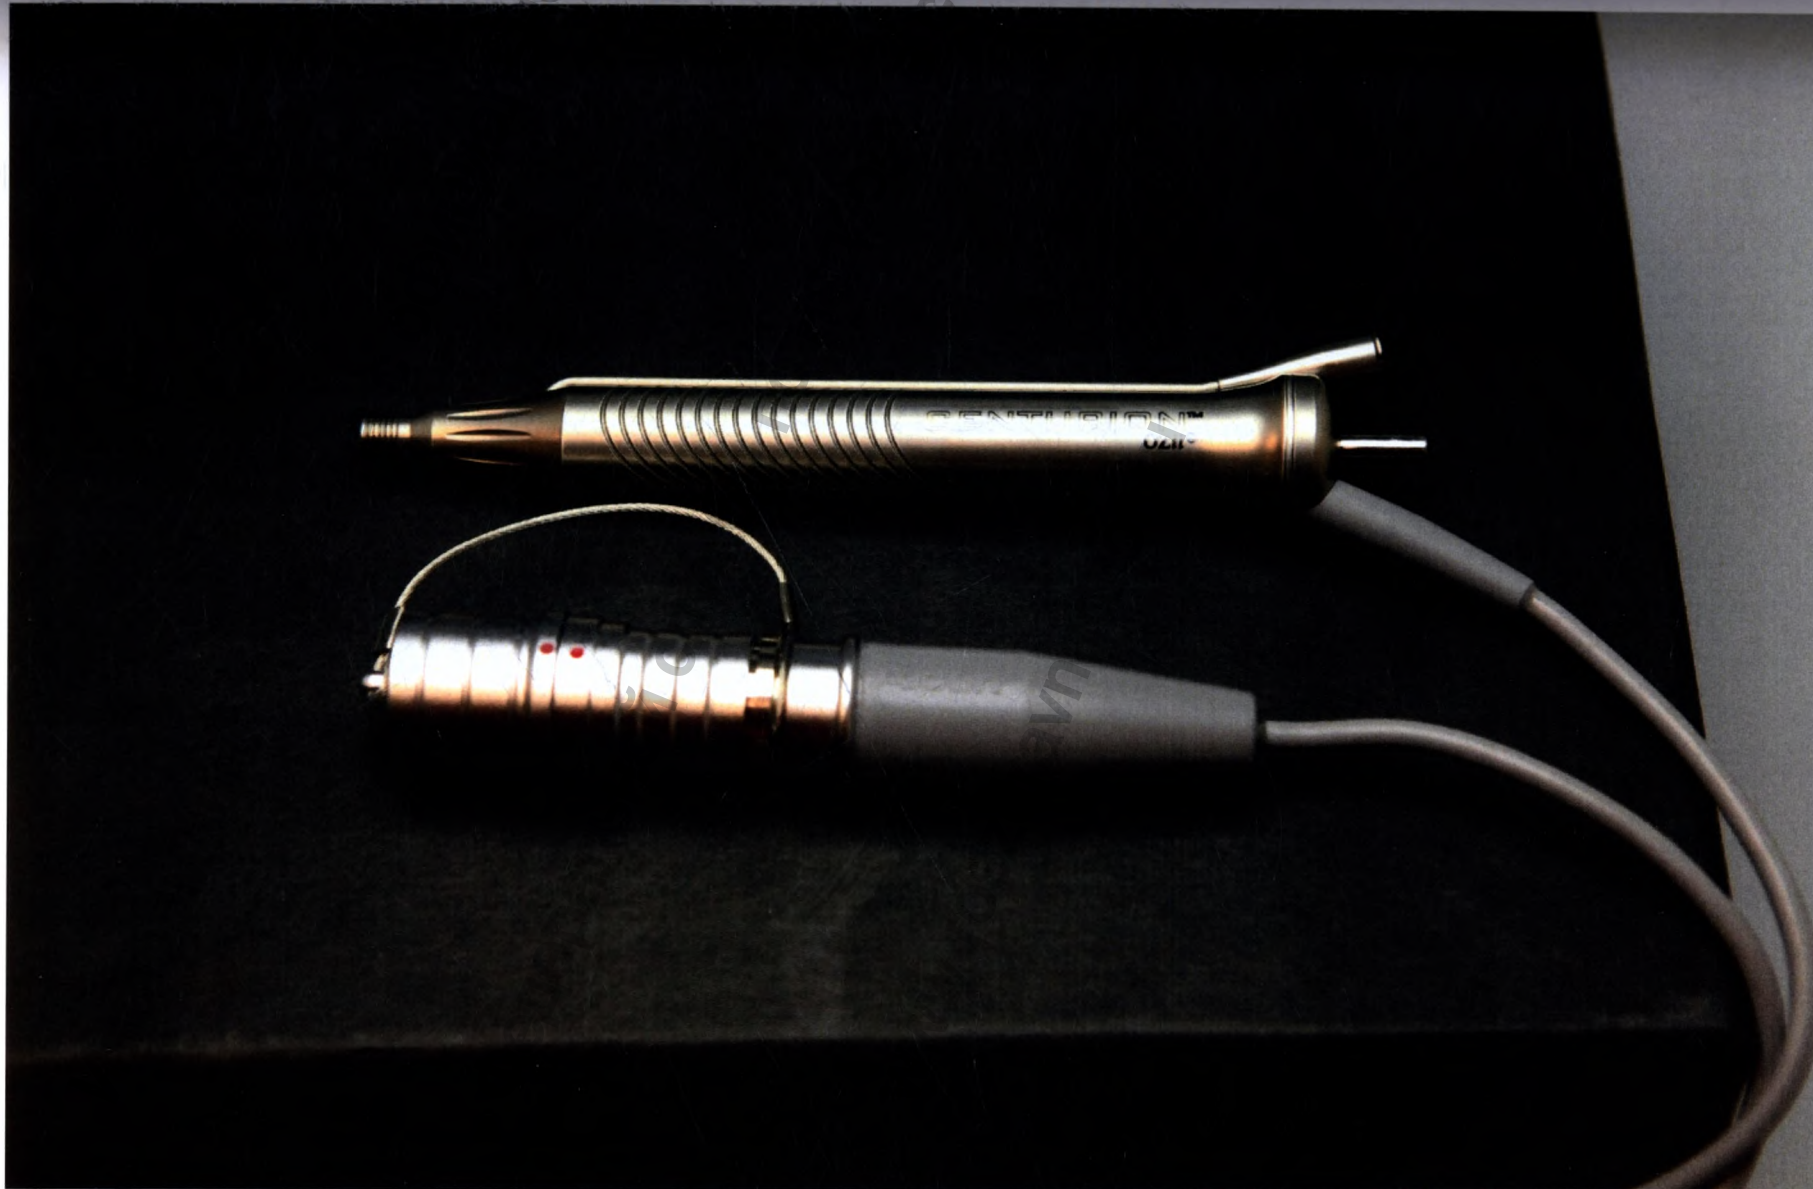







Информация получена с сайта
Федеральной службы по надзору
www.gor.gov.ru



Информация получена с оо


Федеральной службы по на

www.goszdravnadzor.ru





27) Наконечники для ирригации-аспирации с силиконовым покрытием, – 4 шт

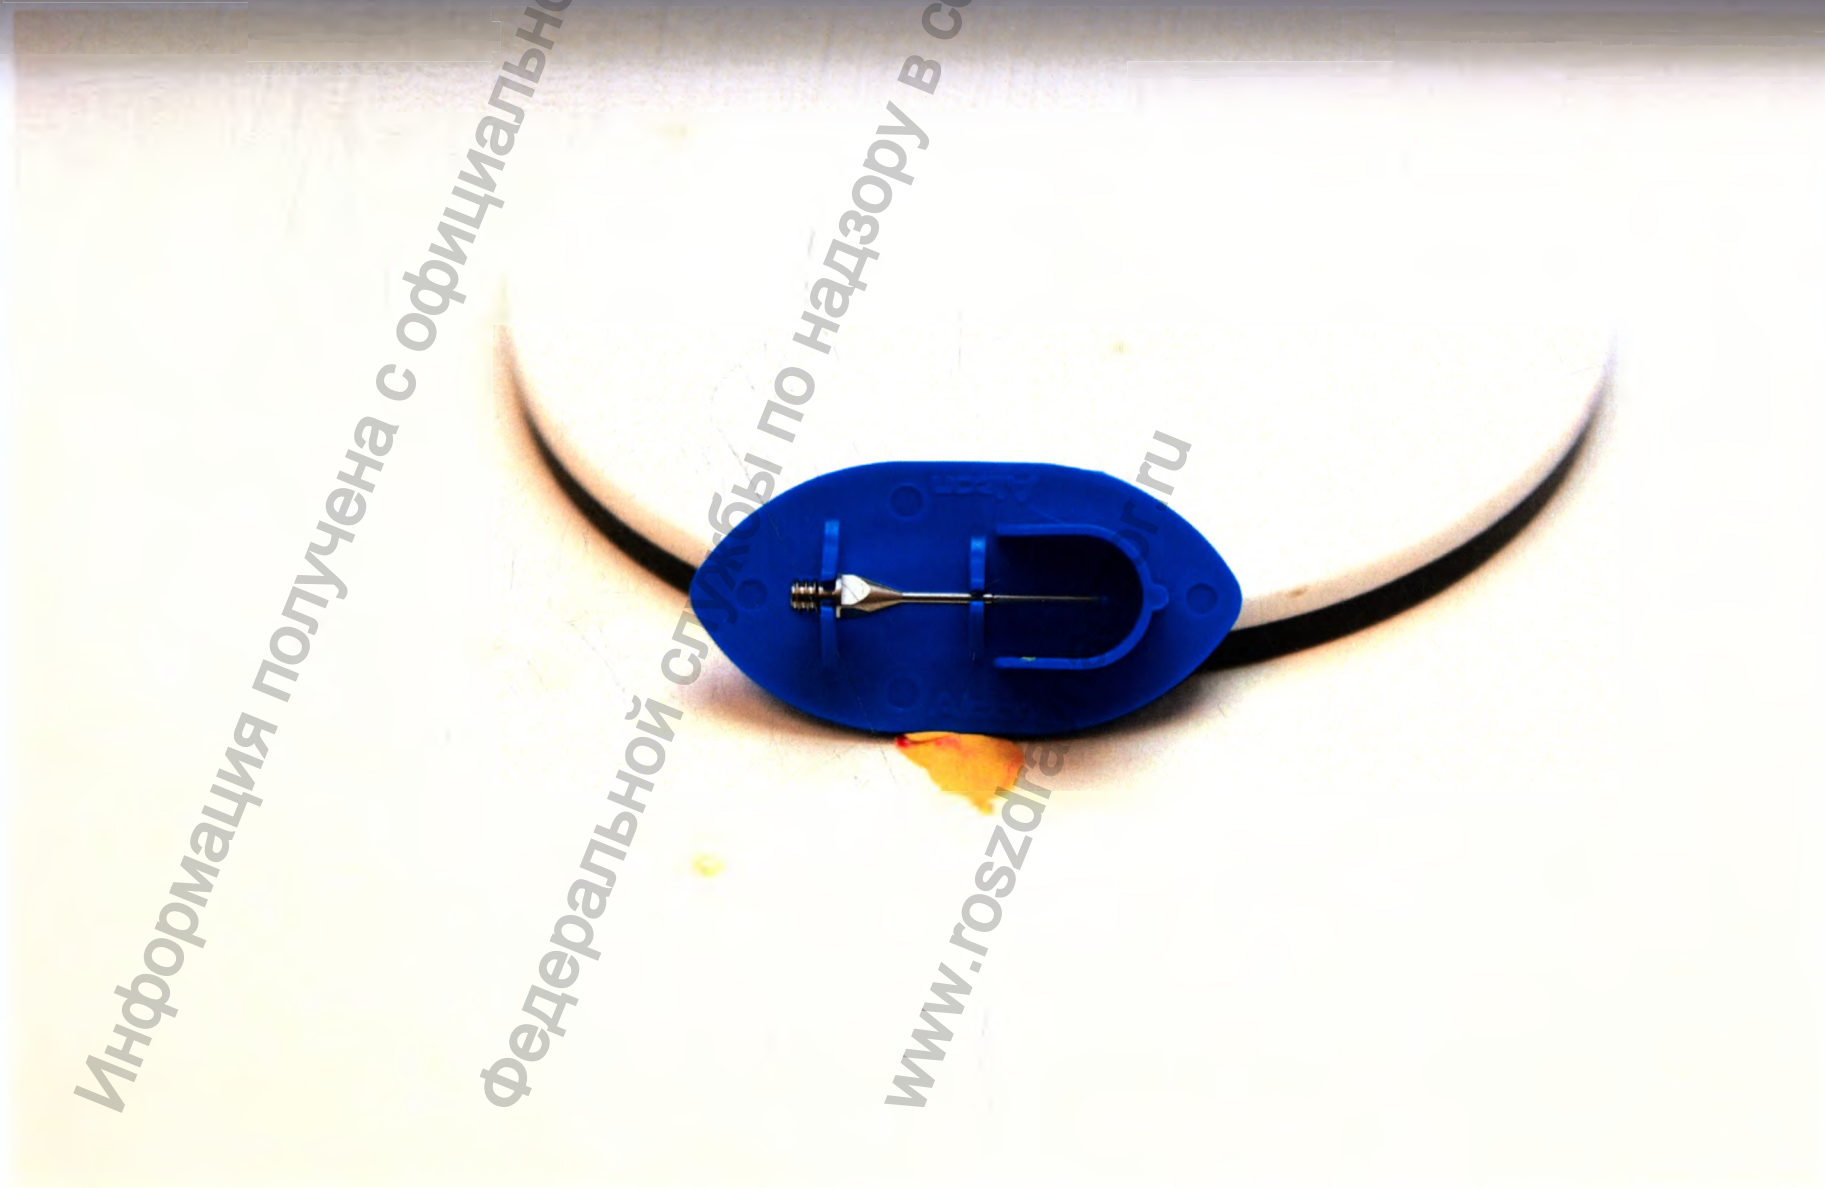





Информация получена с официально-

Федеральной службы по надзору в с-

www.goszdramnadzor.ru



Информация получена с официального
Федеральной службы по надзору в сф
www.gosdraznadzor.ru





Информация получена с сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdrazhnadzor.ru



1. Принадлежности.
1. Защитный чехол.





Информация получена

ального

сф







Информация по...

Федеральное...

www.goszavmudor.ru



Информация получена с официального сайта



CENTURY
VISION SYSTEM

DANGER: RISK OF EXPLOSION IF USED IN THE PRESENCE OF FLAMMABLE ANESTHETICS.

DANGER: RISQUE D'EXPLOSION. NE PAS EMPLOYER EN PRESENCE D'ANESTHESIQUES INFLAMMABLES.

CAUTION: GROUNDING RELIABILITY CAN ONLY BE ACHIEVED WHEN EQUIPMENT IS CONNECTED TO AN EQUIVALENT RECEPTACLE MARKED HOSPITAL GRADE.

CAUTION: RISK OF BURNS AND FIRE - DO NOT USE NEAR CONDUCTIVE MATERIALS. RENEW ELECTRODE CABLES UPON EVIDENCE OF DETEIORATION.

OUTPUT	DIATHERMY
POWER	
IMPEDANCE (Ω)	
FREQUENCY (MHz)	
WARNING	
GENERAL	

For applicable patents, please see the ABOUT page on the monitor during operation.
© 1998 Novartis



Type BF and both the active insulation and
Follow instructions
Non-ionizing radiation
Magnetic field
Use appropriate take-back system

CAUTION
DO NOT TOUCH THE ELECTRODE CABLES OR THE MONITOR DURING OPERATION.
IF CONTACT WITH THE ELECTRODE CABLES OR THE MONITOR IS MADE, STOP THE TREATMENT IMMEDIATELY.
DO NOT TOUCH THE ELECTRODE CABLES.

215-0000-001


Информационный центр Росздрава
www.goszdrav.ru


8. Кабель для педали управления



Информация получена с официального сайта
Федерального центра по надзору
равнадзо

9.Кабель для коагуляции

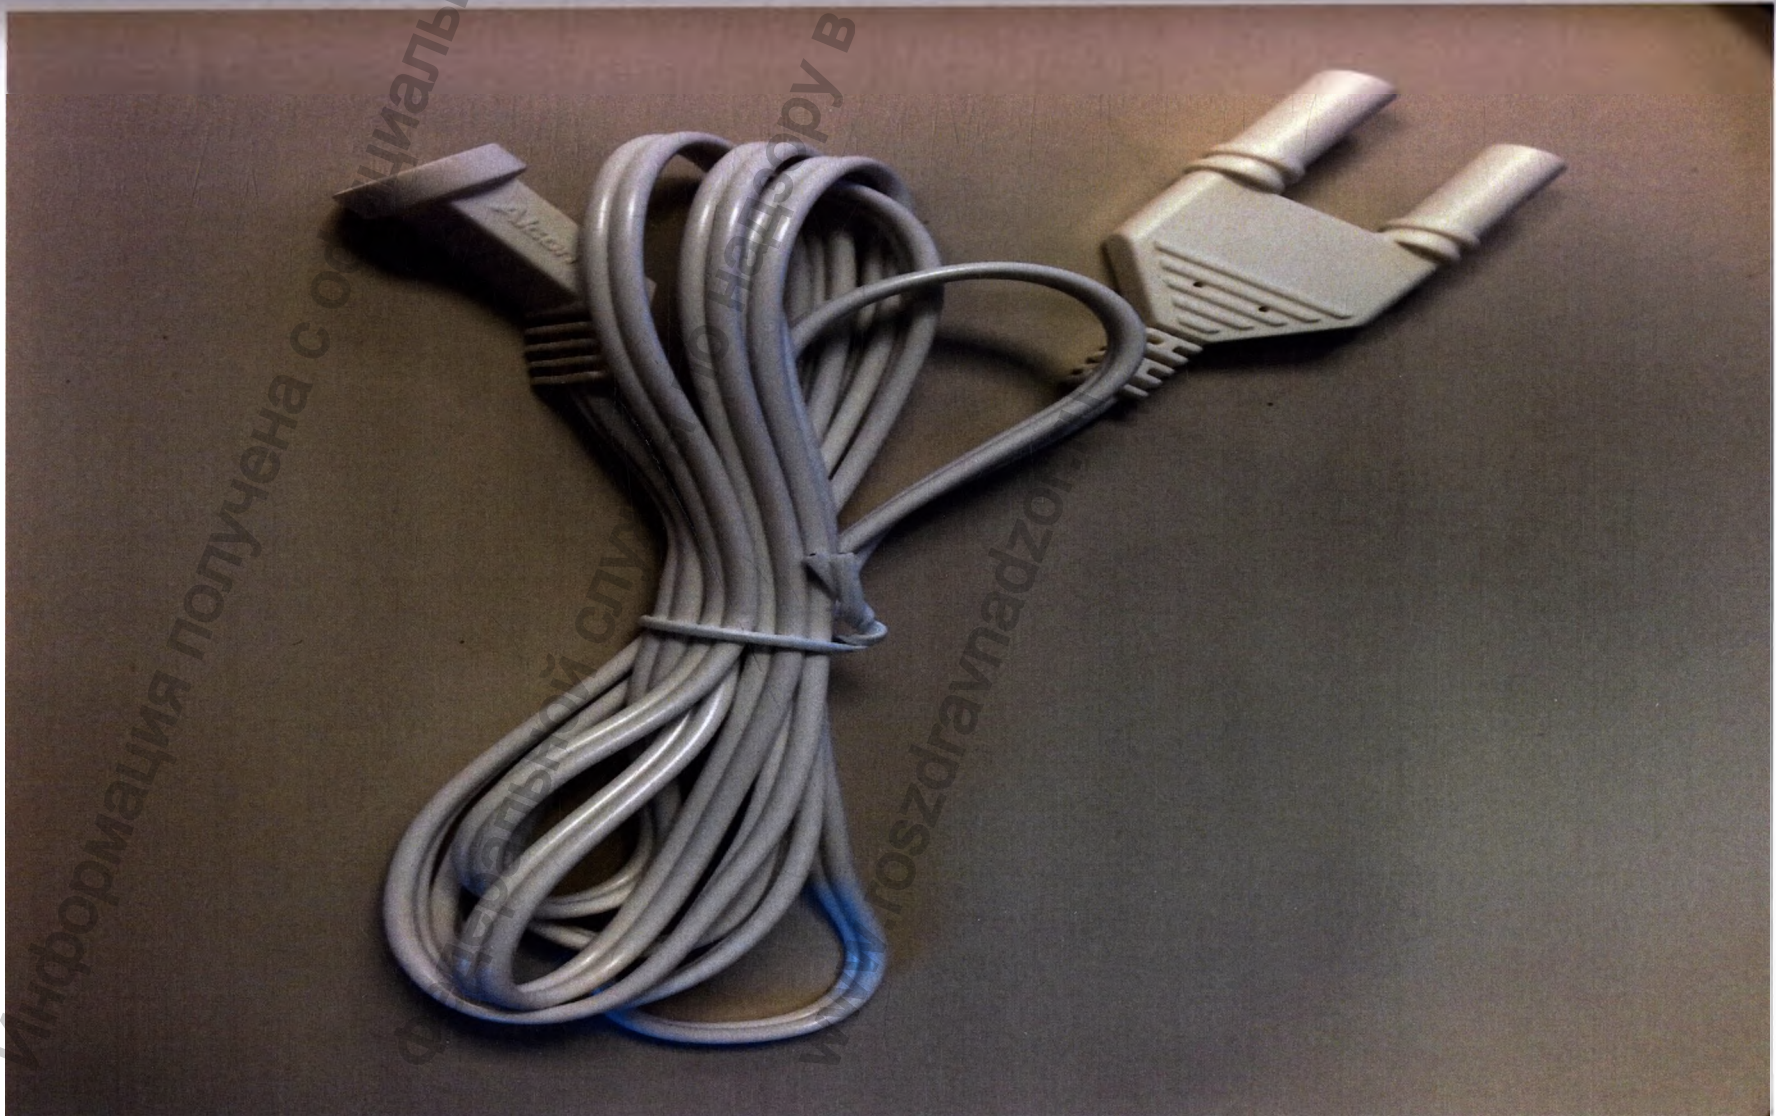

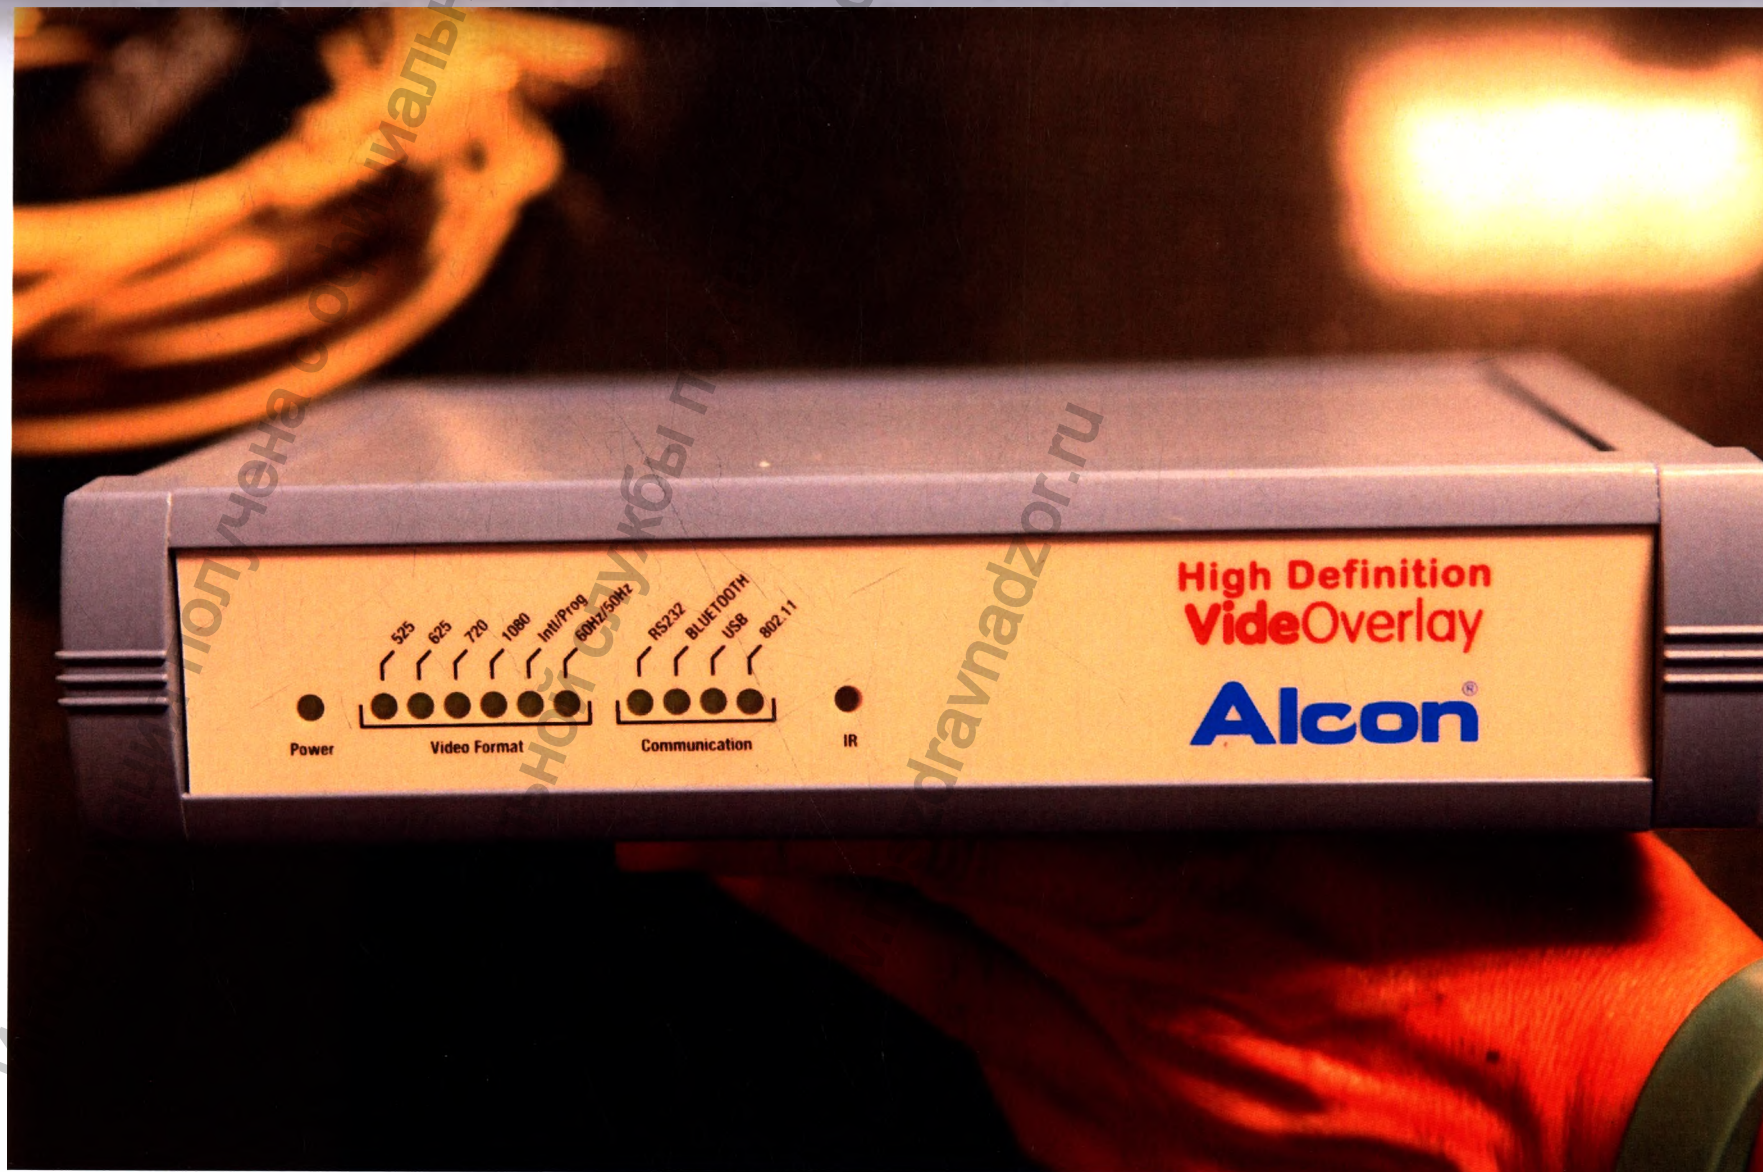



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.goszdravnadzor.ru



13. Носовой фиксатор картриджа для интраокулярных линз AutoSert




Информация по
Члена с официального
Федеральны
www.goszdra
с:ru

15. Ключ для инжектора интраокулярных линз AutoSert



Информация получена с официального сайта по надзору в сфере
Федеральной службы по надзору в сфере
www.goszdravnadzor.ru

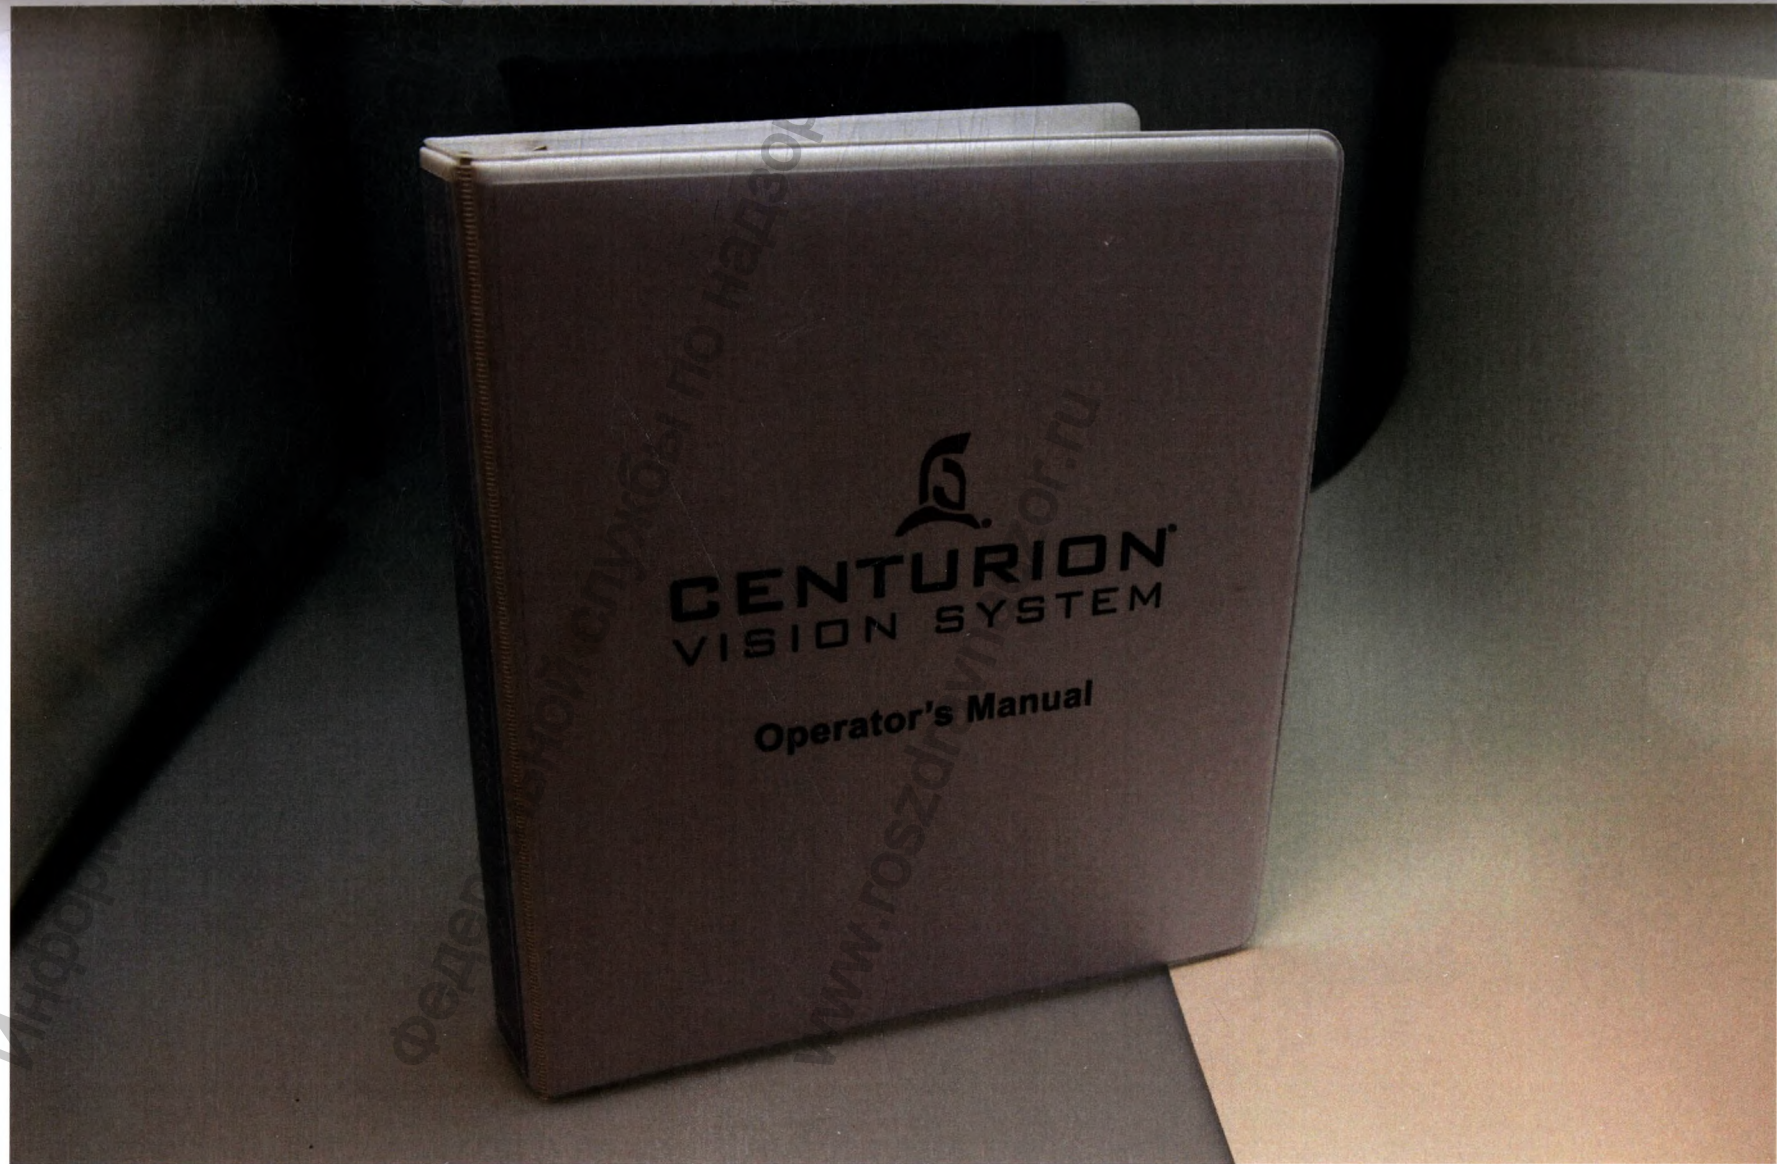

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по лекарственным средствам в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.ru

ВСЕГО
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
70 ЛИСТОВ

