

...ия получена с официального изору в сфере



0 УСТАНОВКА

Температура лазера 20.7 °C
Энергия за сеанс 0 Дж

3 ПРОГРАММА

1.94 мкм импульсный 1.55 мкм импульсный

0.0 Вт 0.0 Вт

0.0 Вт 0.0 Вт

0.2 мс




1-й заместитель ген. директора
ООО НТЦ ИРЭ
УШАКОВ А.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 2454 от 08.08.2014



Спецификация
Модель: ...
Серийный номер: ...
Дата выпуска: ...
Производитель: ...
Адрес: ...
Телефон: ...
E-mail: ...
Сайт: ...

Росздравнадзор
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
И.И. ДИМАНТОВ
102500, Москва, ул. Академика Б.В. Раундника, д. 19
Тел: (495) 938-9100
Факс: (495) 938-9101
E-mail: info@rosstandart.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

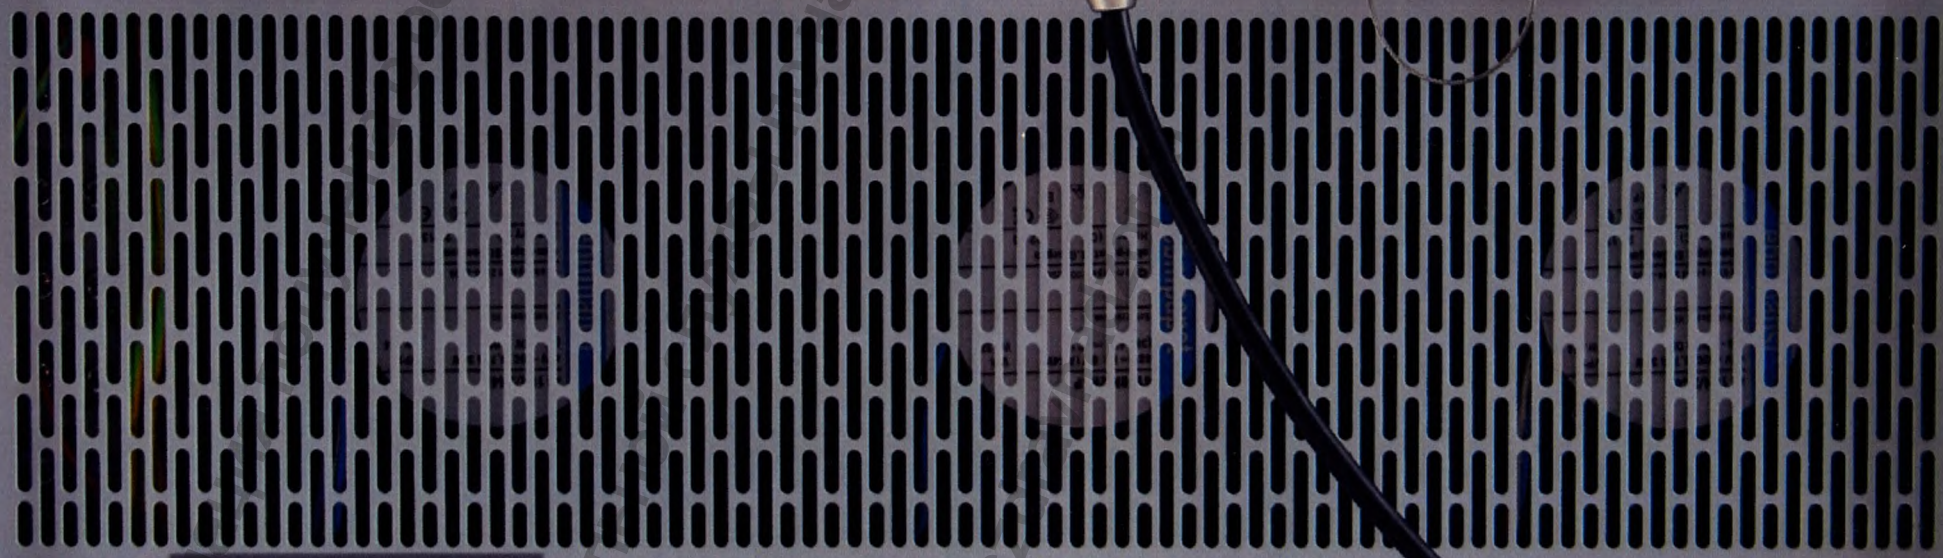

ООО НТО "ИРЭ-Полюс"
 Аппарат лазерный хирургический
 повышенной мощности "УРОЛАЗ"
 ТУ 9444-051-18003536-2015
 Зая № 131200056
 Сделано в России 2015г.
 250В±10%, 50Гц, 1800 ВА



Область, Федерация, Москва, площадь им. академика Б.А. Урванцева, д.1
 ОГРН 1025001022500
 СВЕРХ
 «НАУЧНО
 ТЕХНИЧЕСКОЕ
 ОБЪЕДИНЕНИЕ
 ИРЭ-Полюс»

И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕН. ДИРЕКТОРА
 «ООО НТО «ИРЭ-ПОЛЮС»
 УШАКОВ А.
 ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 №3-2434 от 05.09.2014