

Фотографические изображения изделия «Имплантат для коррекции ближнего зрения «Raindrop®» в составе, с принадлежностями» производства Ревижн Оптикс, Инк., США.

Фотография 1



1. Упаковка с имплантатом для коррекции ближнего зрения «Raindrop®» в устройстве для установки;
2. Шприц Norm-Ject 5 мл, с адаптером Луер-Лок;
3. Канюля (игла) Monoject тупоконечная 22G;
4. Карточка пациента;
5. Наклейки пациента идентификационные, 4 шт.;
6. Инструкция по применению;


Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

[www.goszdravnadzor.ru](http://www.goszdravnadzor.ru)

## Фотография 2

Имплантат для коррекции ближнего зрения «Raindrop®» в устройстве для установки. Упаковка имплантата - внешняя чашка и внутренняя чашка.

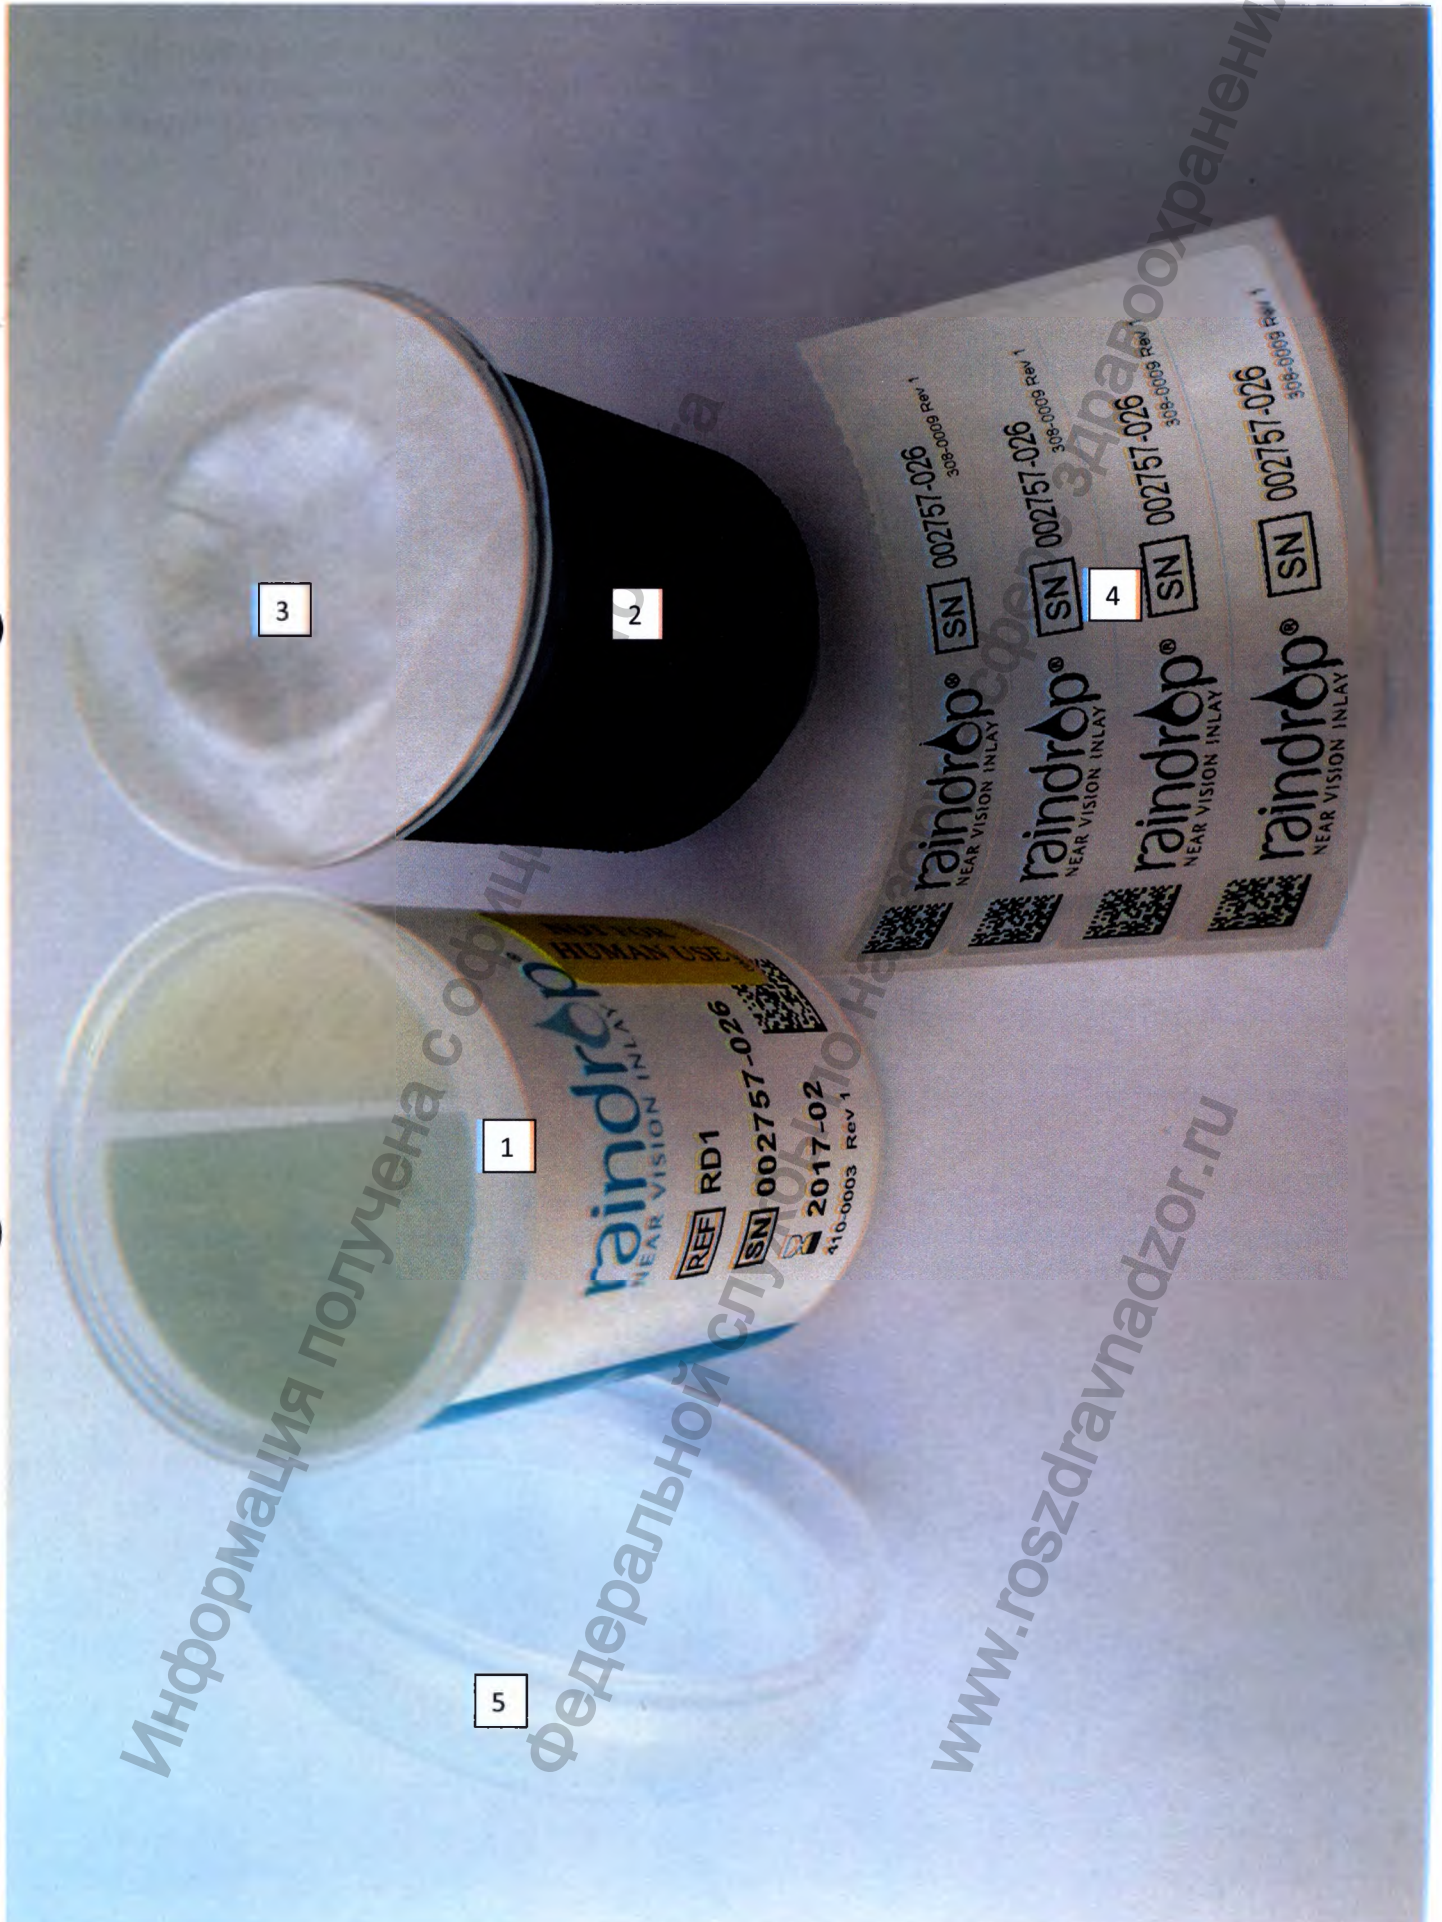

1. Внешняя чашка
2. Внутренняя чашка с кольцом из пенопласта
3. Укупорка из Тайвека
4. Наклейки пациента идентификационные, 4 шт.
5. Крышка внешней чашки

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

[www.goszdravnadzor.ru](http://www.goszdravnadzor.ru)


**Фотография 3**

Имплантат для коррекции ближнего зрения «Raindrop®» в устройстве для установки.  
Упаковка имплантата - Флакон с V-образным дном



#### Фотография 4

Имплантат для коррекции ближнего зрения «Raindrop®» в устройстве для установки.  
Имплантат извлечен из флакона

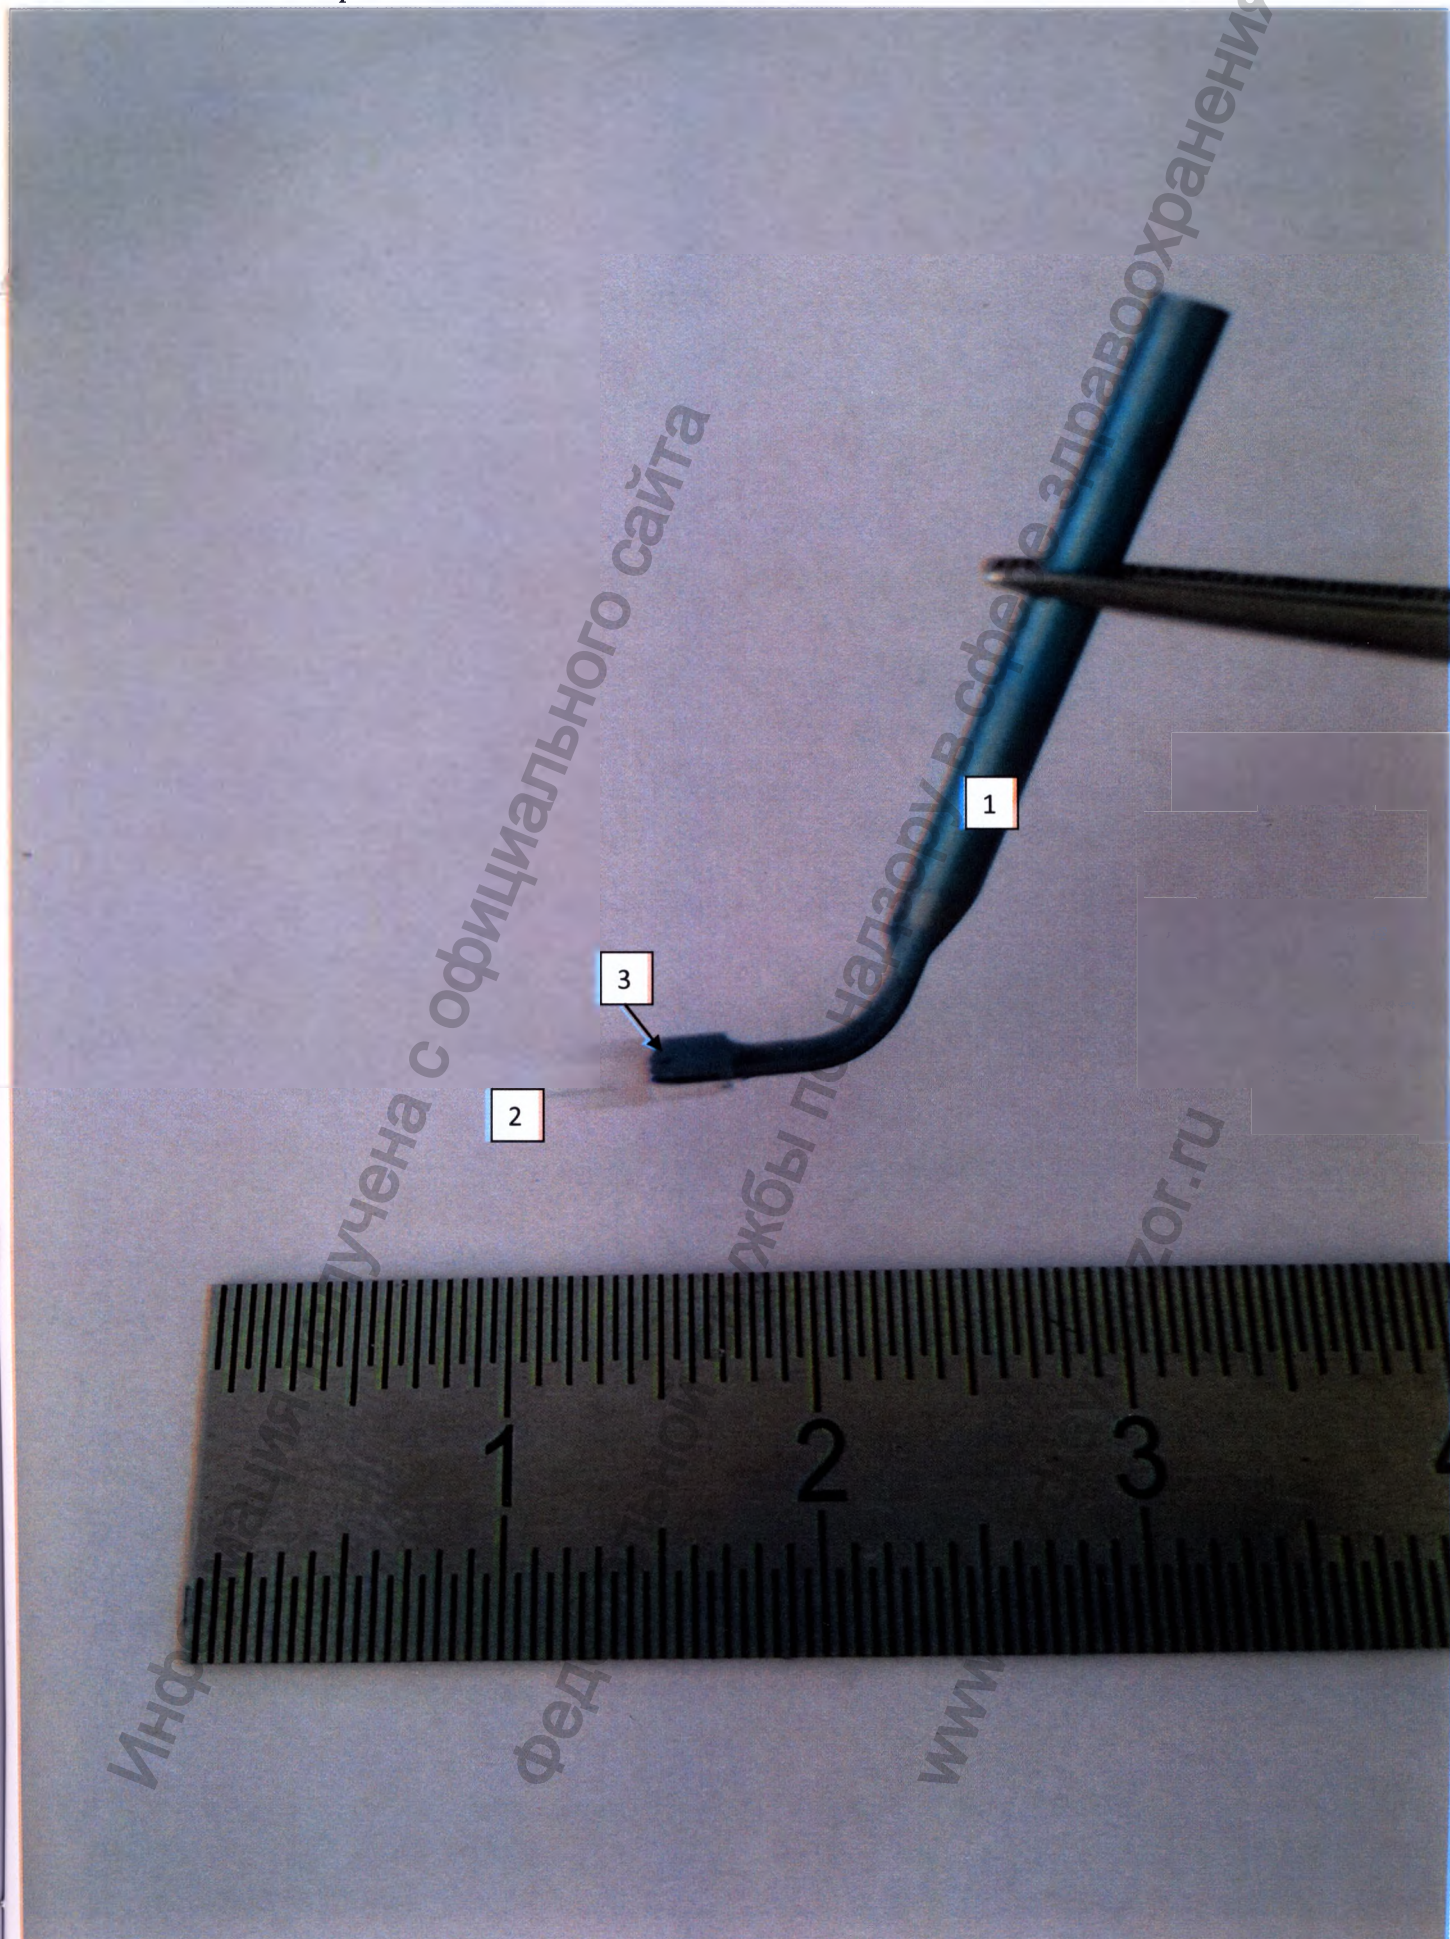

1. Устройство для установки имплантата;
2. Колпачок из политетрафторэтилена (ПТФЭ);
3. Дистальный конец устройства для установки с установленным имплантатом.

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

[www.goszdravnadzor.ru](http://www.goszdravnadzor.ru)

# 5 ml (6 ml) NORM-JECT® Luer Lock

NONPYROGENIC / NONTOXIC

Rx only Sterile only in unopened undamaged package.

latex FREE



Keltenstraße 1  
D-78532 Tuttlingen/Germany

**(D)** Einmalspritze. Nach einmaligem Gebrauch vernichten. **(F)** Seringue à usage unique. Détruire après utilisation. **(GB)** Single-use syringe. Destroy after single use. **(I)** Siringa monouso. Eliminare dopo l'unico uso. **(E)** Jeringa para un solo uso. Destruir una vez utilizada. **(RUS)** Одноразовый шприц. Уничтожить после одноразового применения.

2013/01

**LOT** 4E12048 **STERILE EO** 2014-05 2019-05 **CE0535**





**Фотография 6**

Канюля (игла) Monoject тупоконечная 22G



Фотография 7. Принадлежность.

Ручка зажимная к устройству для установки имплантата (в упаковке).



**Фотография 8. Принадлежность.**

Ручка зажимная к устройству для установки имплантата.



**Фотография 9.**

Имплантат для коррекции ближнего зрения «Raindrop®» в устройстве для установки в сборе с принадлежностью - ручкой зажимной для установки имплантата.



Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.ru

Прошнуровано, пронумеровано  
1 12 / двенадцать  
лист 06  
Генеральный директор  
ООО "Райфарм"  
Дмитриев Д.В.

