


Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

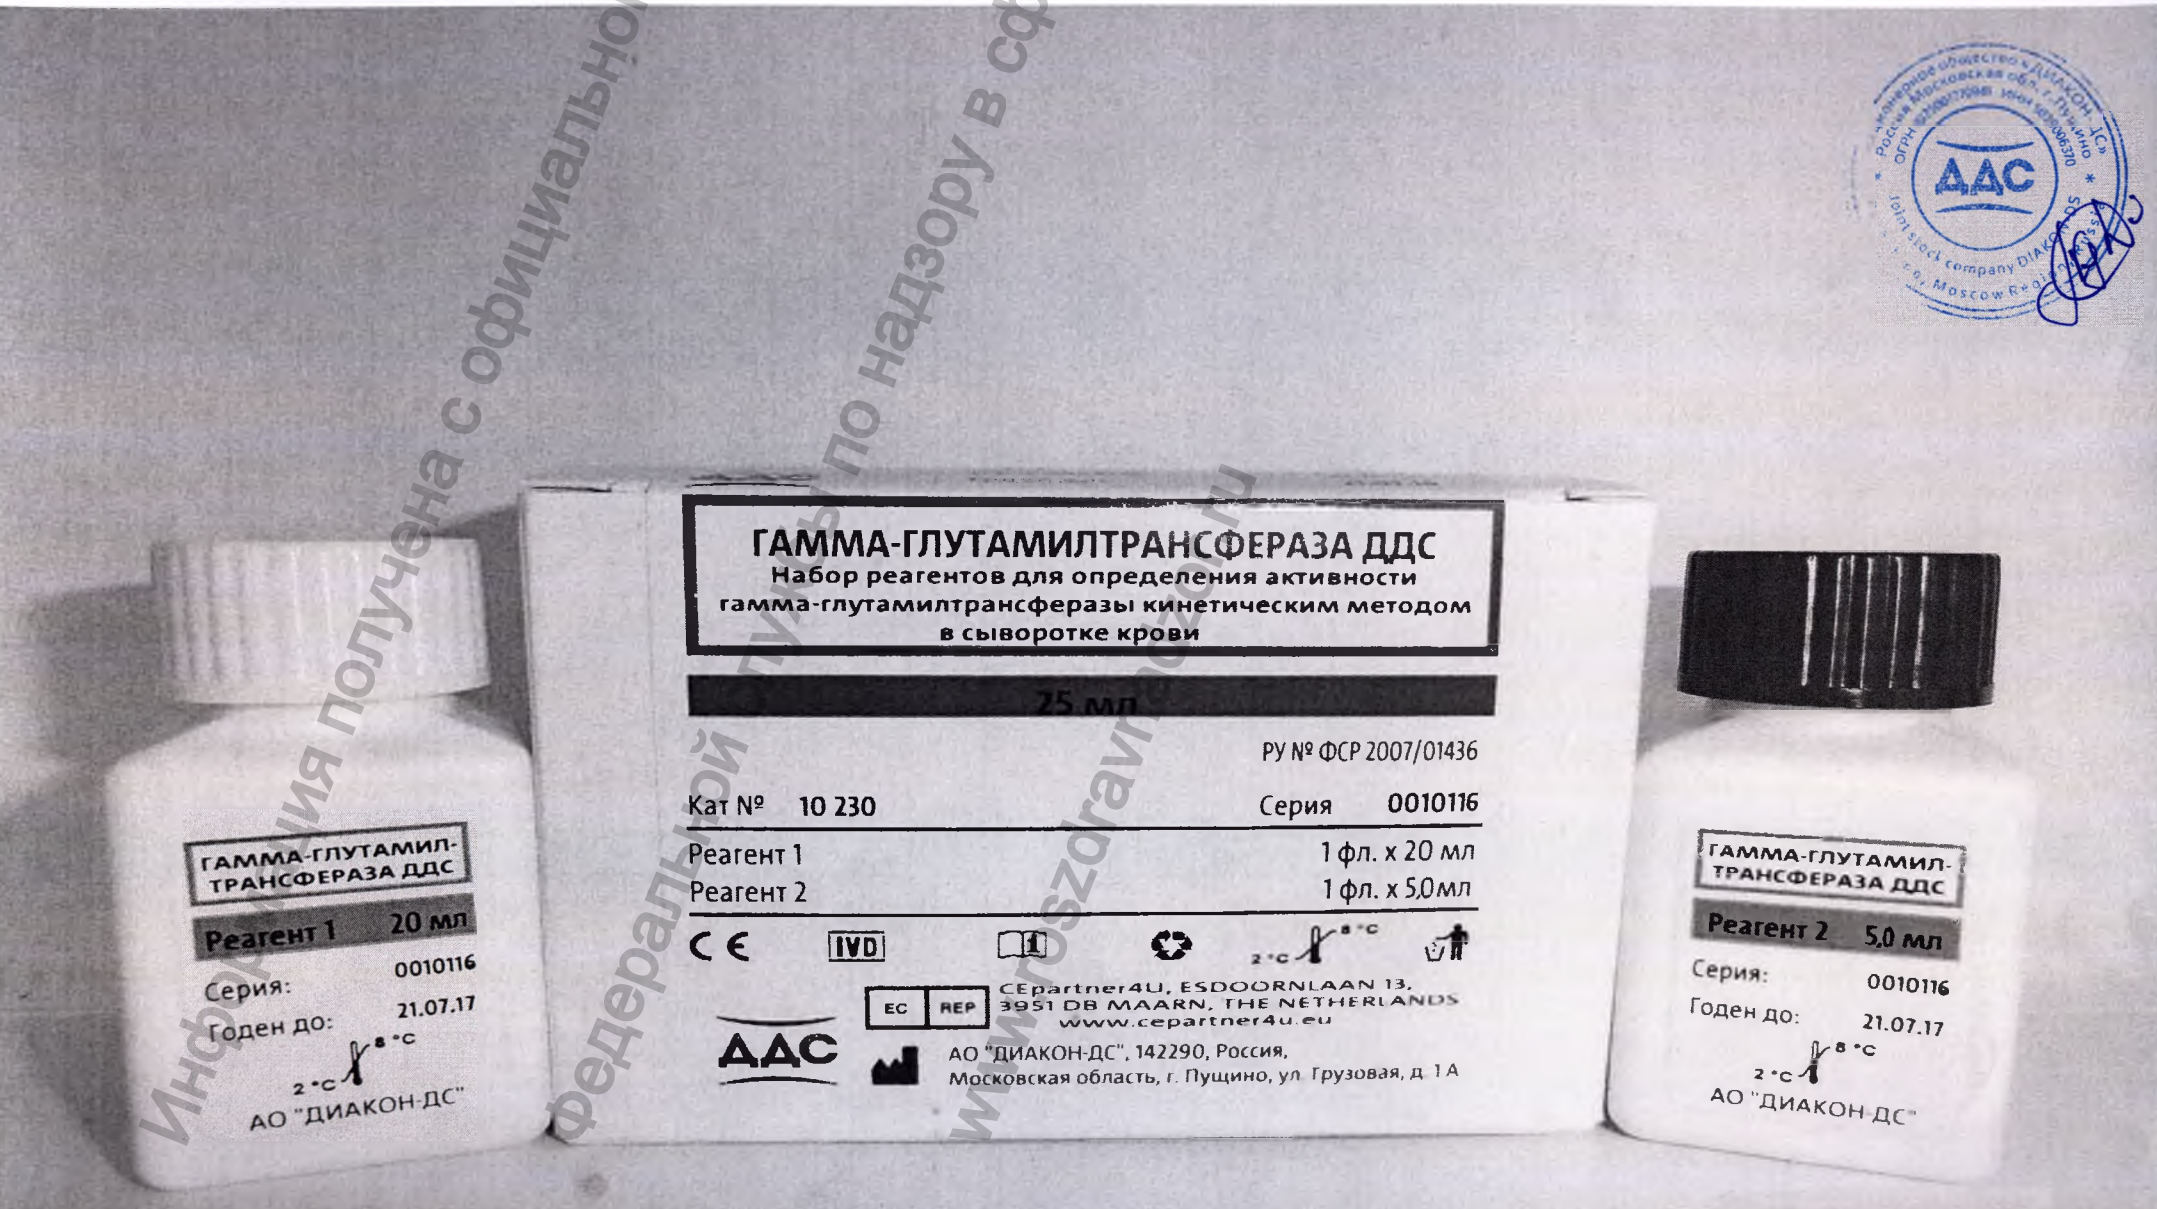

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
Набор реагентов для определения активности
гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом
в сыворотке крови

25 мл


ПУ № ФСР 2007/01436

Кат № 10 230


Серия 0010116

Реагент 1 1 фл. х 20 мл

Реагент 2 1 фл. х 5,0 мл

CE IVD 

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu



АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1 А

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-
ТРАНСФЕРАЗА ДДС

Реагент 1 20 мл

Серия: 0010116

Годен до: 21.07.17

2°C 8°C
АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-
ТРАНСФЕРАЗА ДДС


Реагент 2 5,0 мл

Серия: 0010116

Годен до: 21.07.17

2°C 8°C
АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

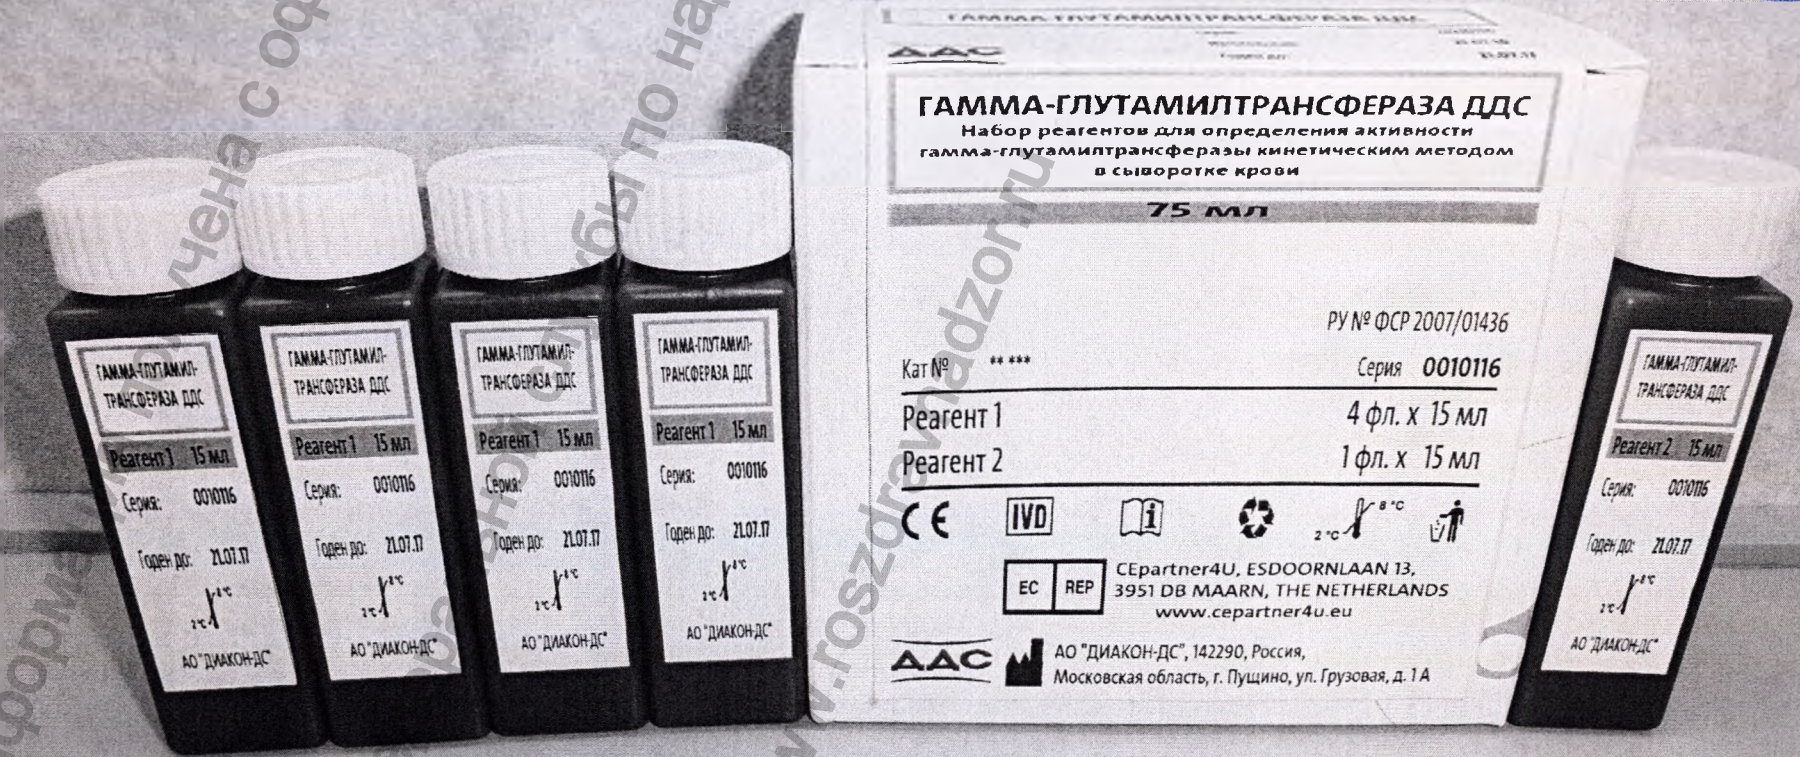

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
Набор реагентов для определения активности
гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом
в сыворотке крови
75 мл


Кат № **** РУ № ФСР 2007/01436
Серия **0010116**
Реагент 1 4 фл. x 15 мл
Реагент 2 1 фл. x 15 мл

CE IVD i 2°C 20°C
EC REP CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu
AAC АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1 А

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реагент 1 15 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реагент 2 15 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
АО "ДИАКОН-ДС"


Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

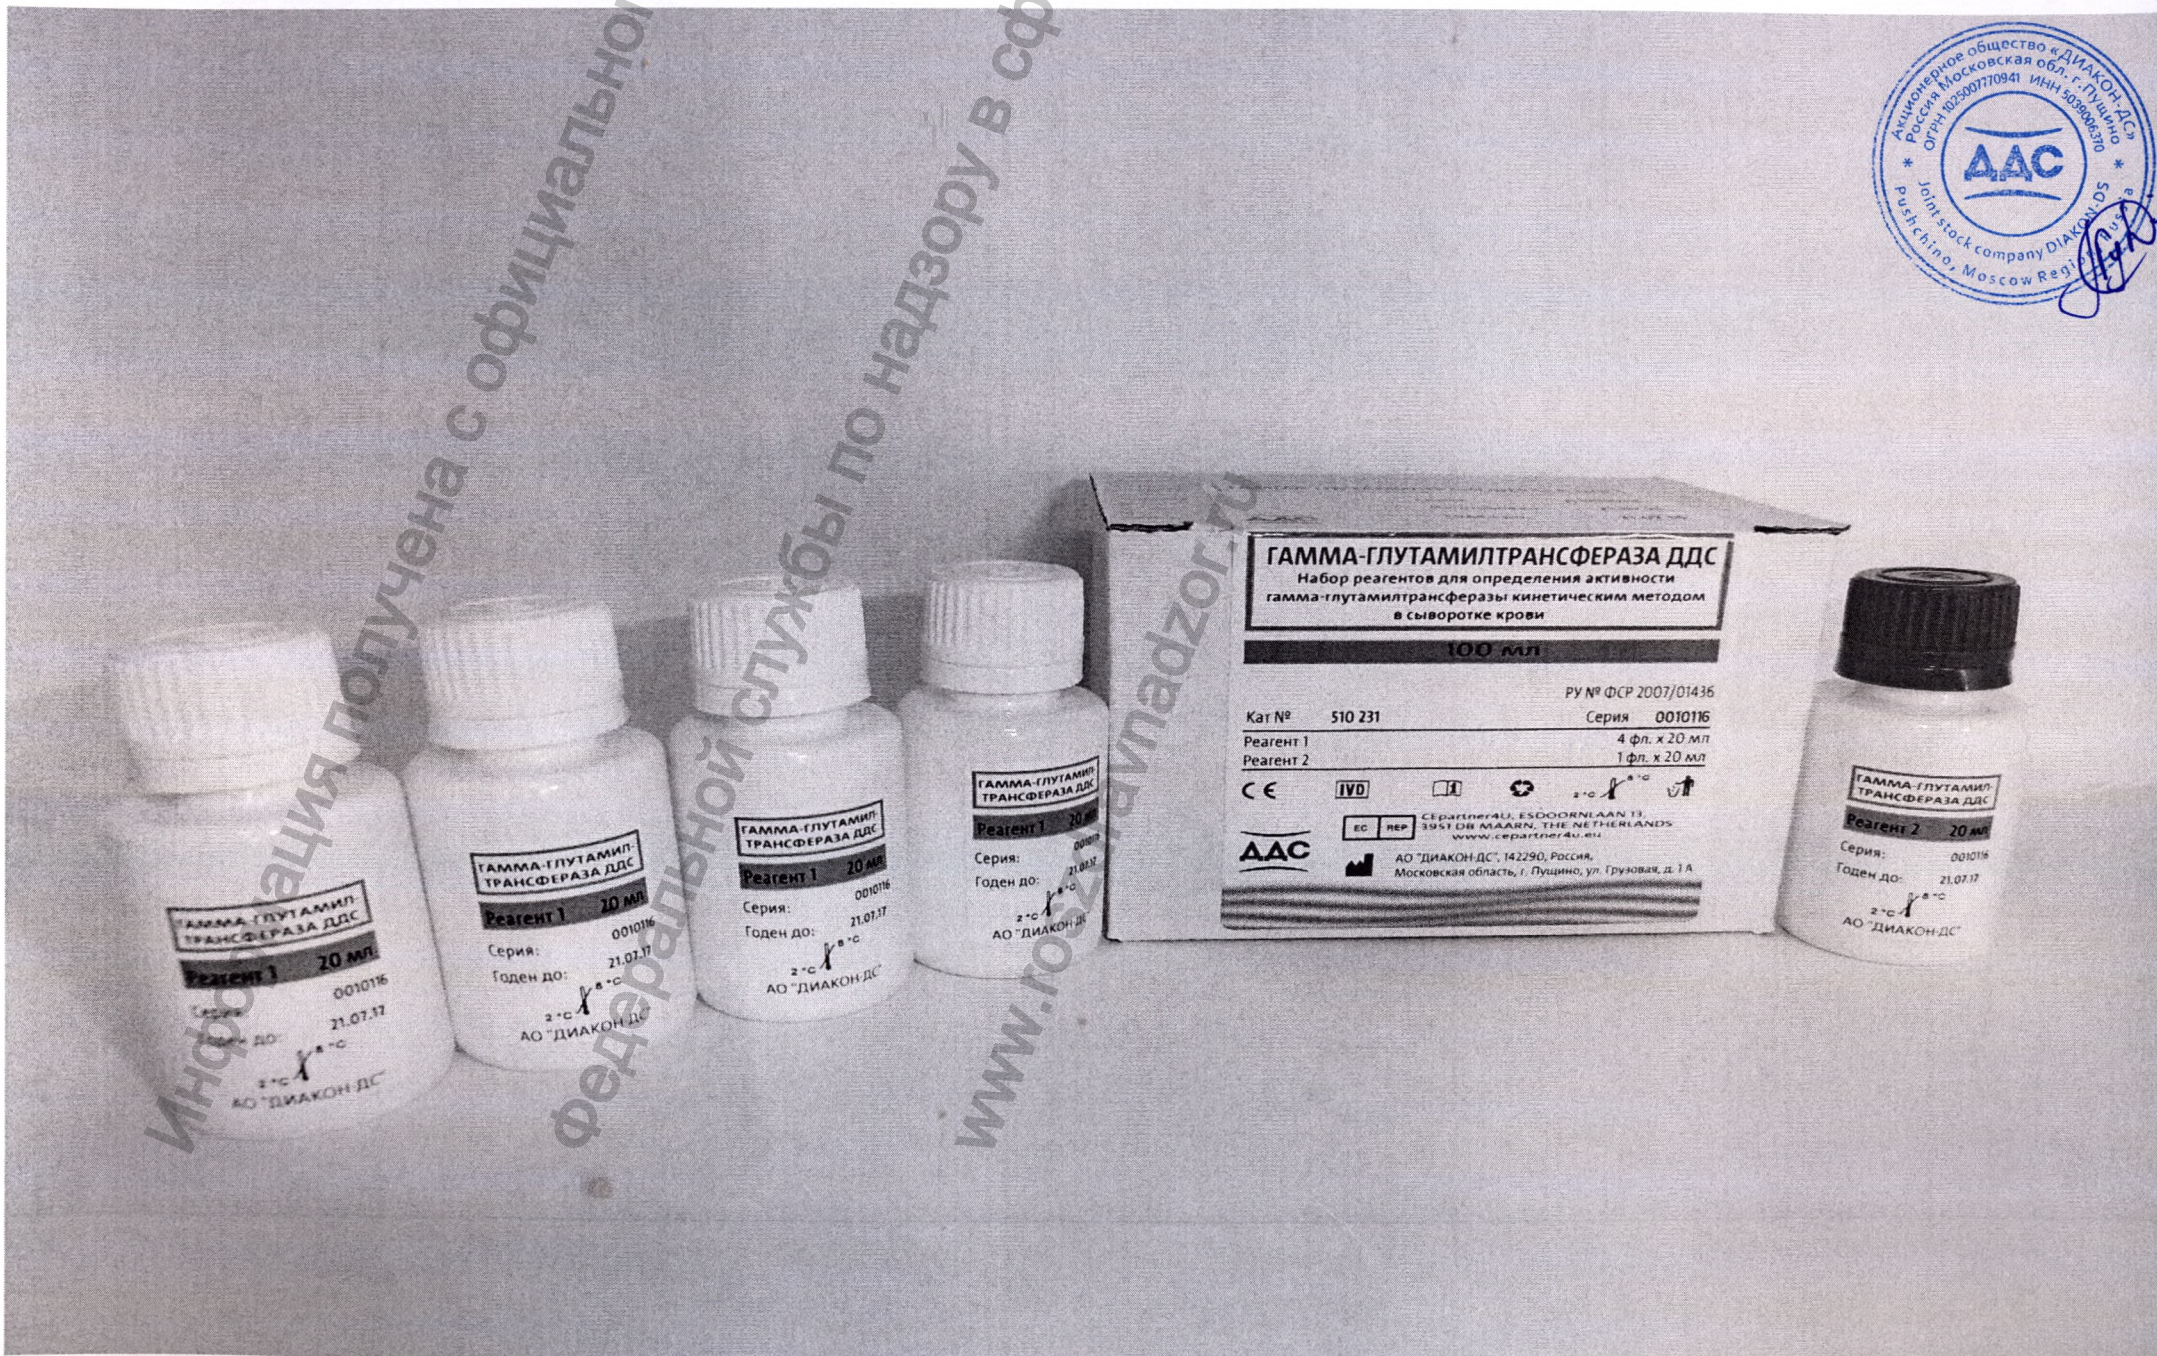

Внешний вид
Набора реактивов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)



Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

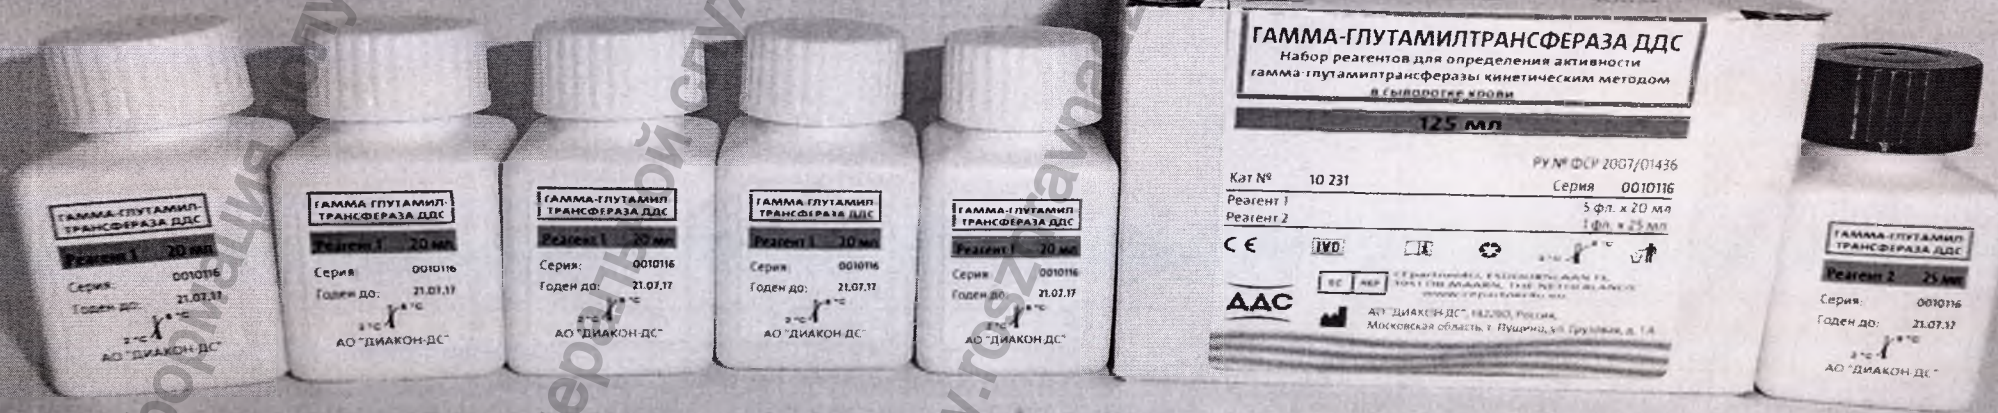

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)




ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реагент 1 64 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2°C / 8°C
АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реагент 1 64 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2°C / 8°C
АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
168 мл
Кат № **** *
Серия 0010116
Реагент 1 2 фл. x 64 мл
Реагент 2 2 фл. x 20 мл
CE IVD IFU 2°C / 8°C
EC REP CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13, 3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS, www.cepartner4u.eu
АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реагент 2 20 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2°C / 8°C
АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

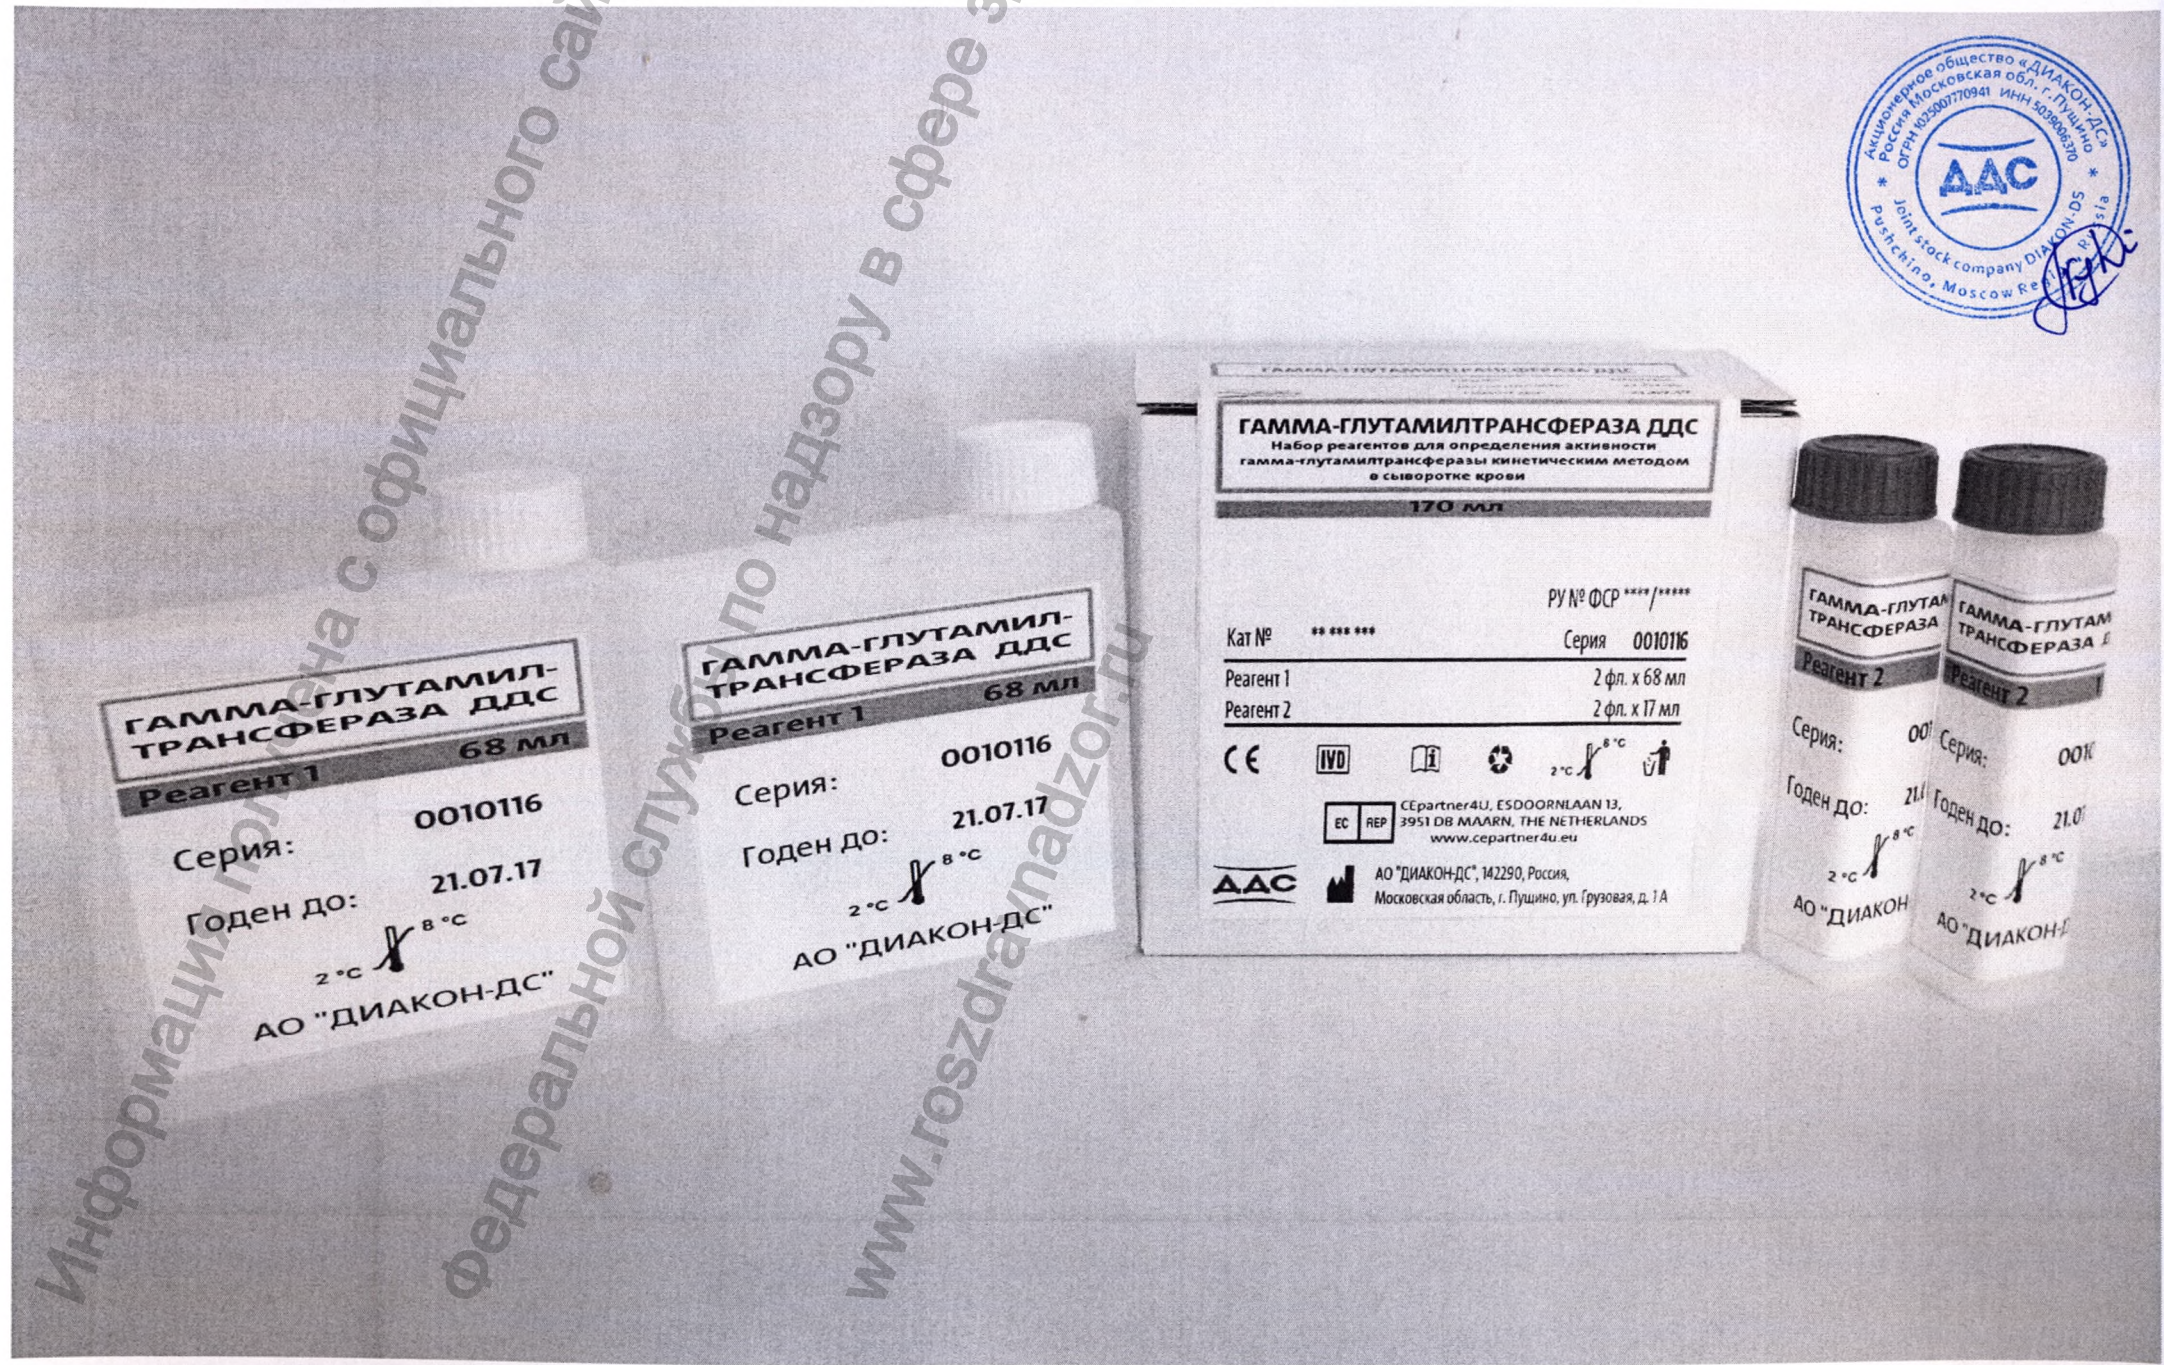

Информация размещена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.ru

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)




ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реагент 1 65 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2 °C \nearrow 8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реагент 1 65 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2 °C \nearrow 8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
170 мл
Кат № **** *
РУ № ФСР **** /*****
Серия 0010116
Реагент 1 2 фл. х 65 мл
Реагент 2 2 фл. х 20 мл
CE IVD I R 2 °C \nearrow 8 °C
EC REP CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13, 3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS, www.cepartner4u.eu
АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реагент 2 20 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2 °C \nearrow 8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

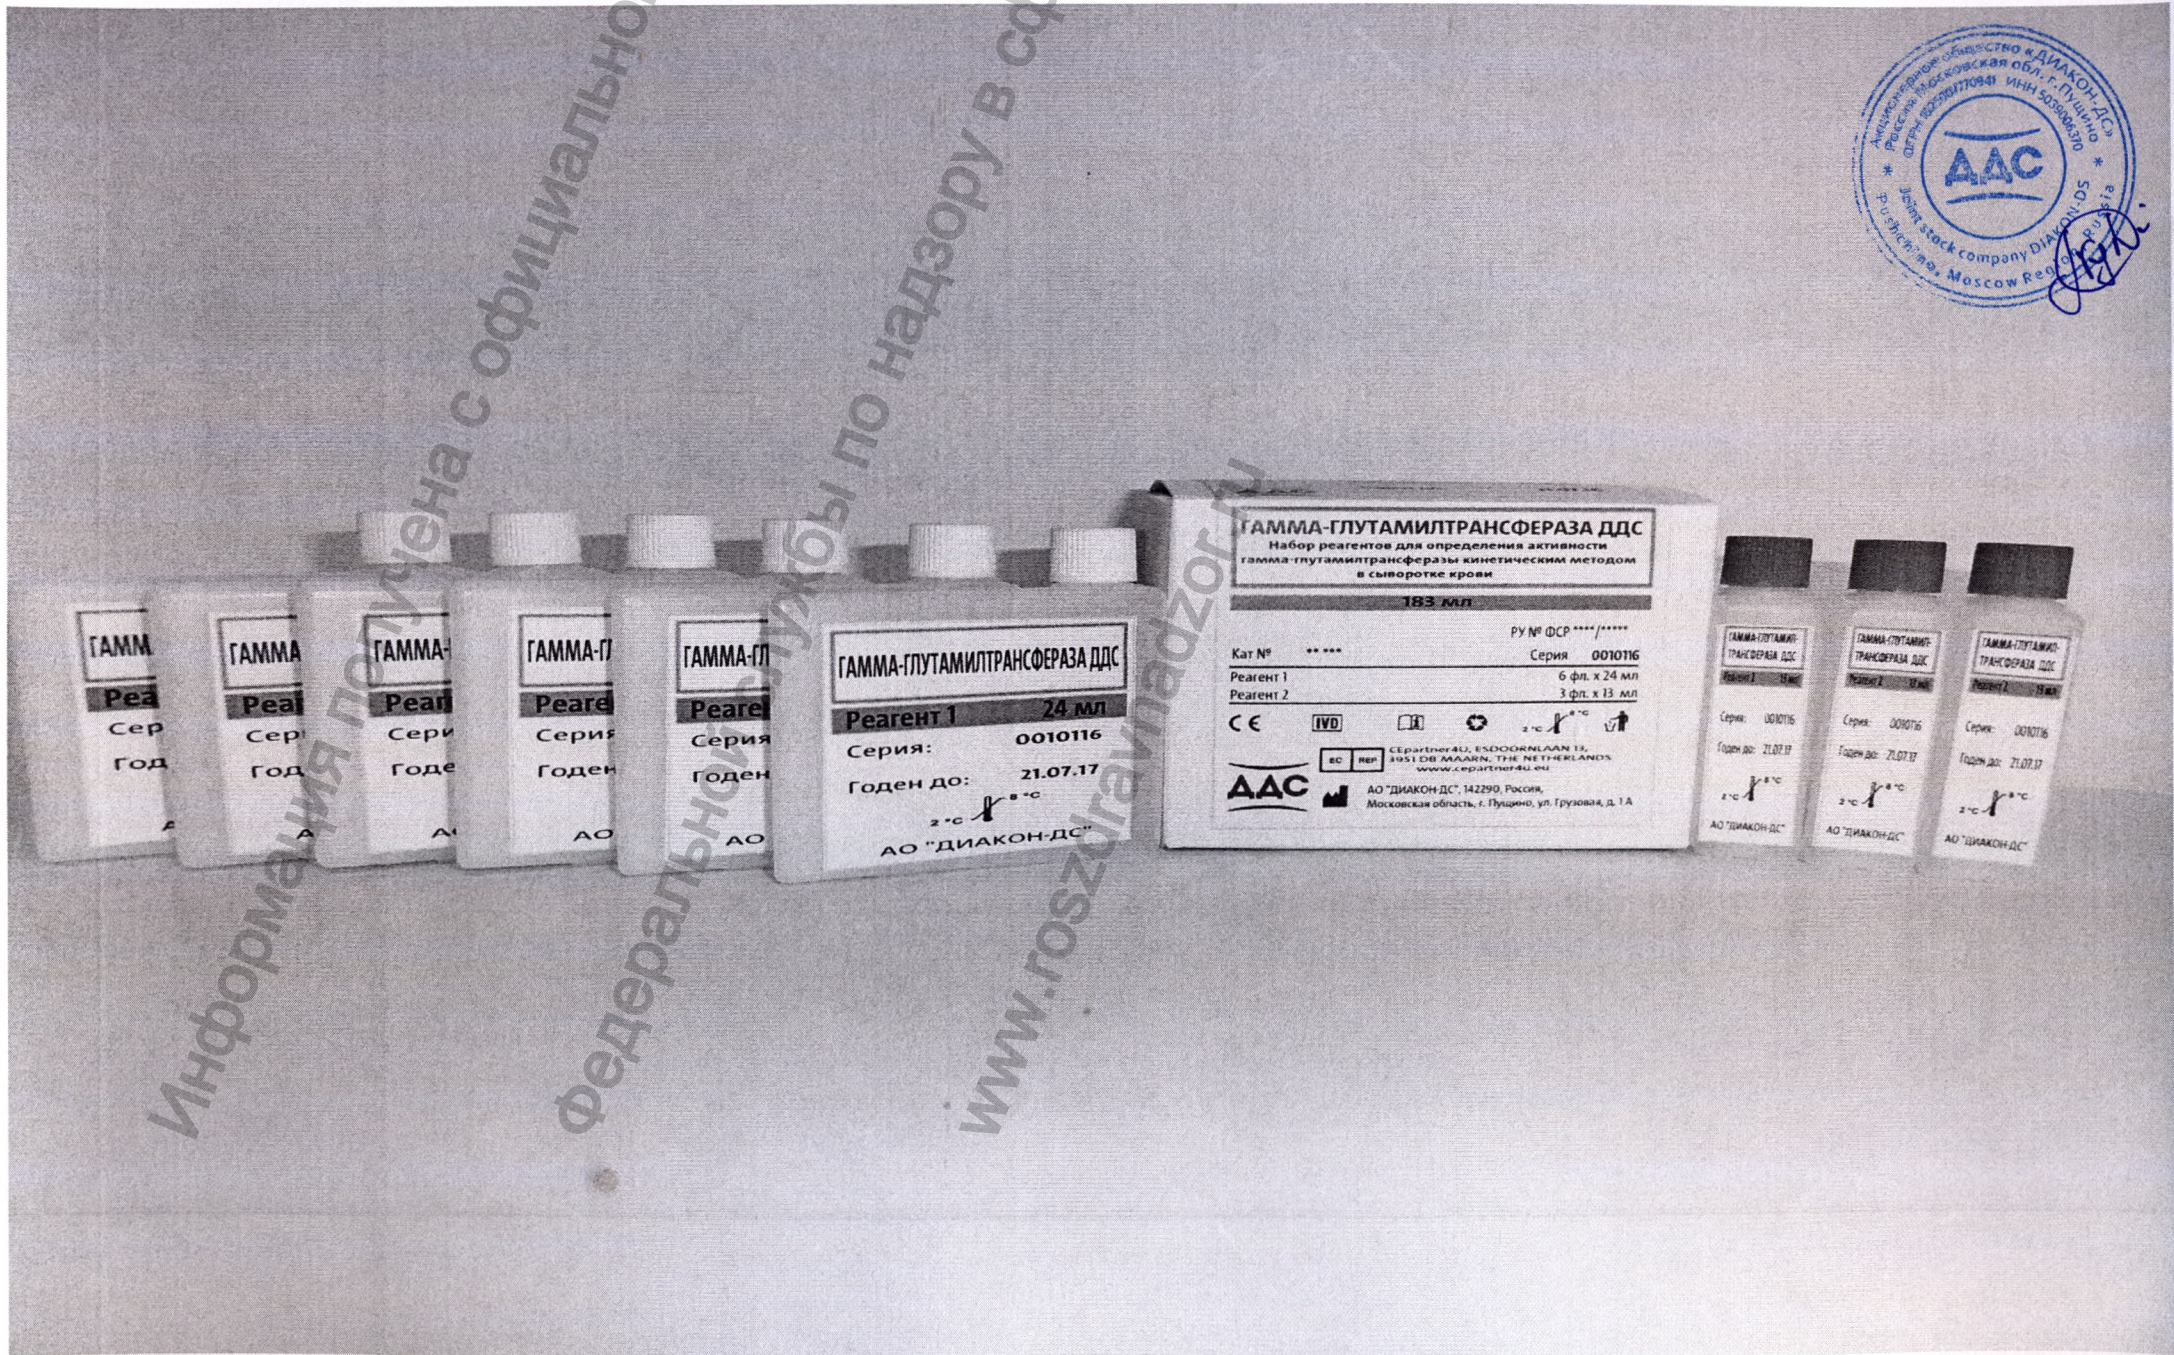

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
Набор реагентов для определения активности
гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом
в сыворотке крови

183 мл

Кат № ** ** * * * * * РУ № ФСР **** / ***** Серия 0010716
Реагент 1 6 фл. х 24 мл
Реагент 2 3 фл. х 13 мл

CE IVD 2°C 8°C

ААС CEpartner 4U, ESDOORNLAAN 19,
4951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu

АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реагент 1 24 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2°C 8°C
АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реагент 2 13 мл
Серия: 0010716
Годен до: 21.07.17
2°C 8°C
АО "ДИАКОН-ДС"


Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.goszdravnadzor.ru

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)



Информация доступна на официальном сайте
 Федеральное государственное учреждение
 Росздравнадзор
 www.goszdrnadzor.ru

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

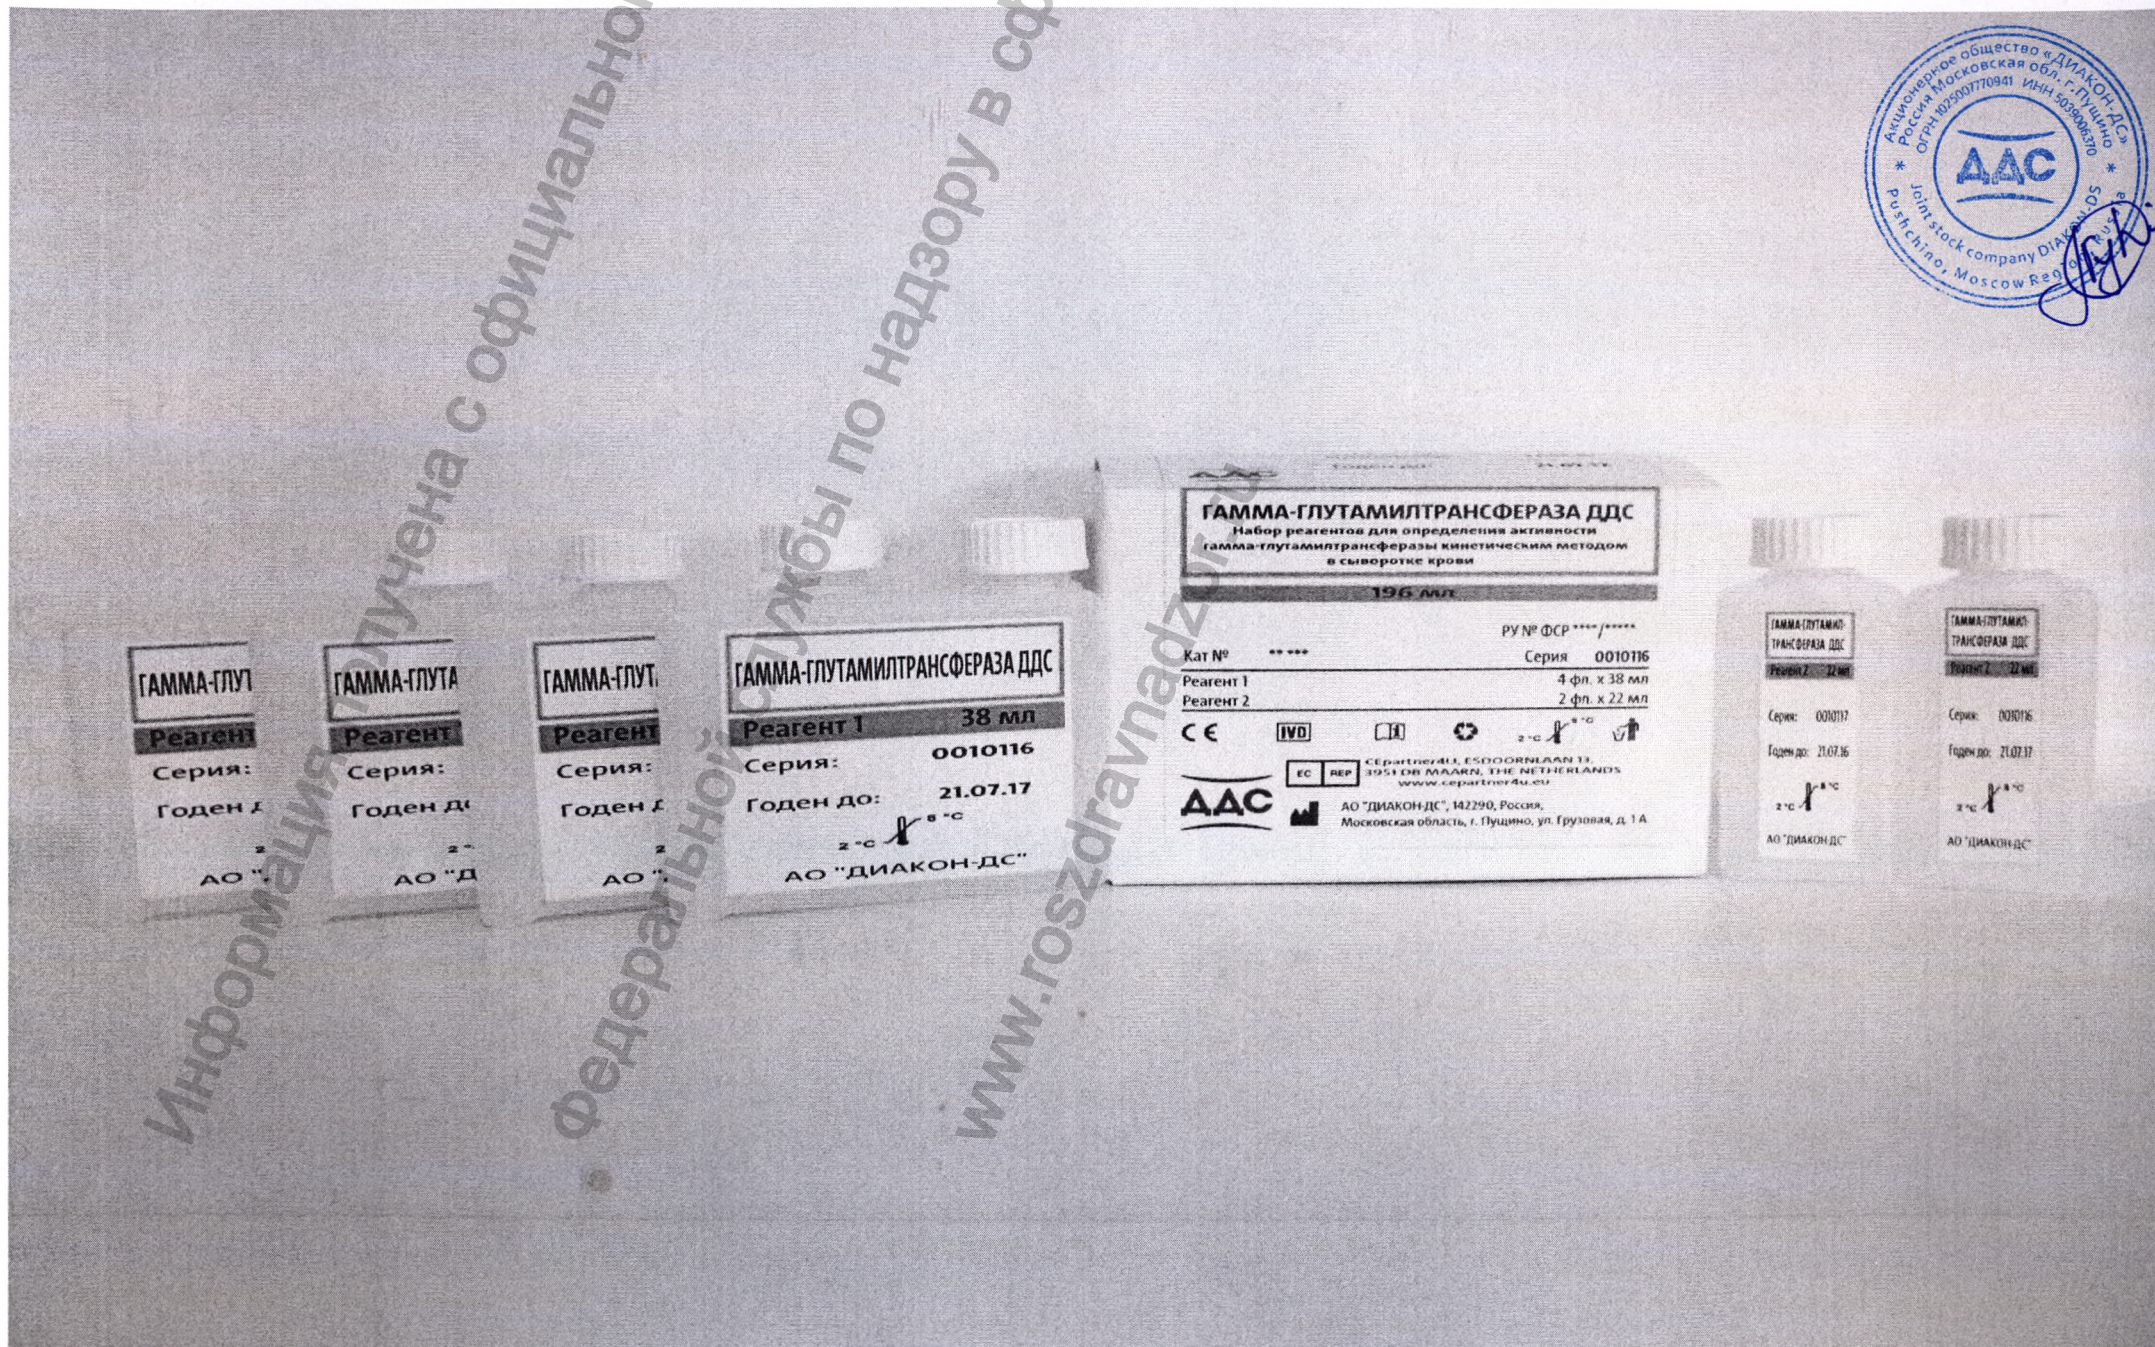

ГАММА-ГЛУТ
Реагент
 Серия:
 Годен д

ГАММА-ГЛУТА
Реагент
 Серия:
 Годен д

ГАММА-ГЛУТ
Реагент
 Серия:
 Годен д

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реагент 1 38 мл
 Серия: 0010116
 Годен до: 21.07.17
 2°C

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
 Набор реагентов для определения активности
 гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом
 в сыворотке крови
 196 мл

Кат № **** Серия 0010116
 Реагент 1 4 фл. x 38 мл
 Реагент 2 2 фл. x 2.2 мл

CE IVD

СЕ partner B.V. ES DOORNLAAN 11
 3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
 www.separtner4u.eu


ДДС АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,
 Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1 А

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реагент 2 2.2 мл
 Серия: 0010116
 Годен до: 21.07.17
 2°C


ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реагент 2 2.2 мл
 Серия: 0010116
 Годен до: 21.07.17
 2°C

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.goszdraznadzor.ru

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

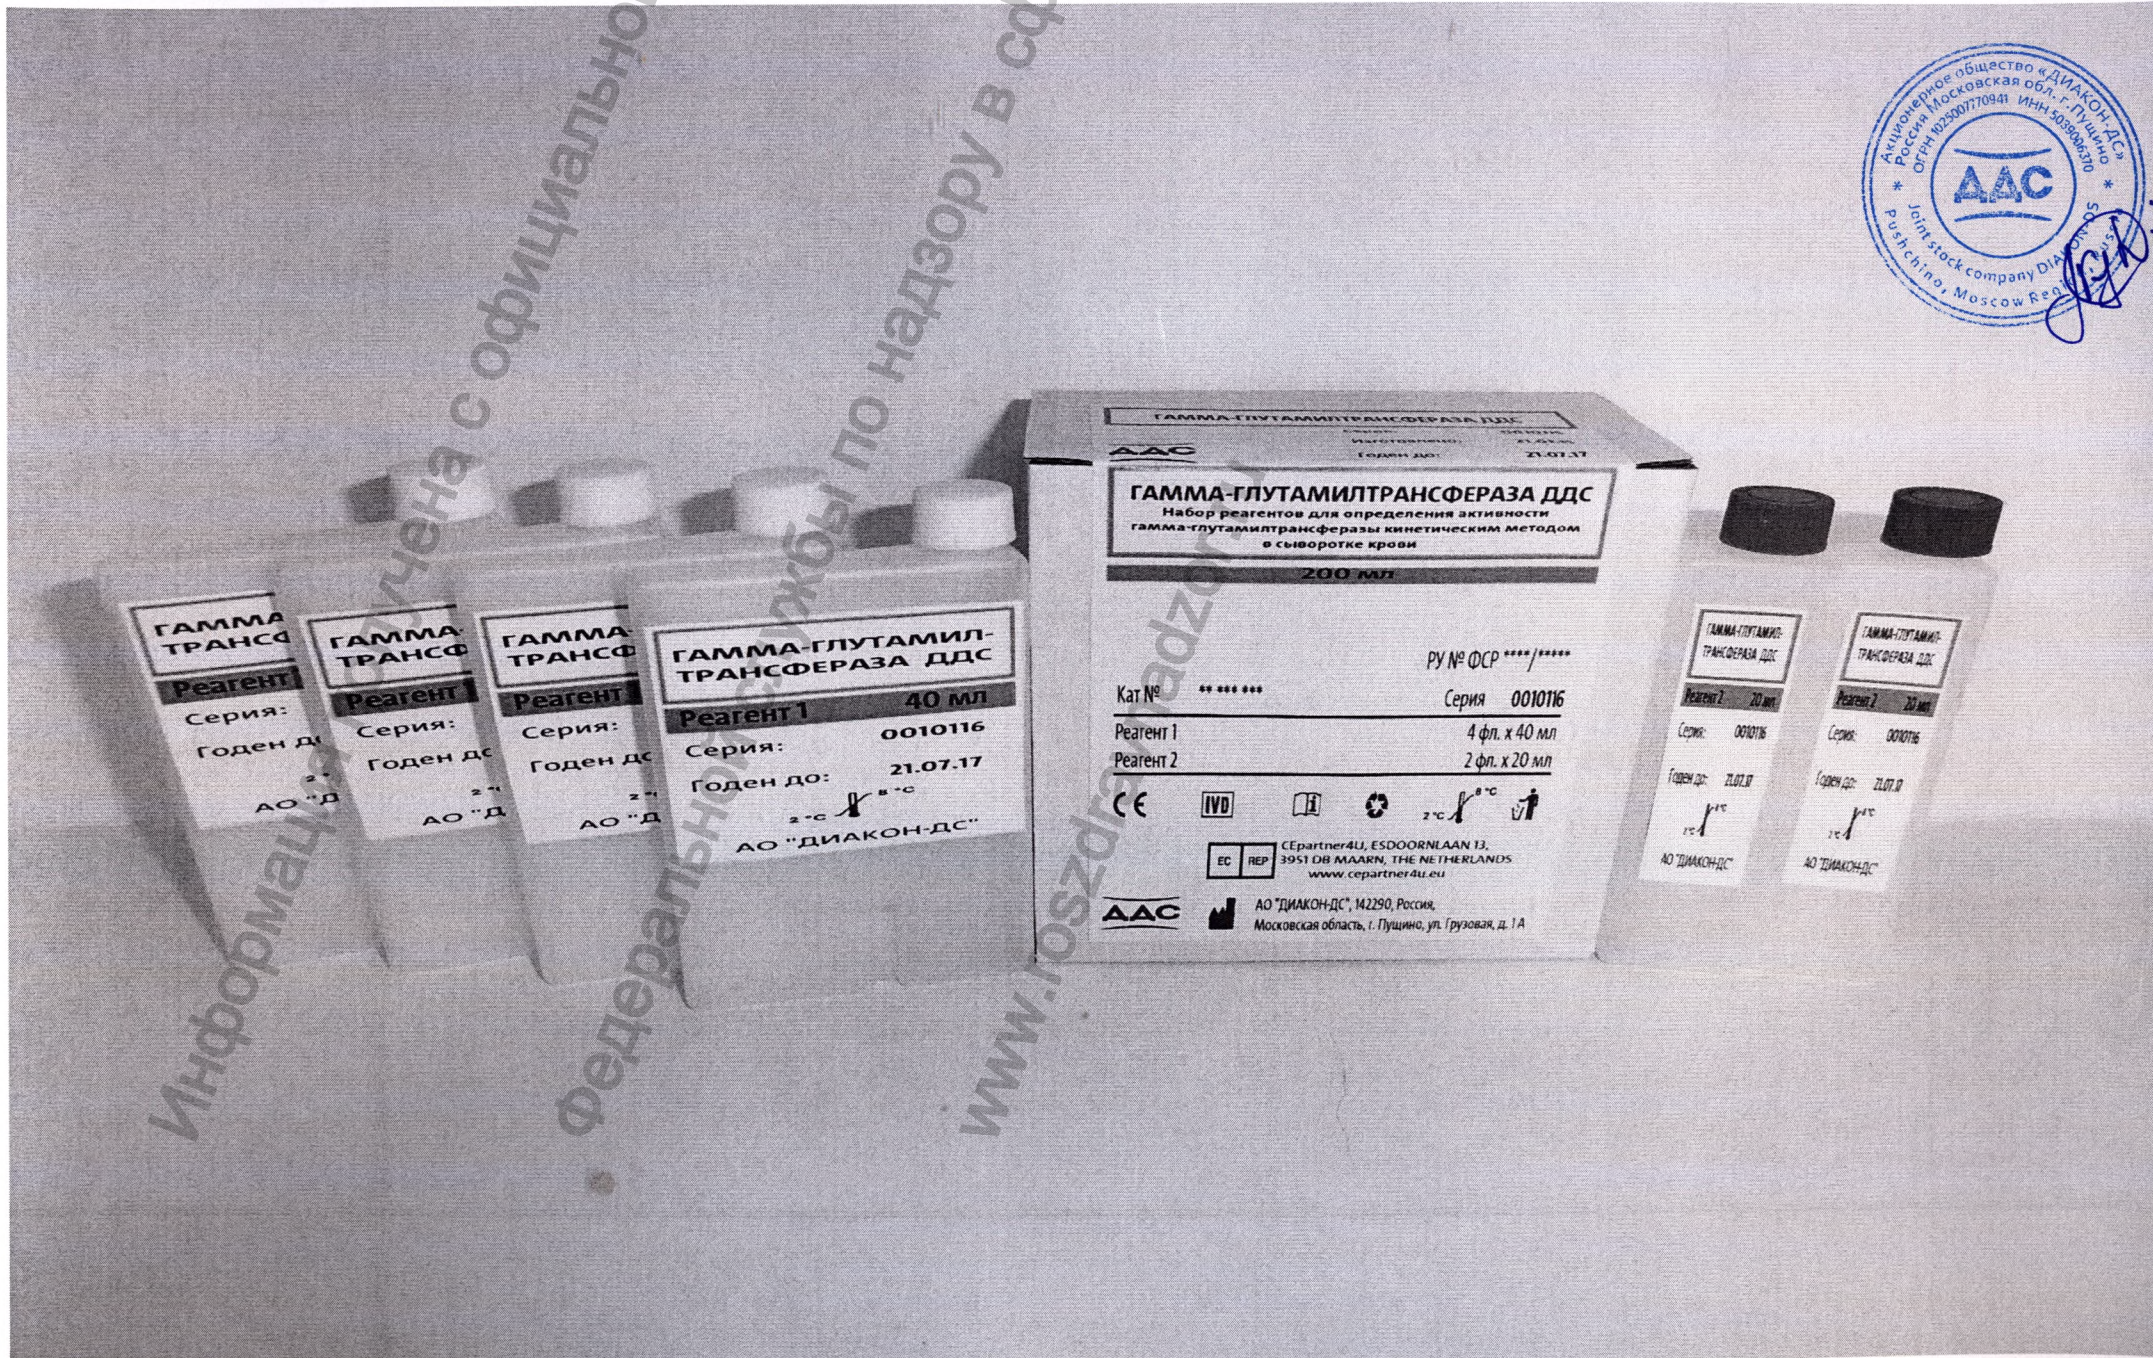

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

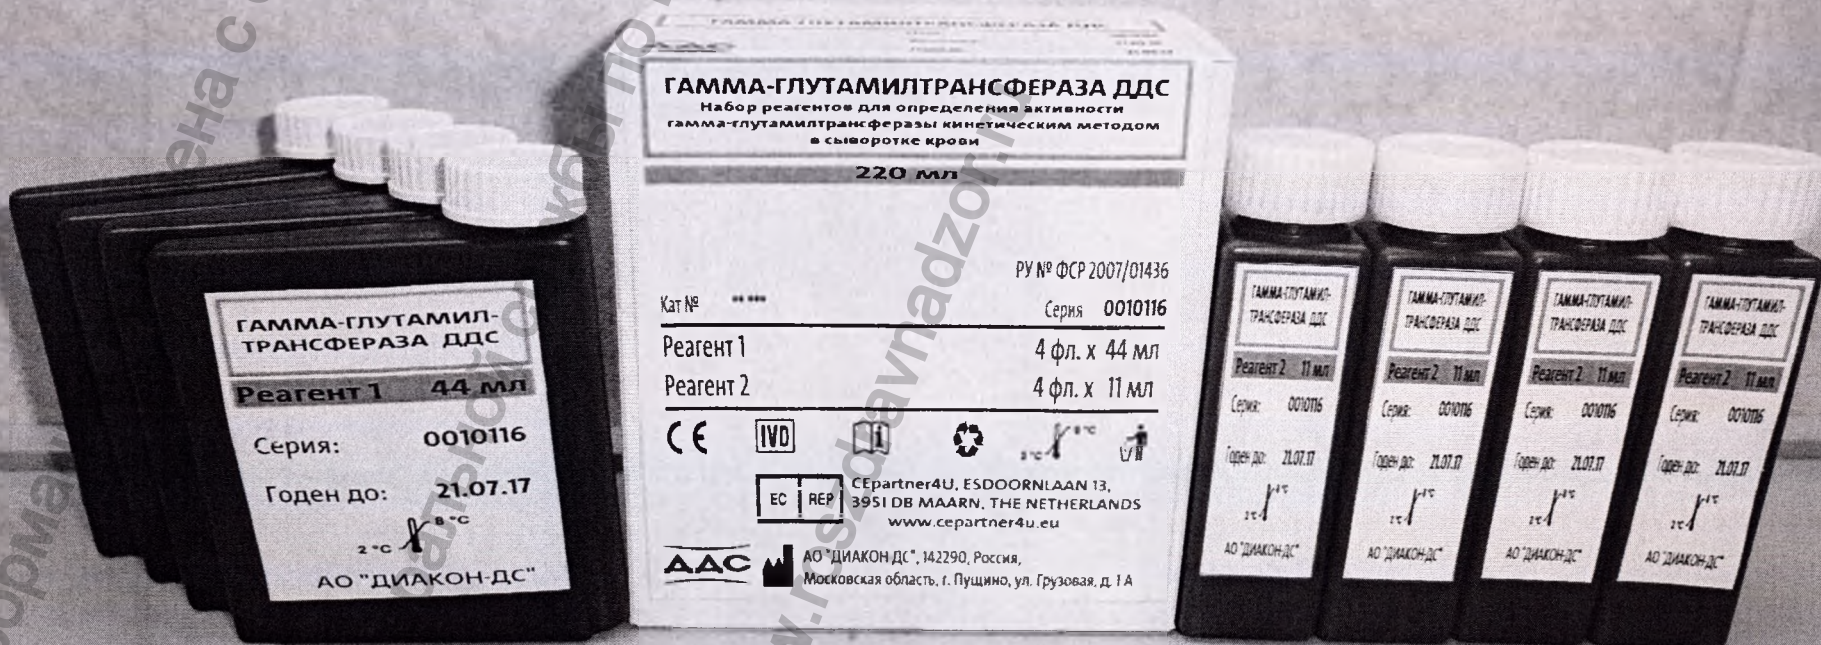

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)



ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
 Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови

Кат № ***** РУ № ФСР ***** /***** Серия 001076

Реагент 1	5 фл. х 40 мл
Реагент 2	5 фл. х 10 мл

CE IVD EC REP

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13, 3951 DB MAAKN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu

АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А


Информация

Федеральный

www.goszdraznadzor.ru

Внешний вид

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

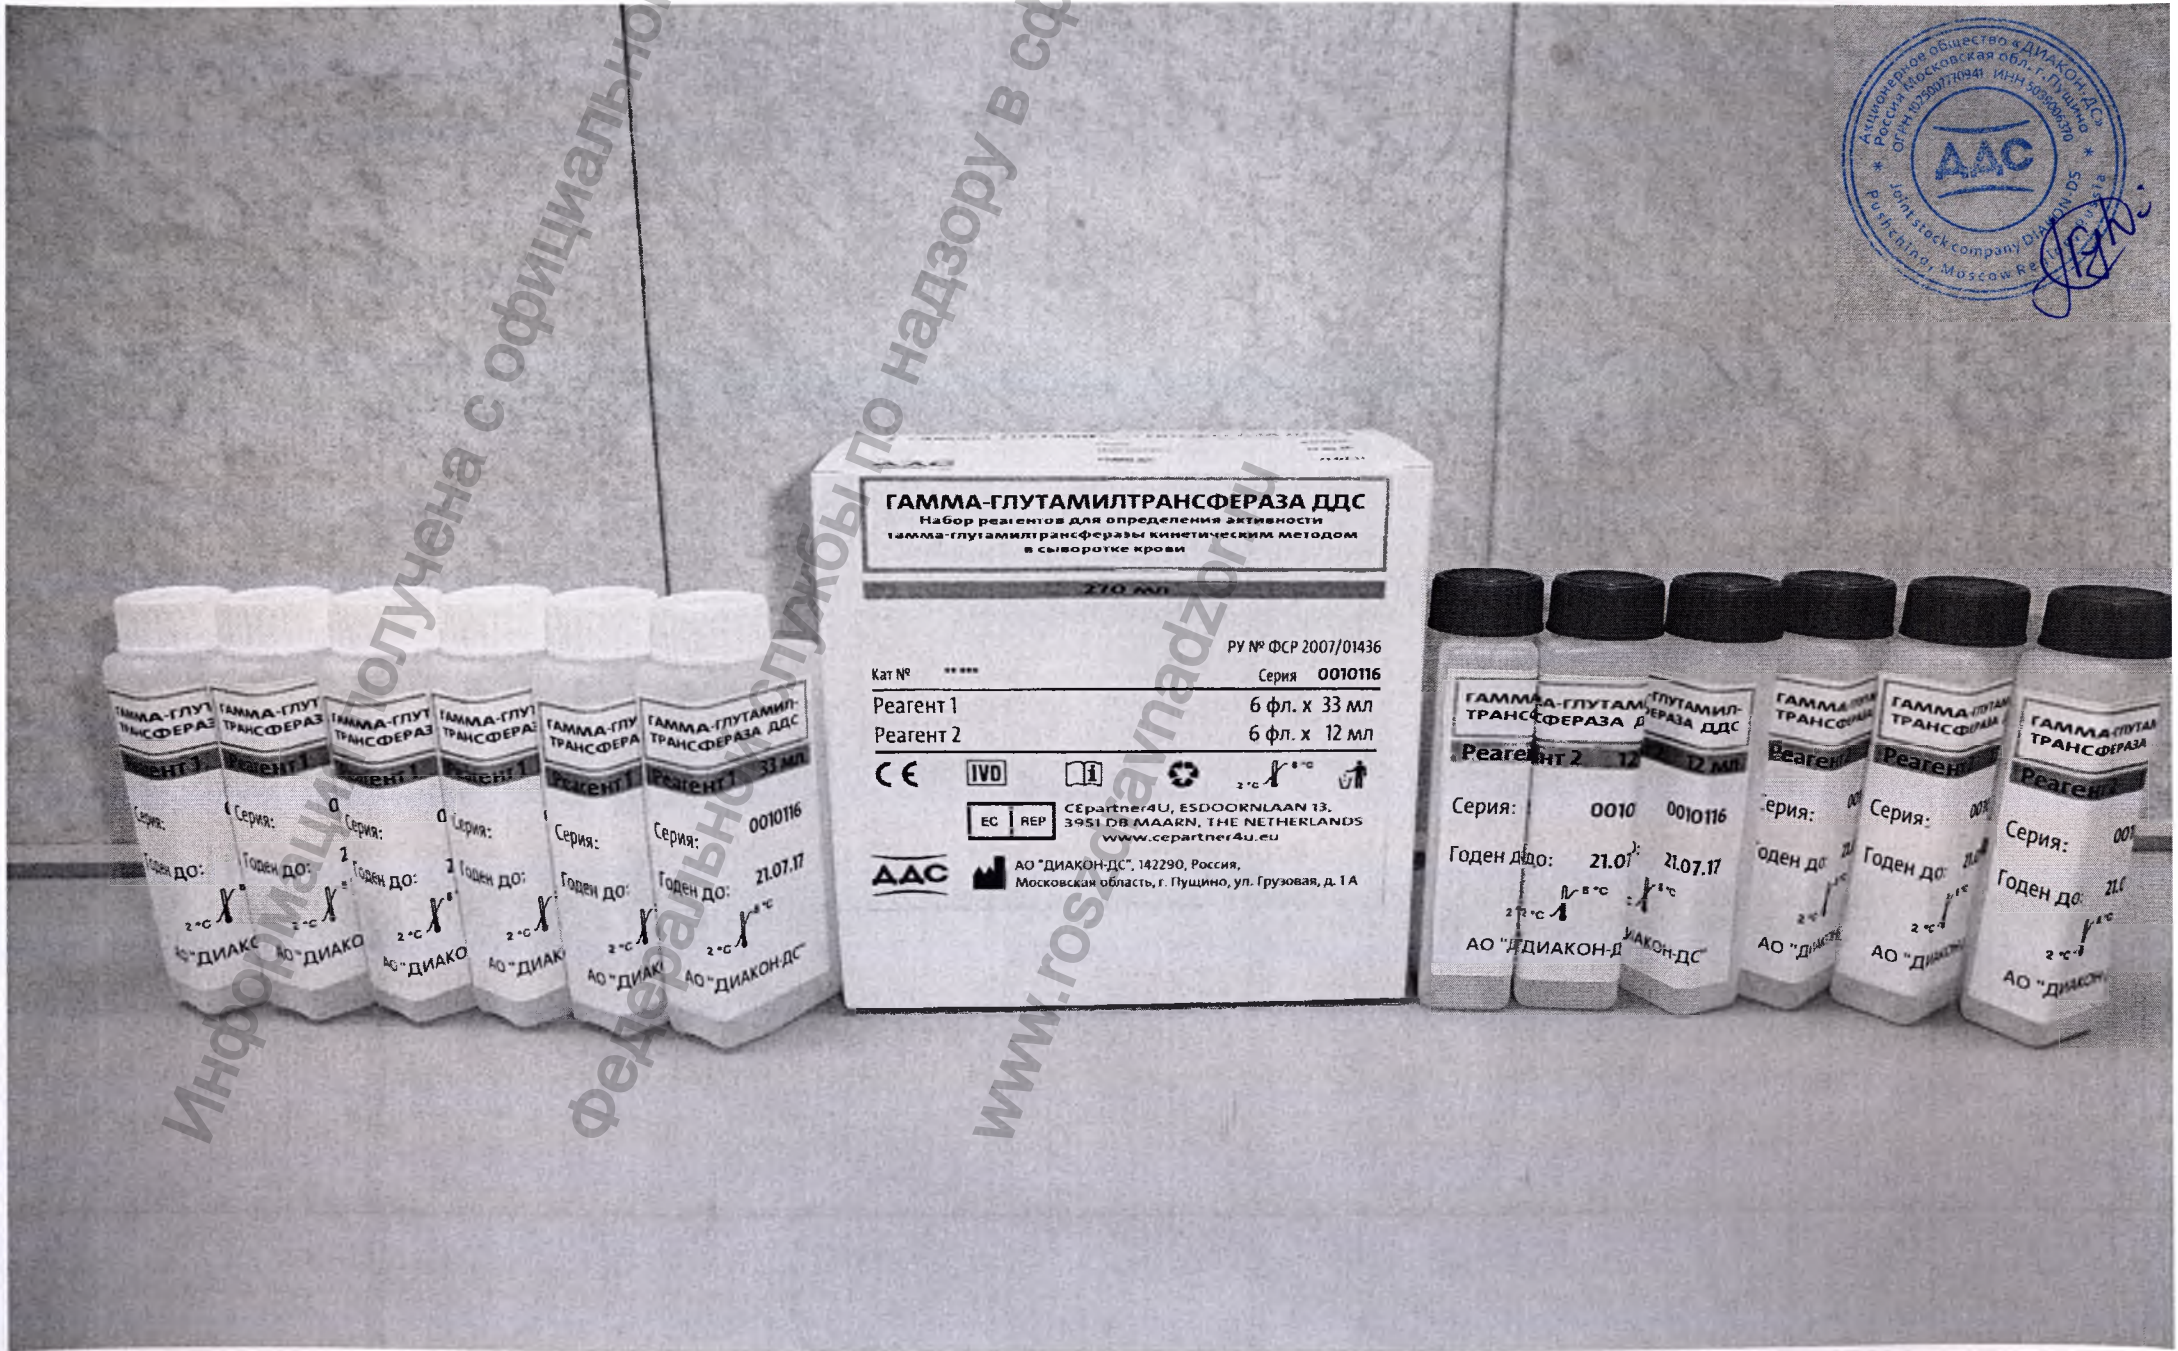

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
Набор реагентов для определения активности
гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом
в сыворотке крови

Кат № ***** RU № ФСР 2007/01436
Серия 0010116

Реагент 1 6 фл. x 33 мл
Реагент 2 6 фл. x 12 мл

CE IVD

Серpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu

АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реагент 2 12 мл



Серия: 0010 0010116
Годен до: 21.07.17 21.07.17

АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)






Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

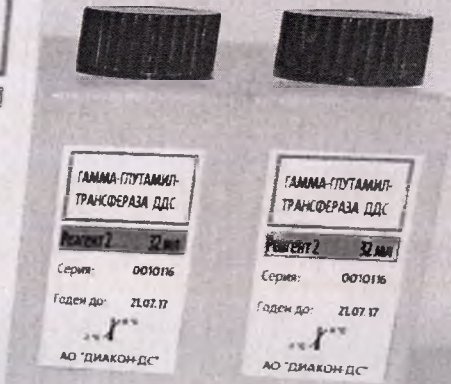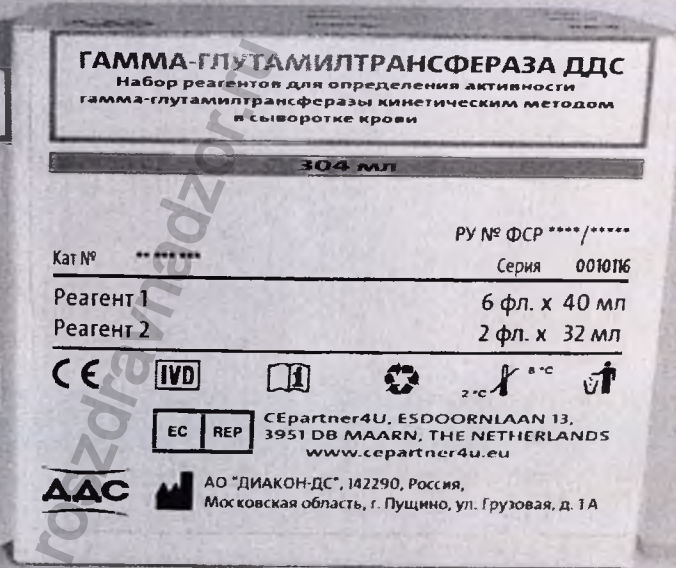


Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gdzdrf.ru


Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

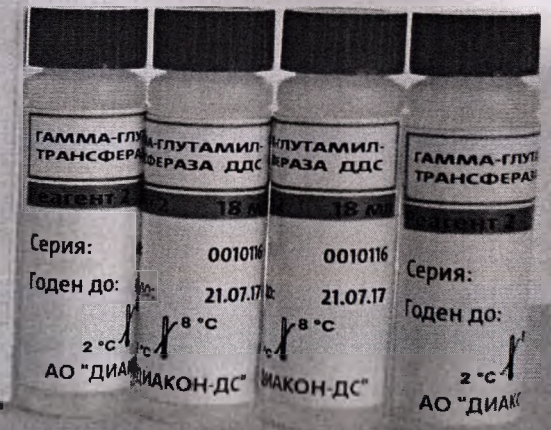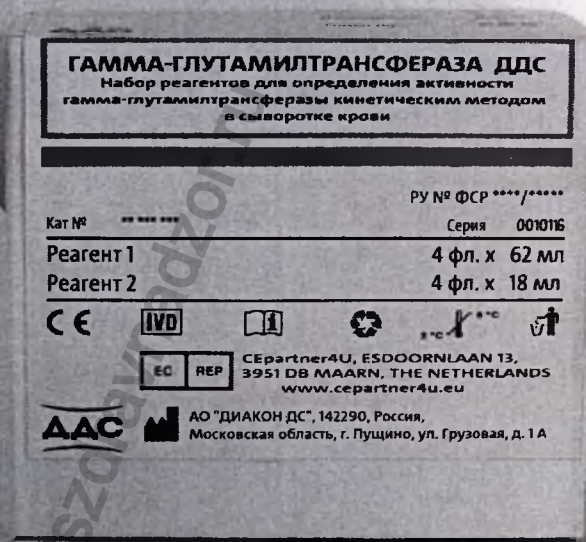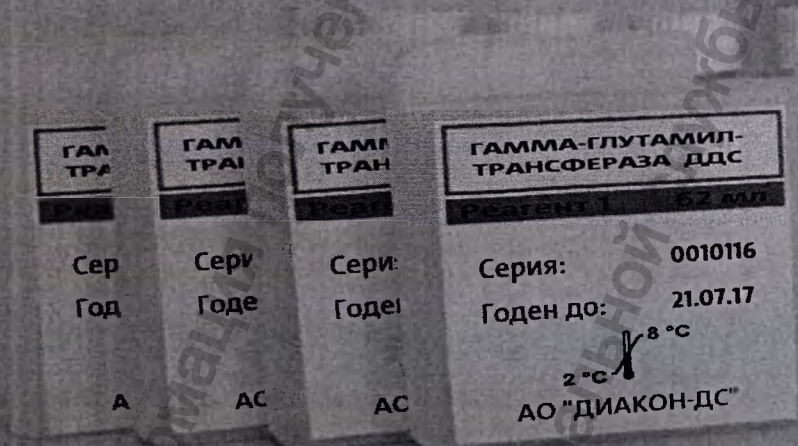


Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

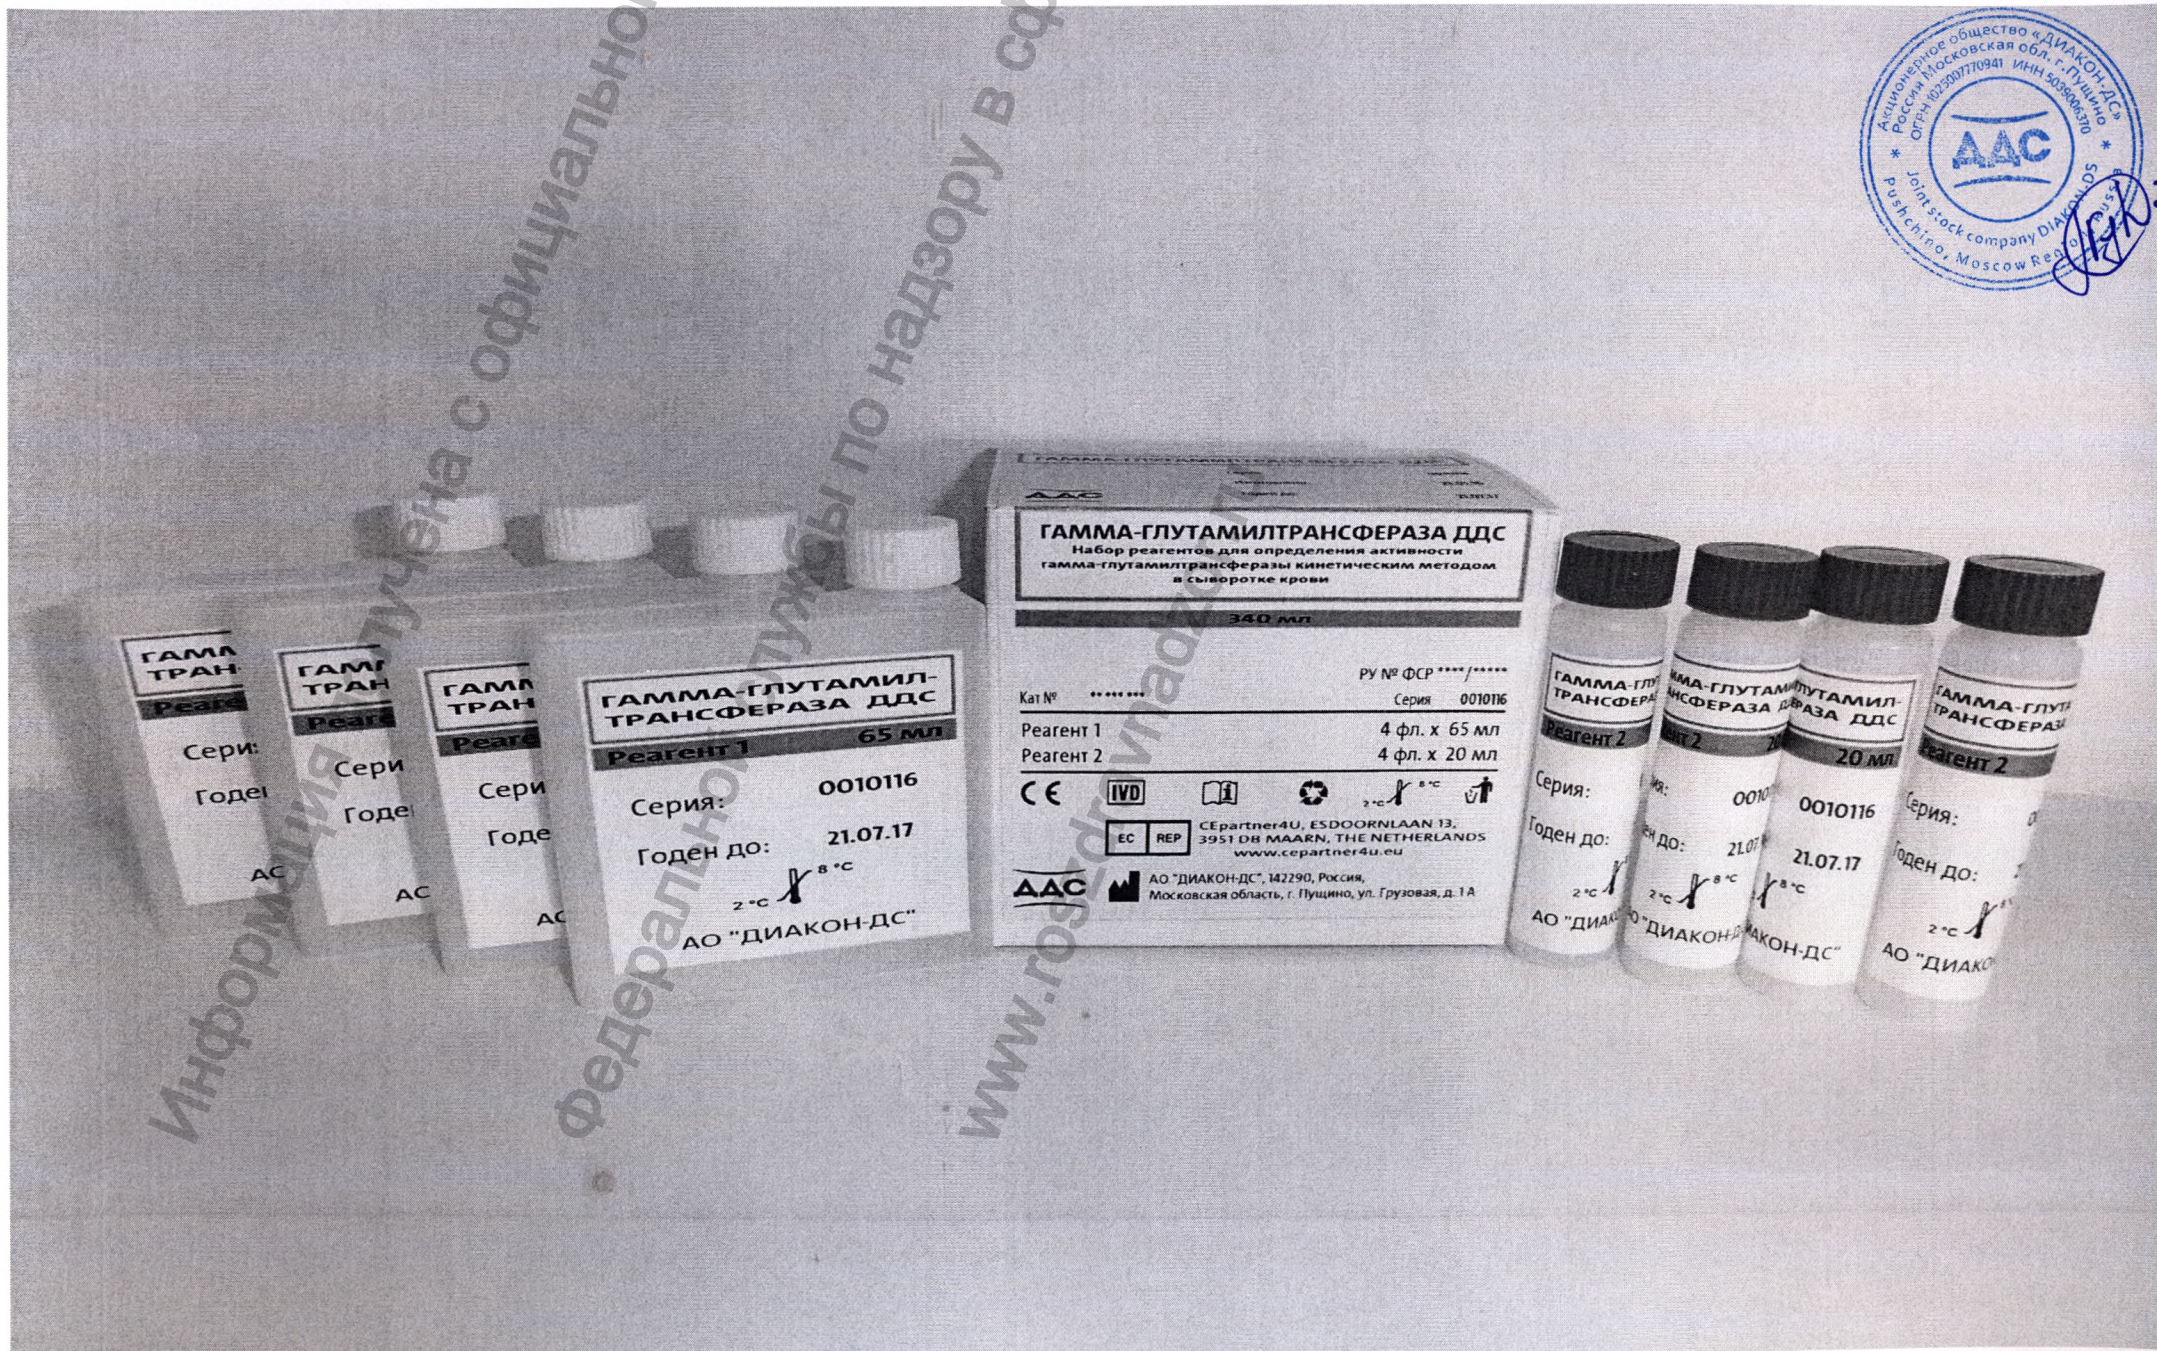

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

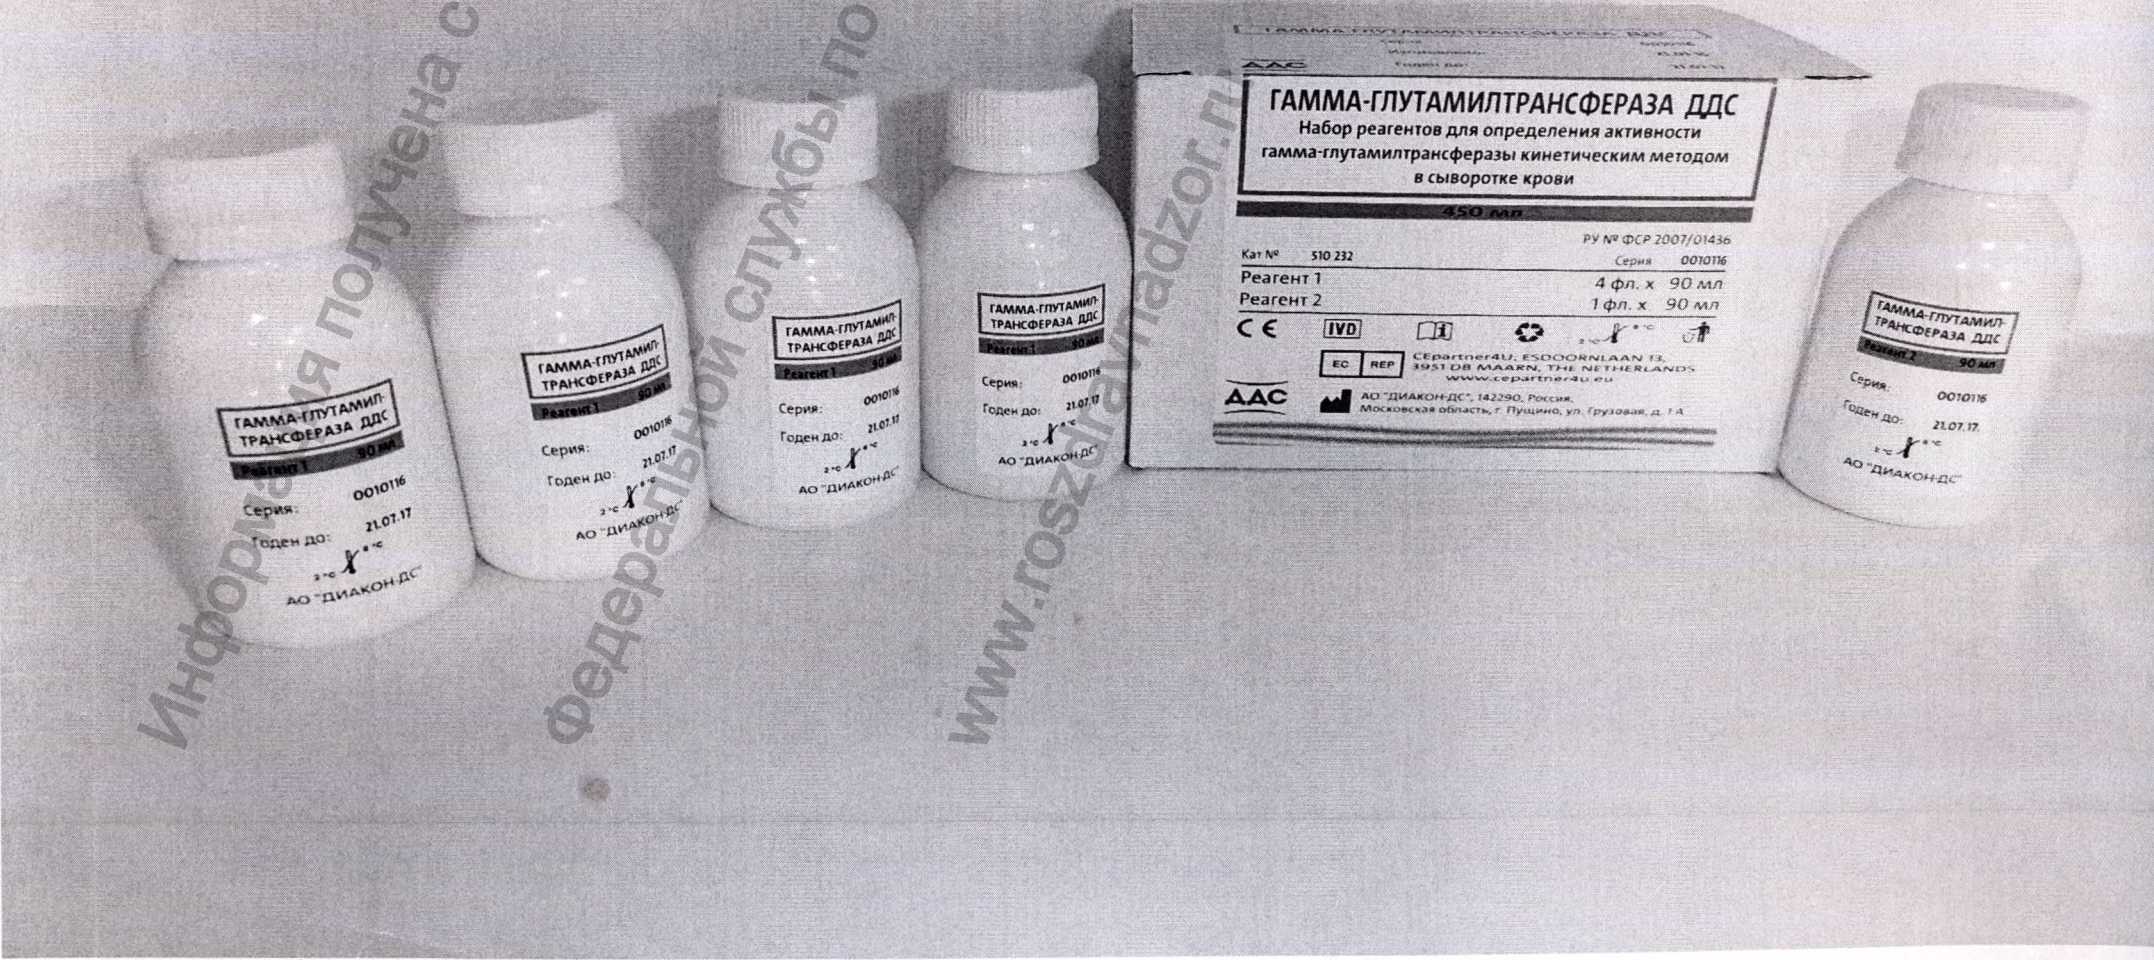

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

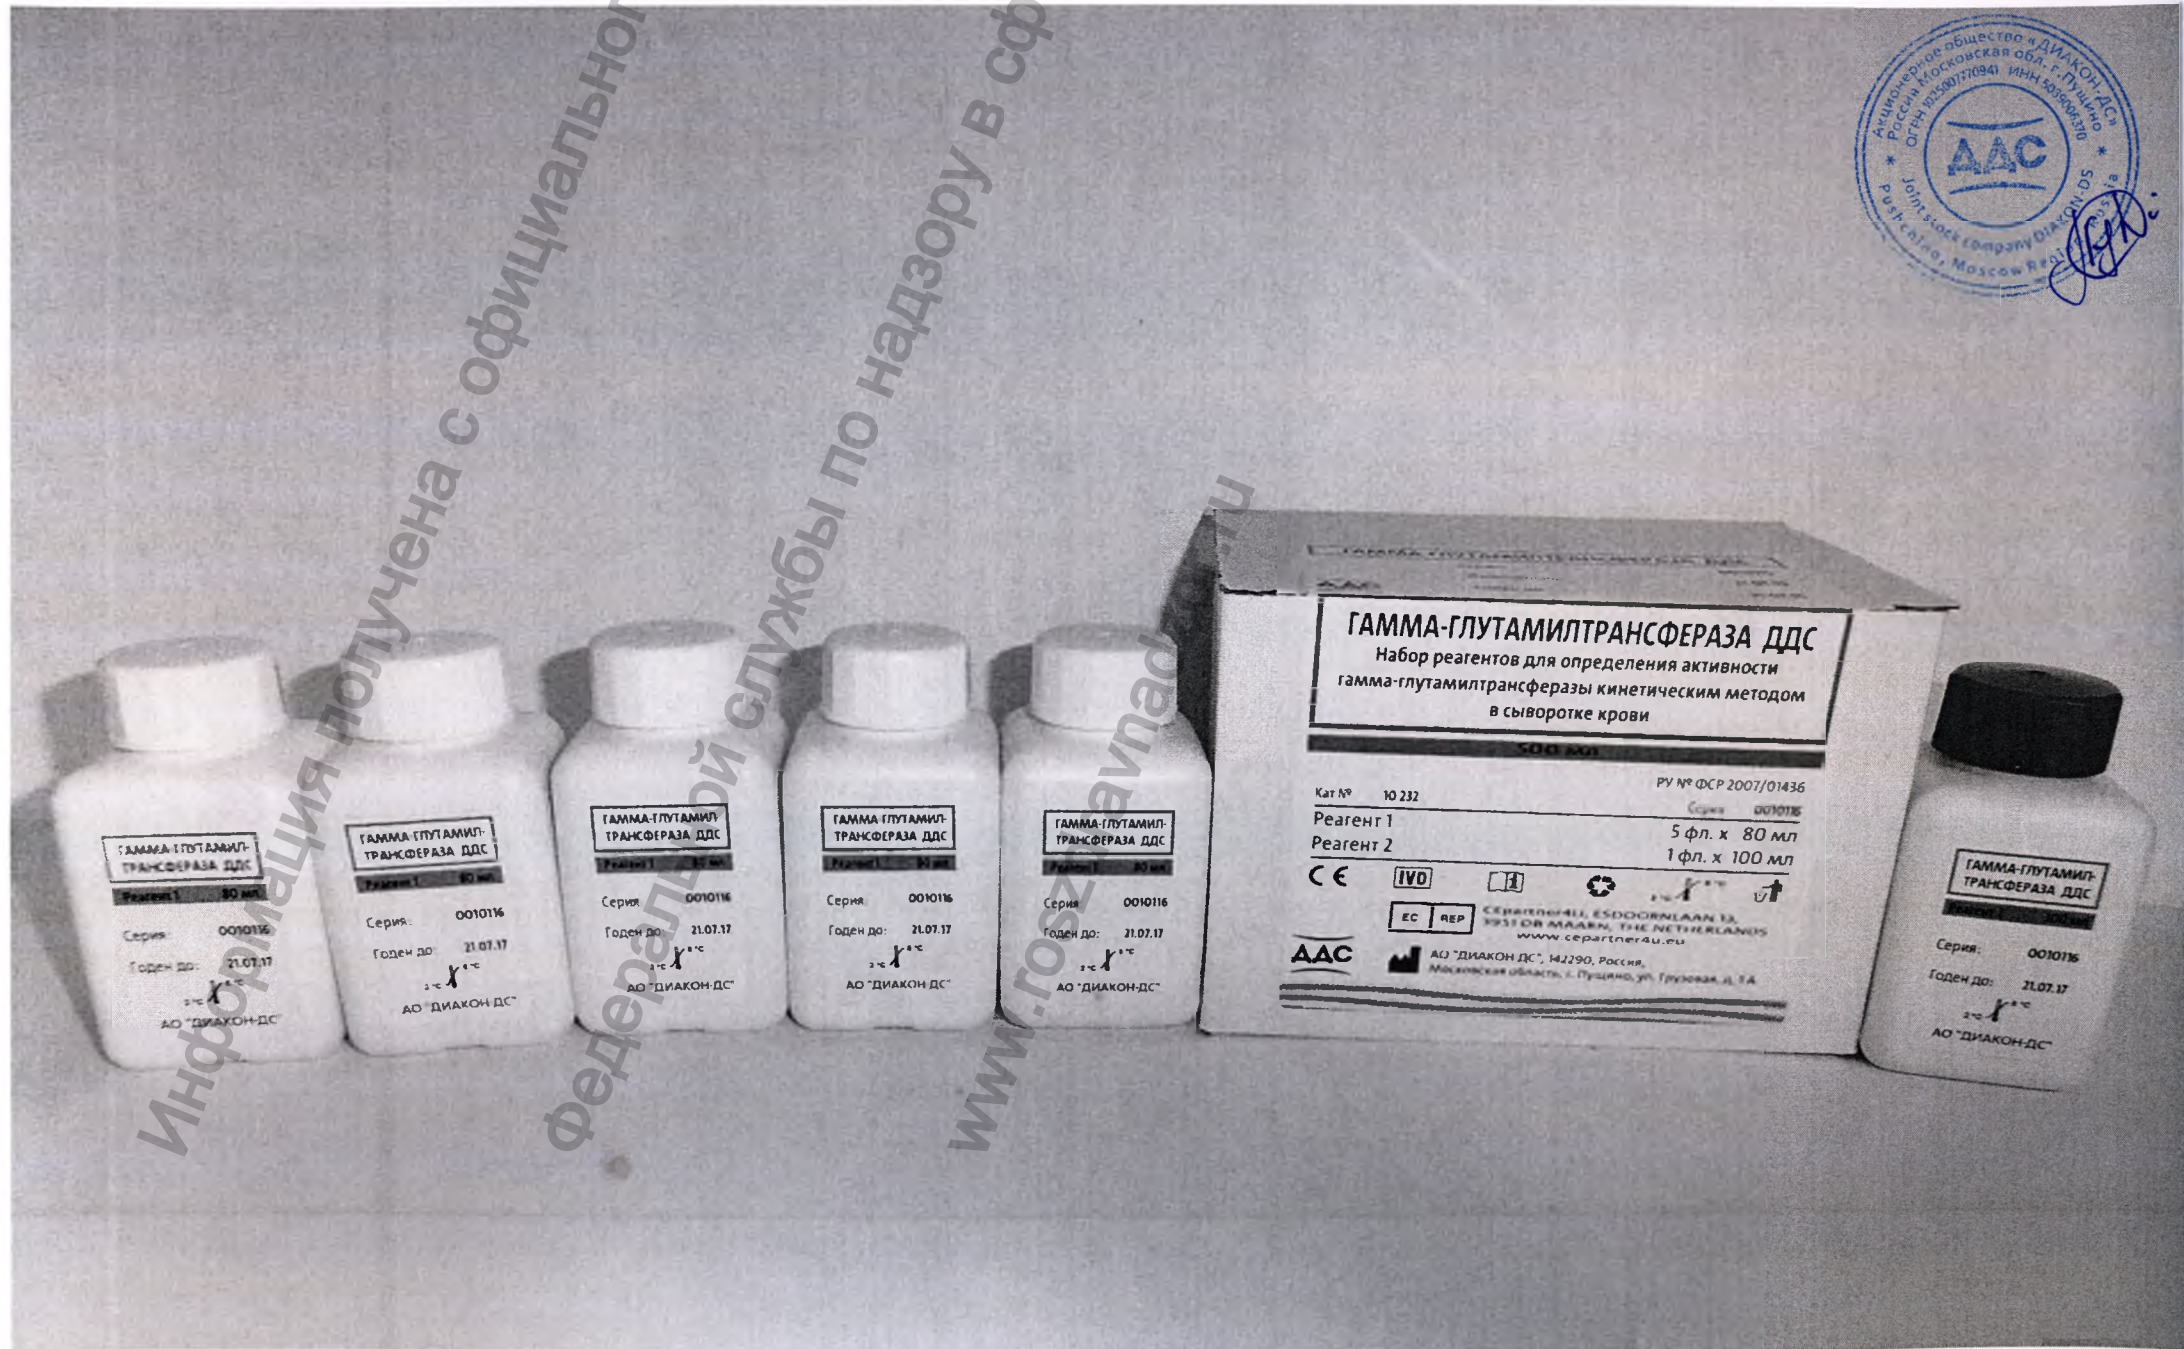

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
Набор реагентов для определения активности
гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом
в сыворотке крови

500 ml

Кат № 10 232 РУ № ФСР 2007/01436

Реагент 1 Серия 001016 5 фл. x 80 мл

Реагент 2 1 фл. x 100 мл

CE IVD EC REP AAC

СЕРТИФИКАТ, ESDOORNLAAN 12,
3931 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner.eu.eu

АО "ДИАКОН ДС", 142290, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-
ТРАНСФЕРАЗА ДДС

Реагент 1 80 мл

Серия: 001016

Годен до: 21.07.17

2-8°C

АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-
ТРАНСФЕРАЗА ДДС

Реагент 1 80 мл

Серия: 001016

Годен до: 21.07.17

2-8°C

АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-
ТРАНСФЕРАЗА ДДС

Реагент 1 80 мл

Серия: 001016

Годен до: 21.07.17

2-8°C

АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-
ТРАНСФЕРАЗА ДДС

Реагент 1 80 мл

Серия: 001016

Годен до: 21.07.17

2-8°C

АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-
ТРАНСФЕРАЗА ДДС

Реагент 1 80 мл

Серия: 001016

Годен до: 21.07.17

2-8°C

АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-
ТРАНСФЕРАЗА ДДС


Серия: 001016

Годен до: 21.07.17


2-8°C

АО "ДИАКОН-ДС"


Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

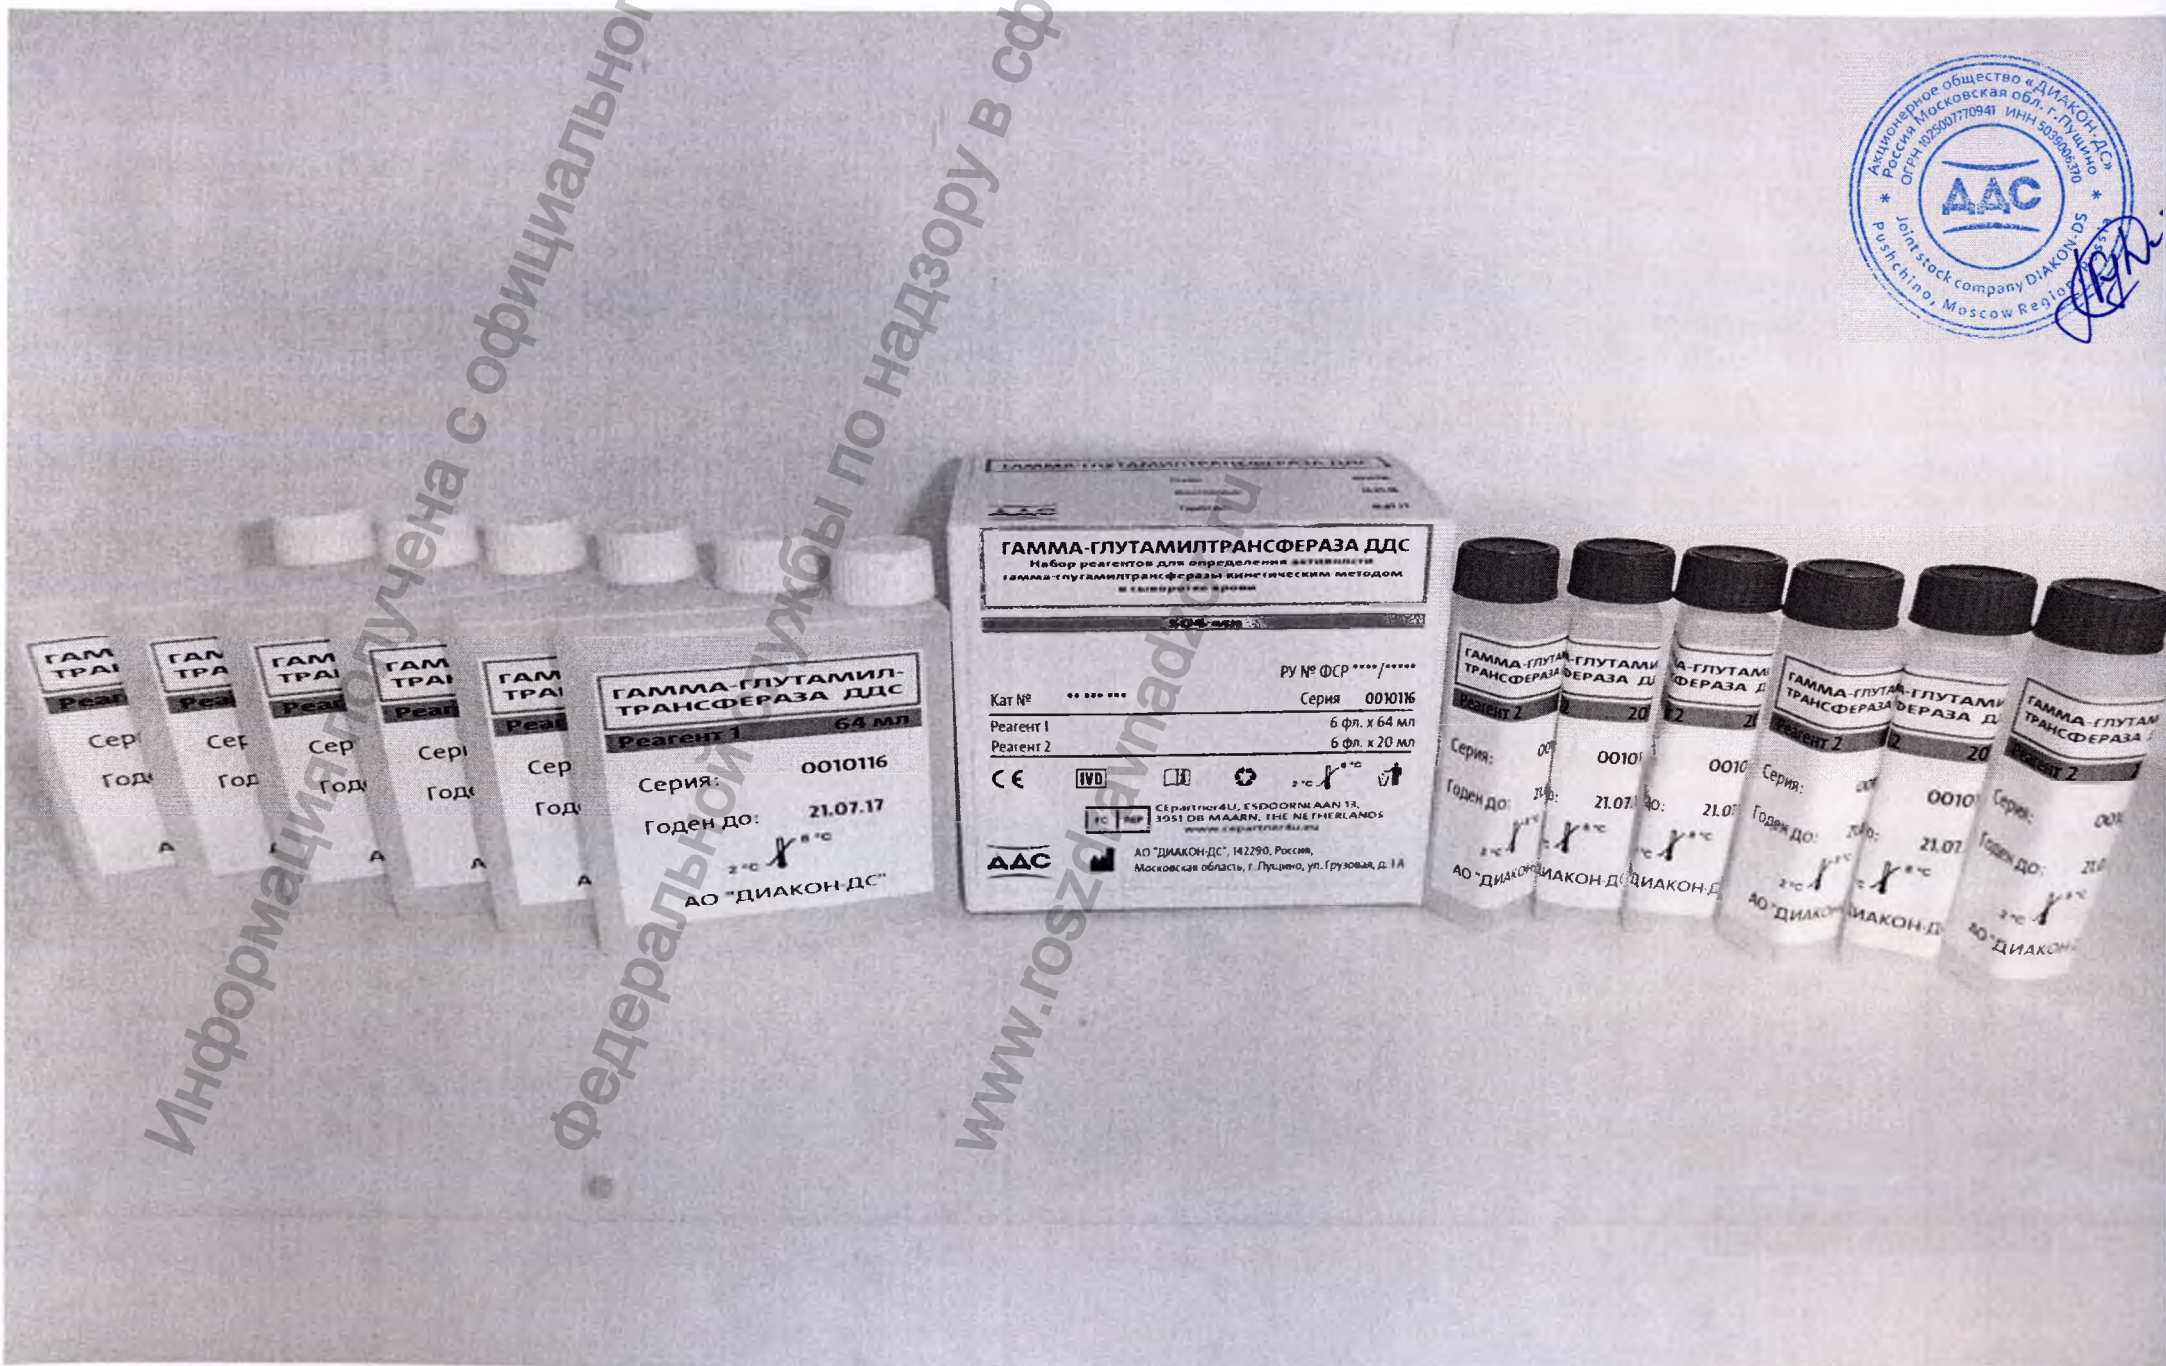

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

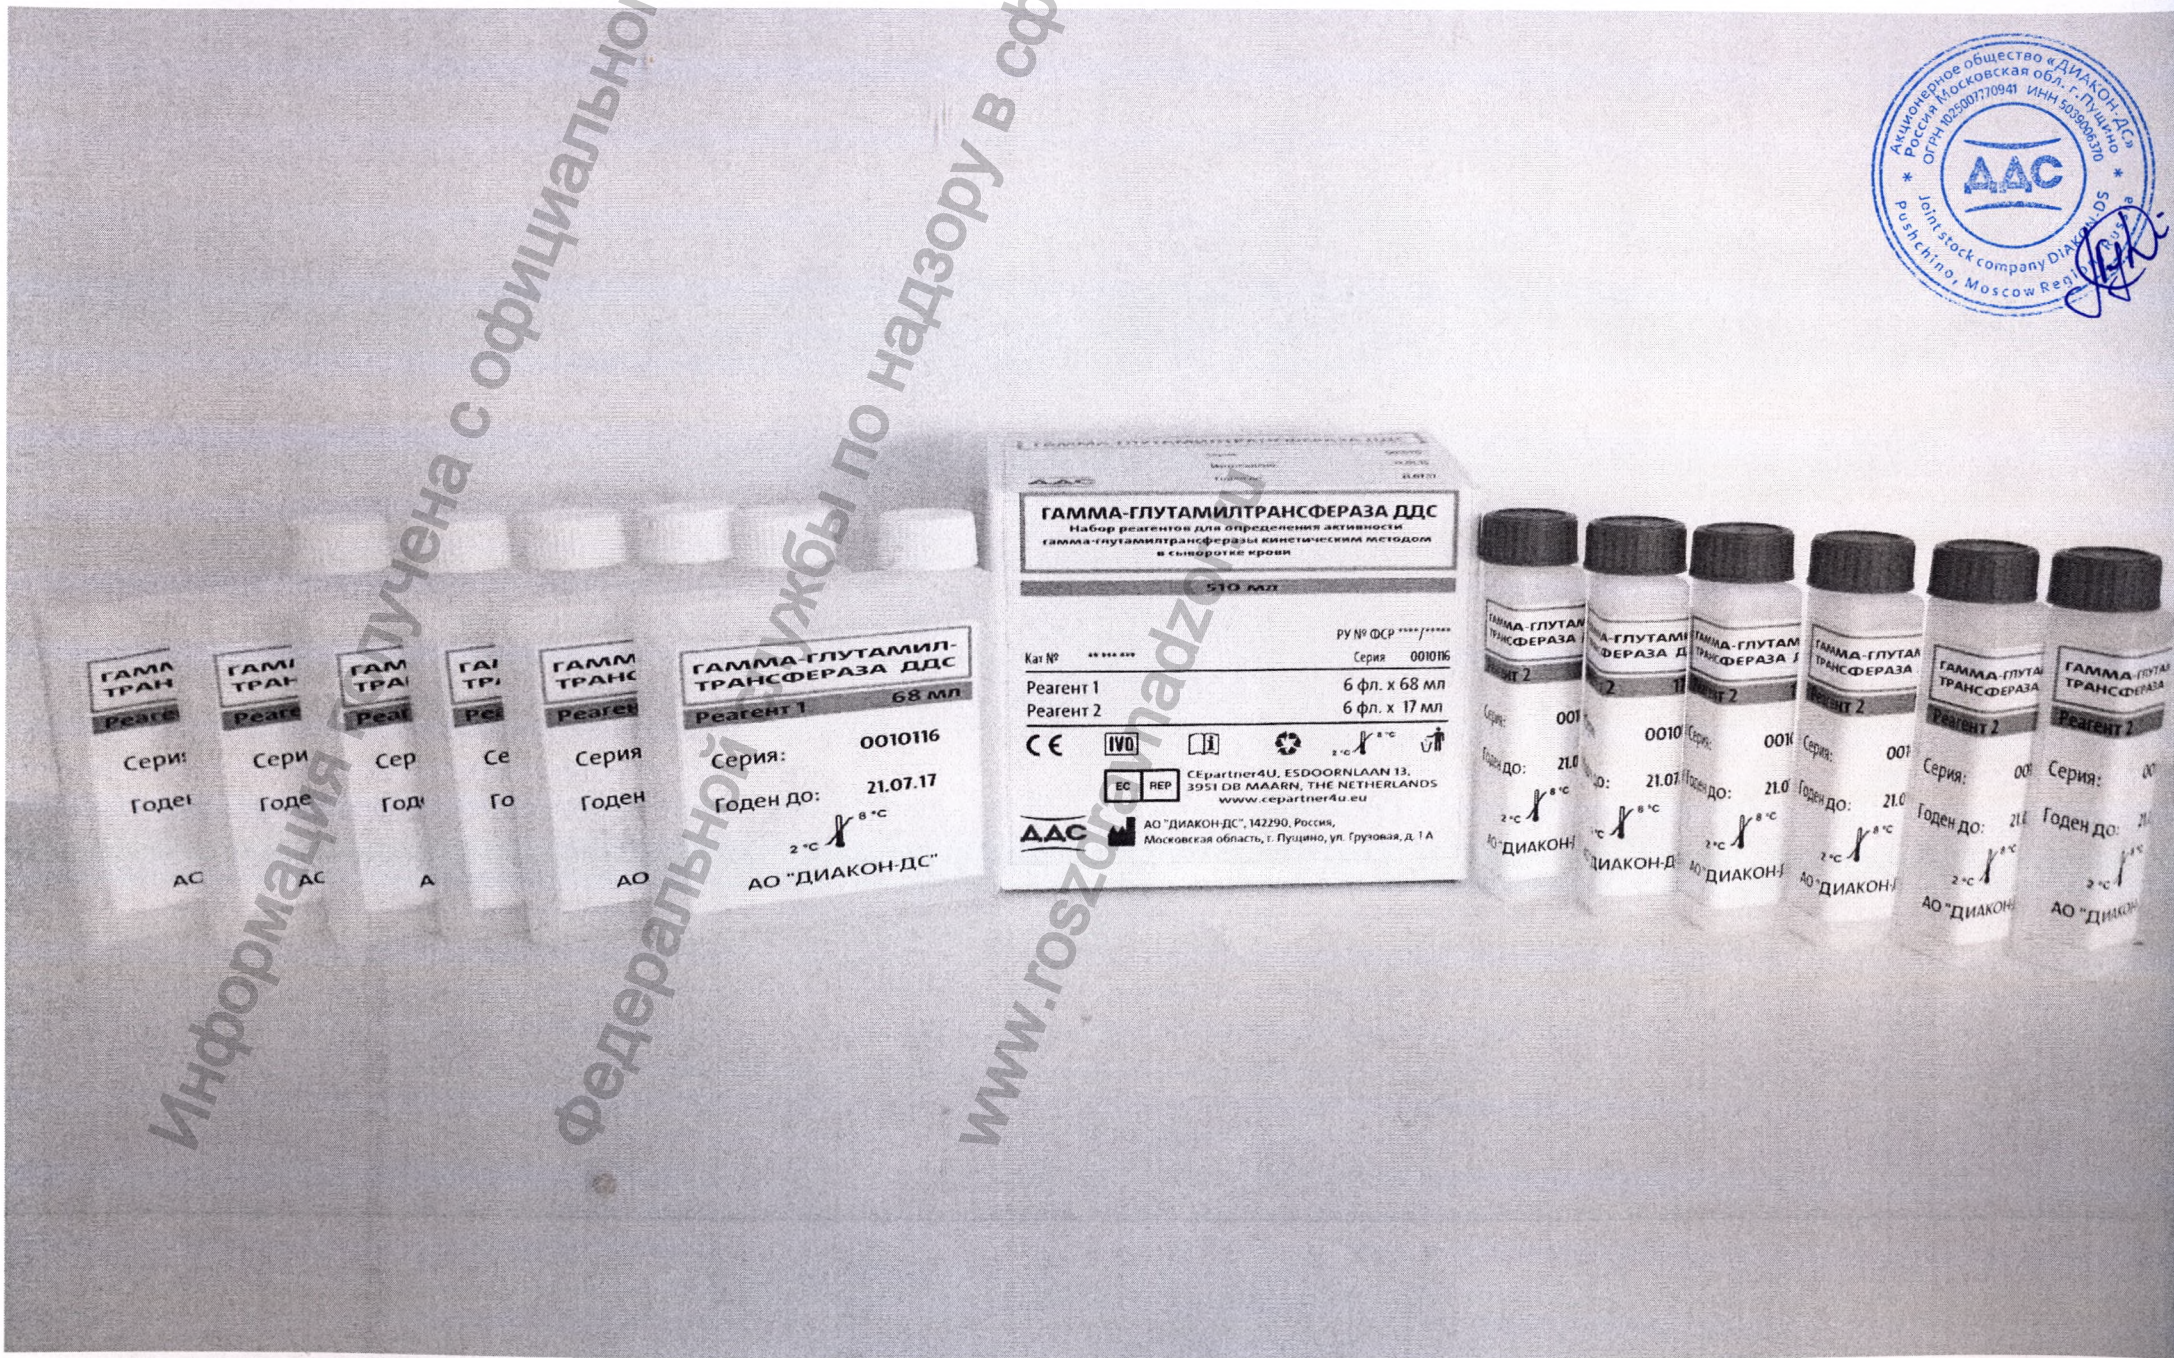

Внешний вид
Набора реактивов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

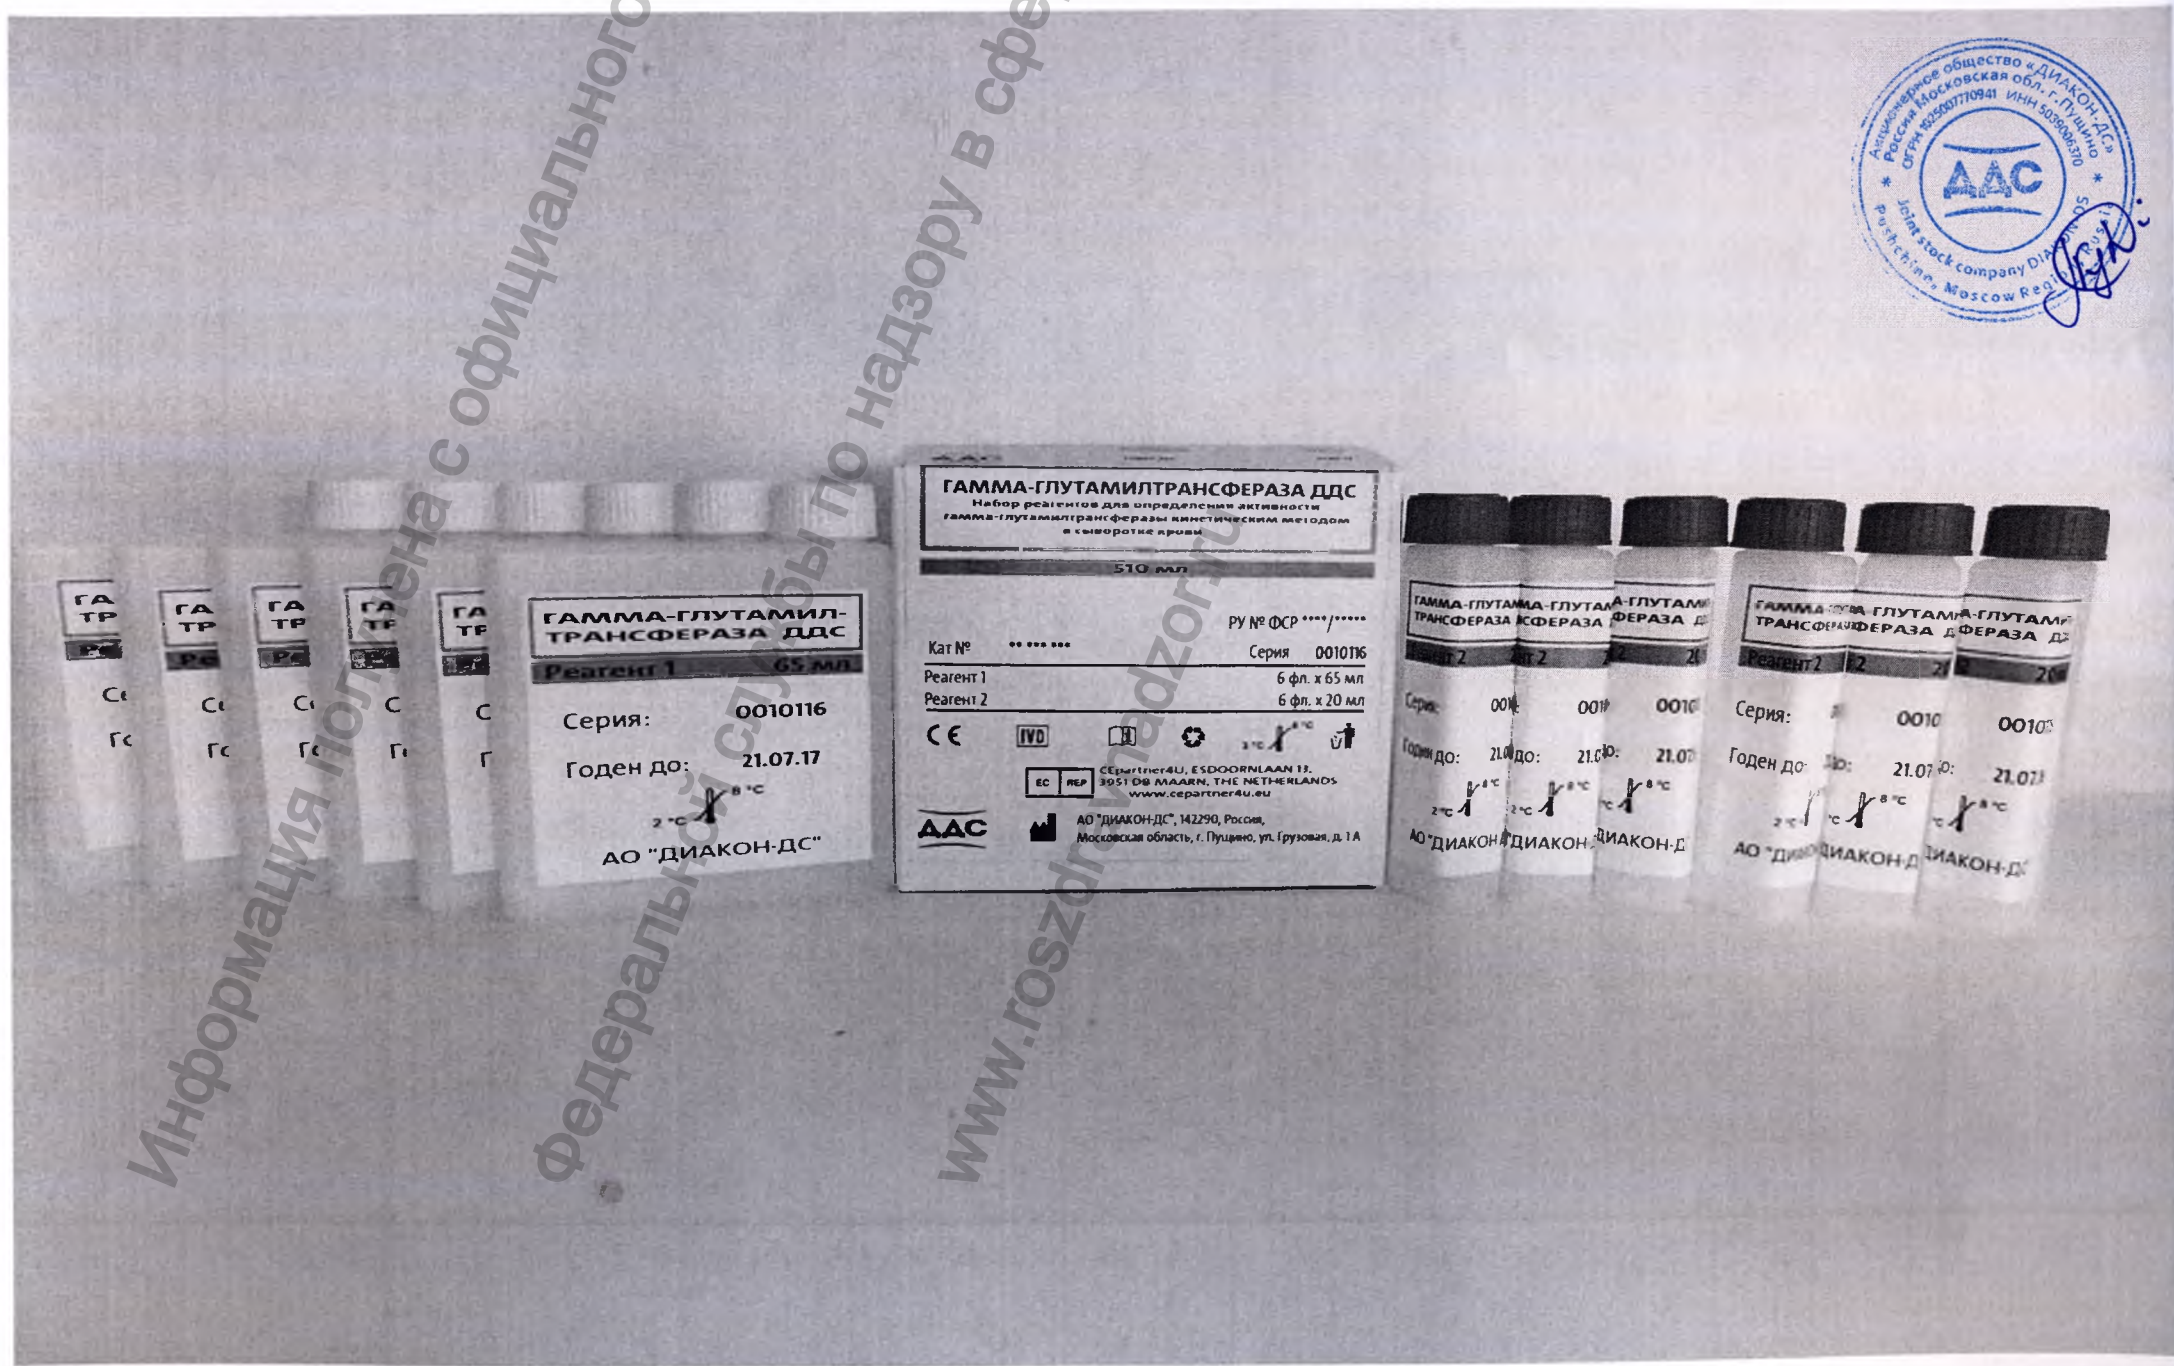

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС
 Набор реактивов для определения активности
 гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом
 в сыворотке крови

510 мл

Кат № РУ № ФСР *****
 Серия 0010116

Реагент 1 6 фл. х 65 мл
 Реагент 2 6 фл. х 20 мл

CE IVD

CE REP CEpartner4U, ESDOORNLAAN 12,
 3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
 www.cepartner4u.eu

АО «ДИАКОН-ДС», 142290, Россия,
 Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

**ГАММА-ГЛУТАМИЛ-
ТРАНСФЕРАЗА ДДС**

Реагент 1 65 мл

Серия: 0010116
 Годен до: 21.07.17

25°C 37°C

АО «ДИАКОН-ДС»

**ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ГЛУТАМИЛ-ГЛУТАМИЛ-
ТРАНСФЕРАЗА ТРАНСФЕРАЗА ТРАНСФЕРАЗА**

Реагент 2 20 мл

Серия: 0010 0010 0010
 Годен до: 21.07.17 21.07.17 21.07.17

25°C 37°C

АО «ДИАКОН-ДС»

Информация получена с официального сайта
 Федеральны...
 www.goszdrnadzor.ru

Внешний вид
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

