

УТВЕРЖДАЮ
Первый Заместитель
Генерального директора
ООО НПО «ИРЭ-Полус»
Ушаков А.Б.




Ушаков 2017 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
на медицинское изделие

Аппарат лазерный хирургический повышенной мощности
«FiberLase U1» по ТУ 9444-051-18003536-2015

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdraznadzor.ru

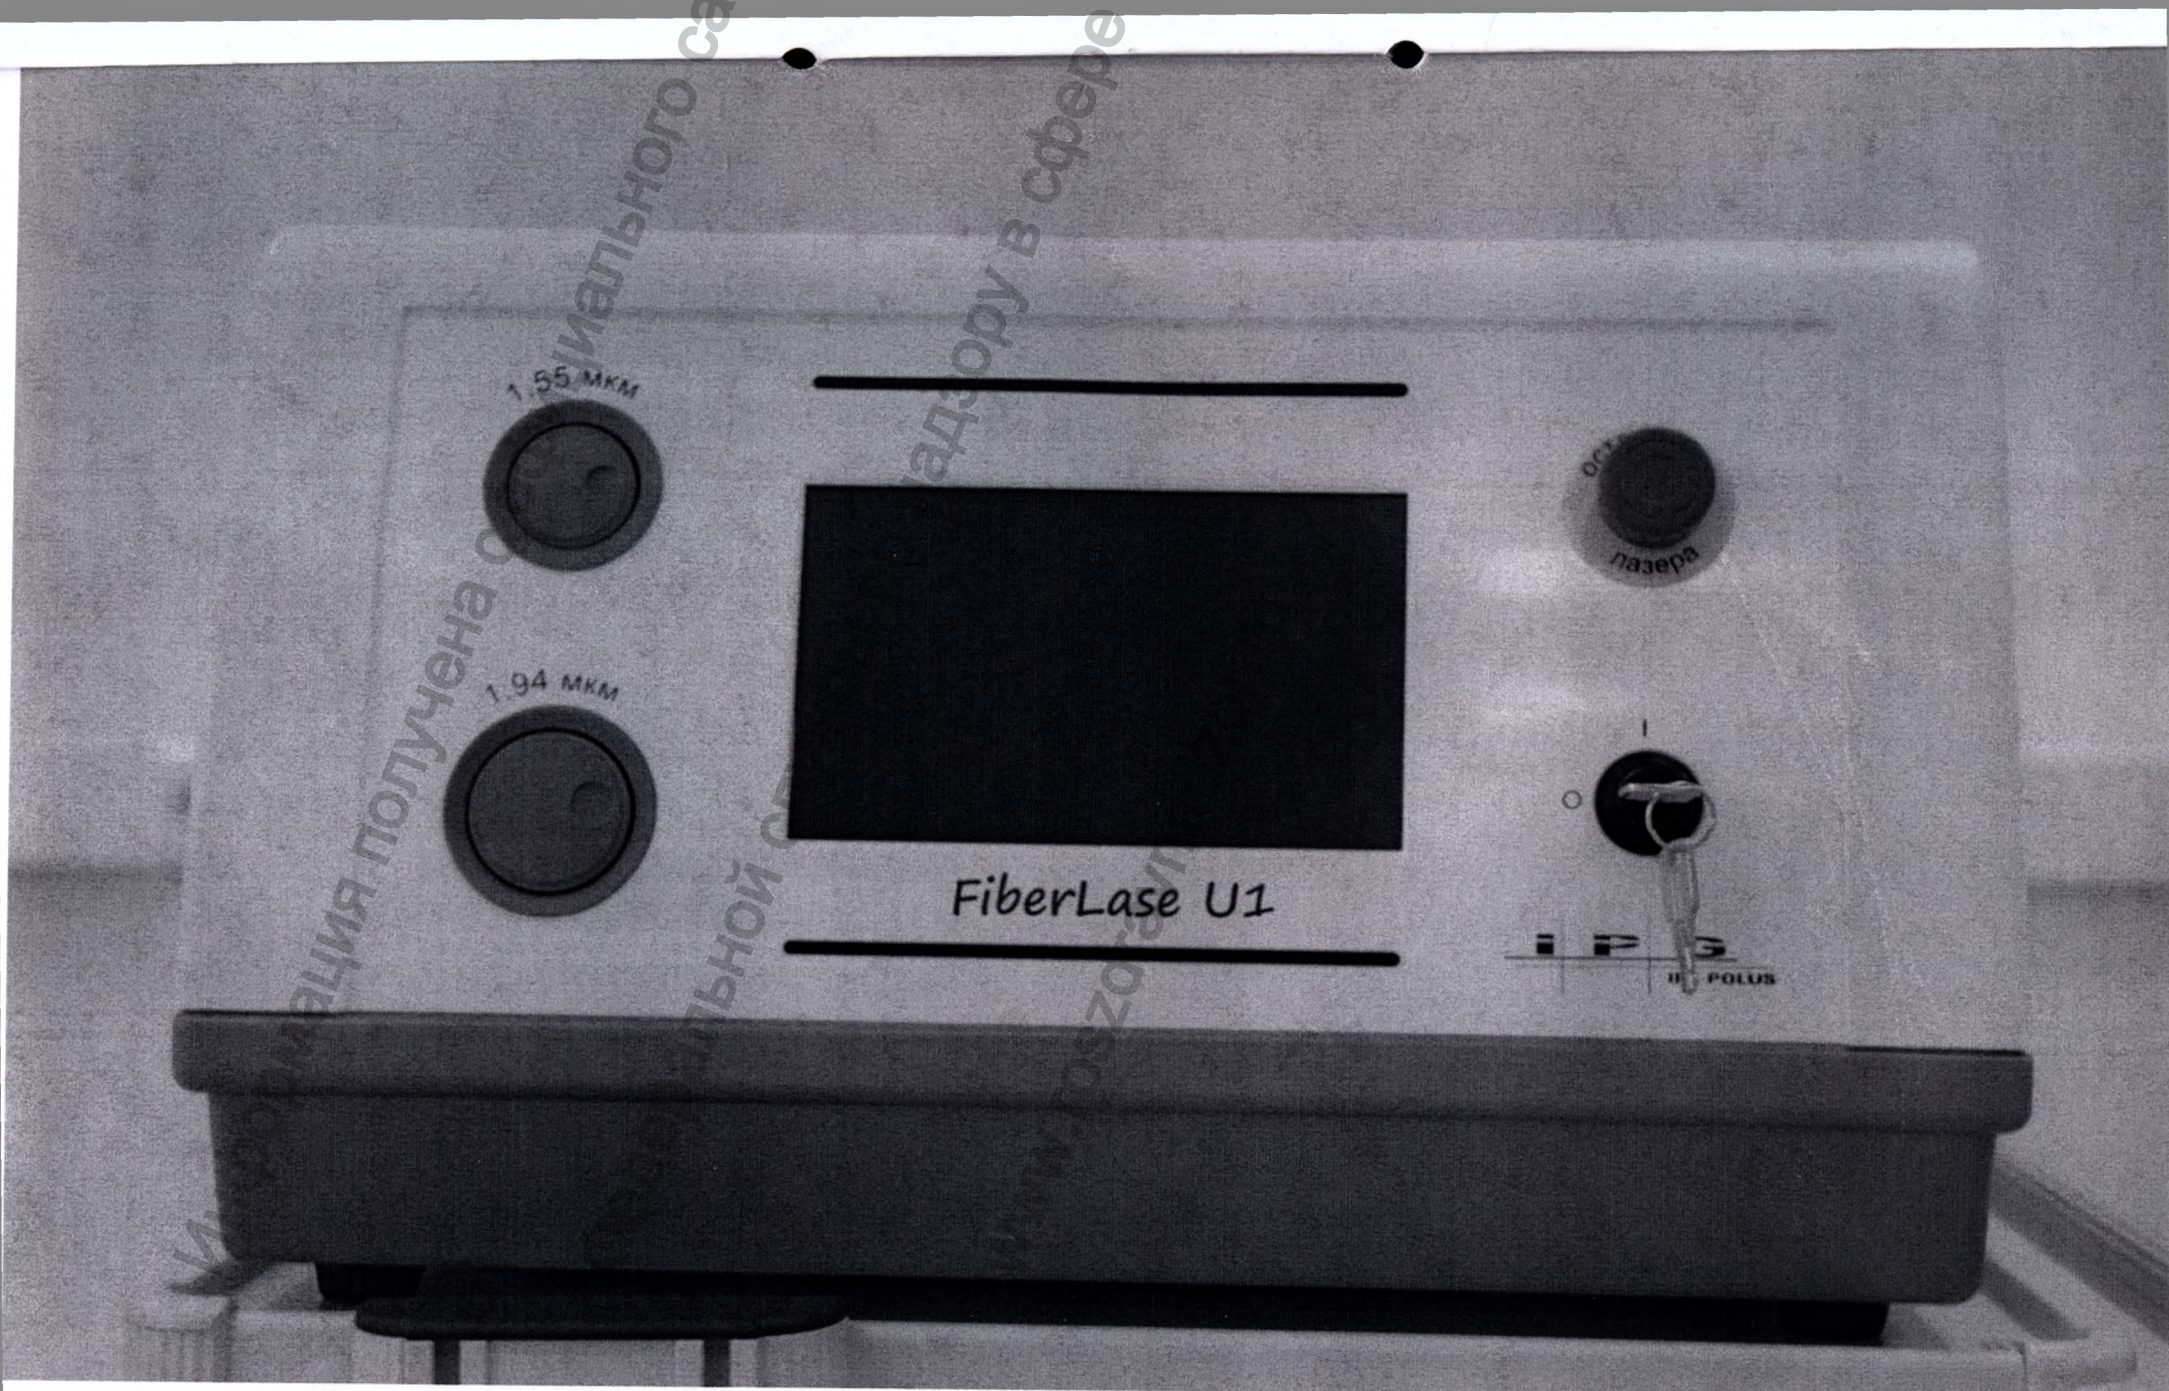


Аппарат лазерный хирургический повышенной мощности «FiberLase U1»

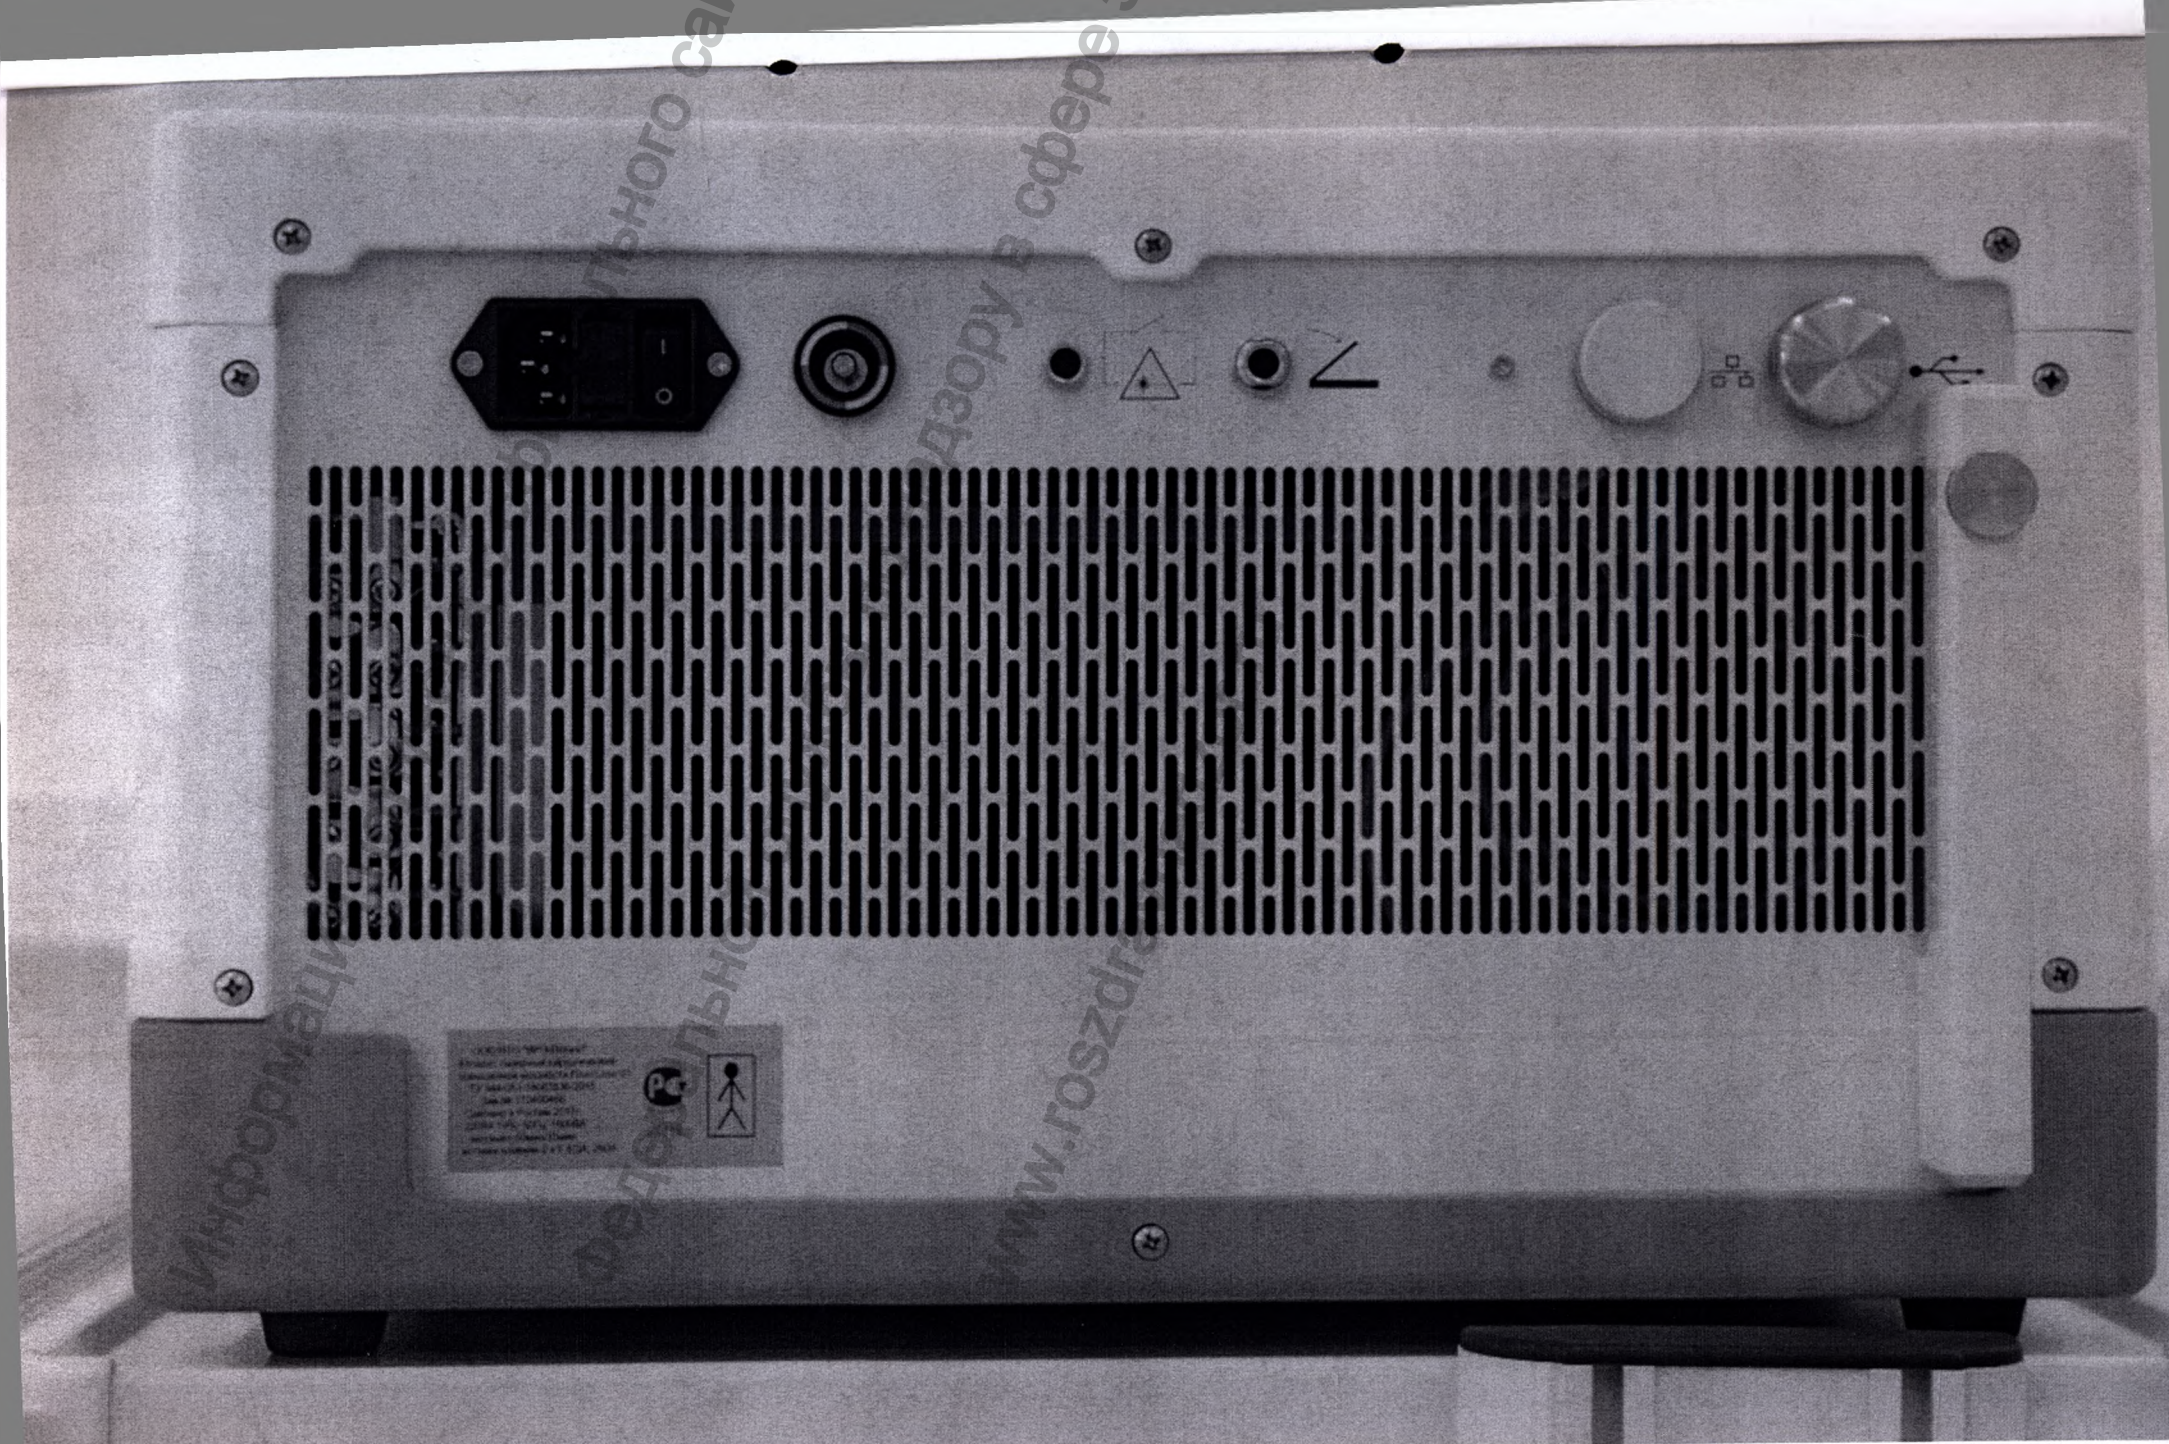

Аппарат лазерный хирургический повышенной мощности «FiberLase U1», вид сзади

свойей интеллектуальной собственности «Eiherl» аса ПП»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.ru

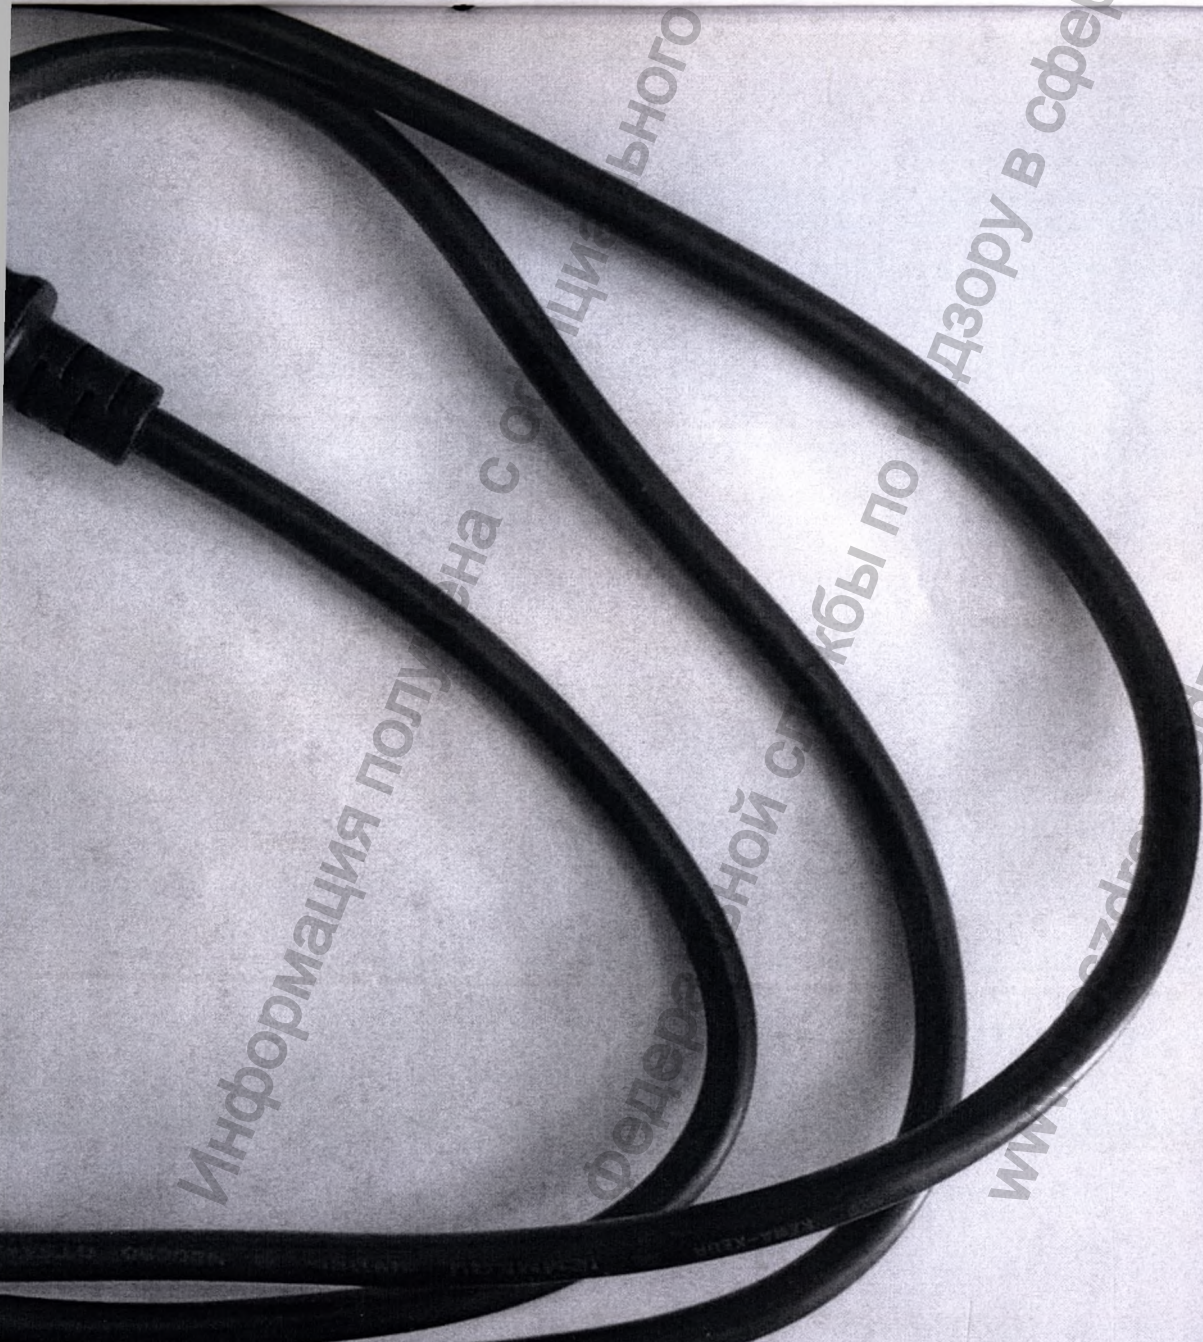

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.roszdrnadzor.ru

Шнур питания



Педаль включения излучения: слева – в открытом состоянии, справа – в закрытом

steute Medizintechnik
MKF 1S-MED-SK12


REF 1283137
25 V AC / 60 V DC
IEC 60601-1 / EN 60601-1
IP X8

SN 00094
LOT 4B9

CE


steute Schaltungsgeräte für die Medizin

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.goszdravnadzor.ru

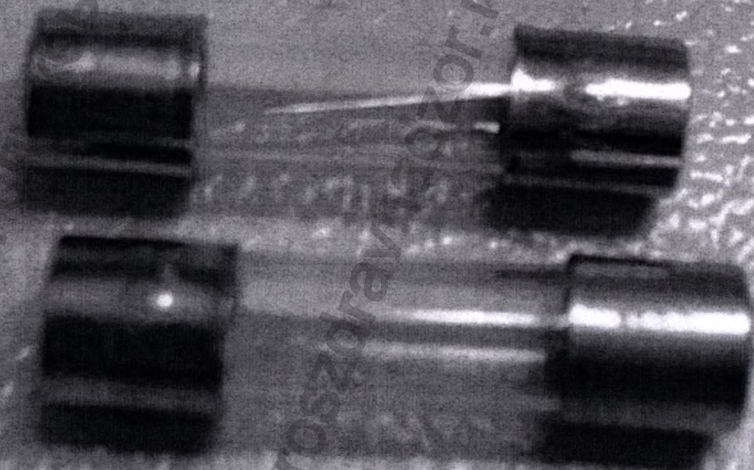

Вставки плавкие

Транспортная упаковка

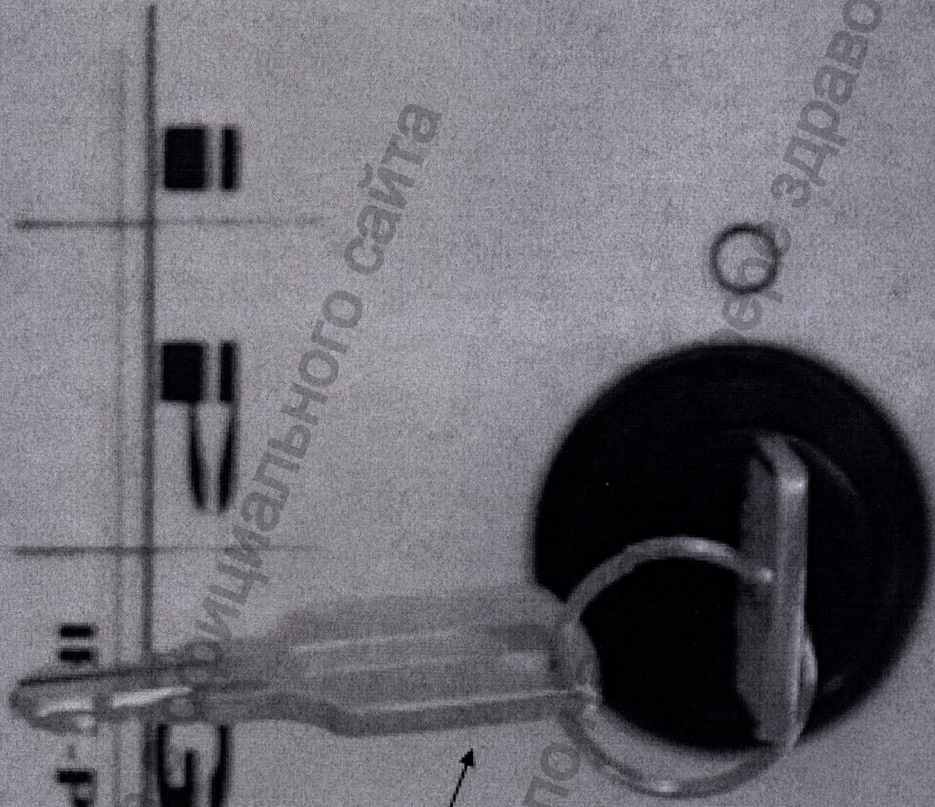

Ключ замка блокировки


Информация по ит-полосу

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Министерства здравоохранения Российской Федерации

www.goszdramnadzor.ru

получена с официального сайта
www.novos.ru
подлежит государственному надзору в сфере

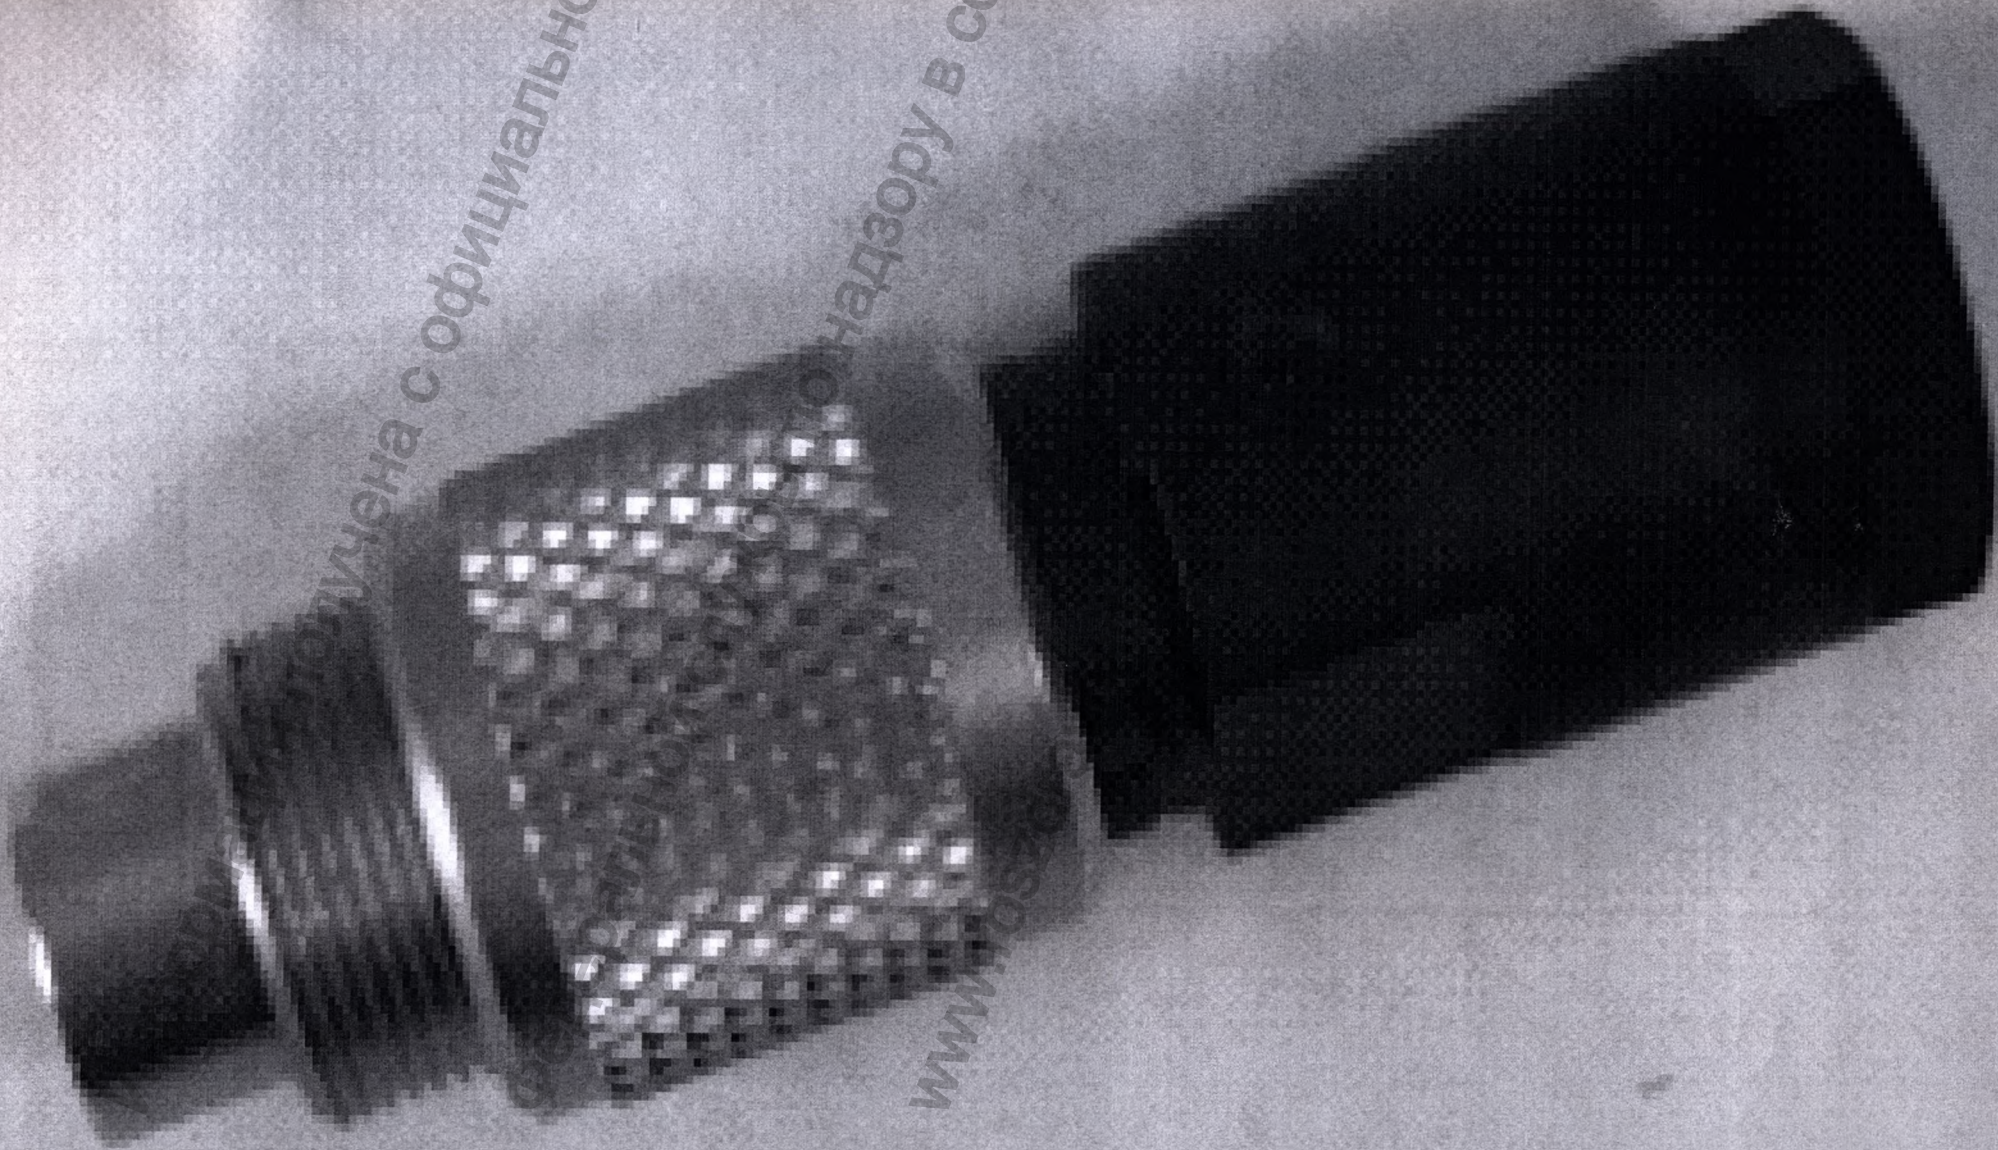

Заглушка внешней блокировки

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.gosdrazhnadzor.ru

Инструмент волоконный

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору

www.goszdravnadzor.ru

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью
ООО НТО «ИРЭ-Полюс»
лист



ГЕН. ДИРЕКТОРА
Э - ПОЛЮС
А. Б.
ИДЕНТИФИКАЦИОННОСТИ
№3-2434 от 05.09.2014