

75
Years

Shaping the Future of Endoscopy with you


STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия, 115114, Москва, Дербеневская наб. 7, стр. 4

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**ПОМПА ЭНДСКОПИЧЕСКАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ «HYSTEROMAT E.A.S.I.»
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЛАПАРОСКОПИИ И ГИНЕКОЛОГИИ**

1. Помпа эндоскопическая автоматическая «HYSTEROMAT E.A.S.I.»

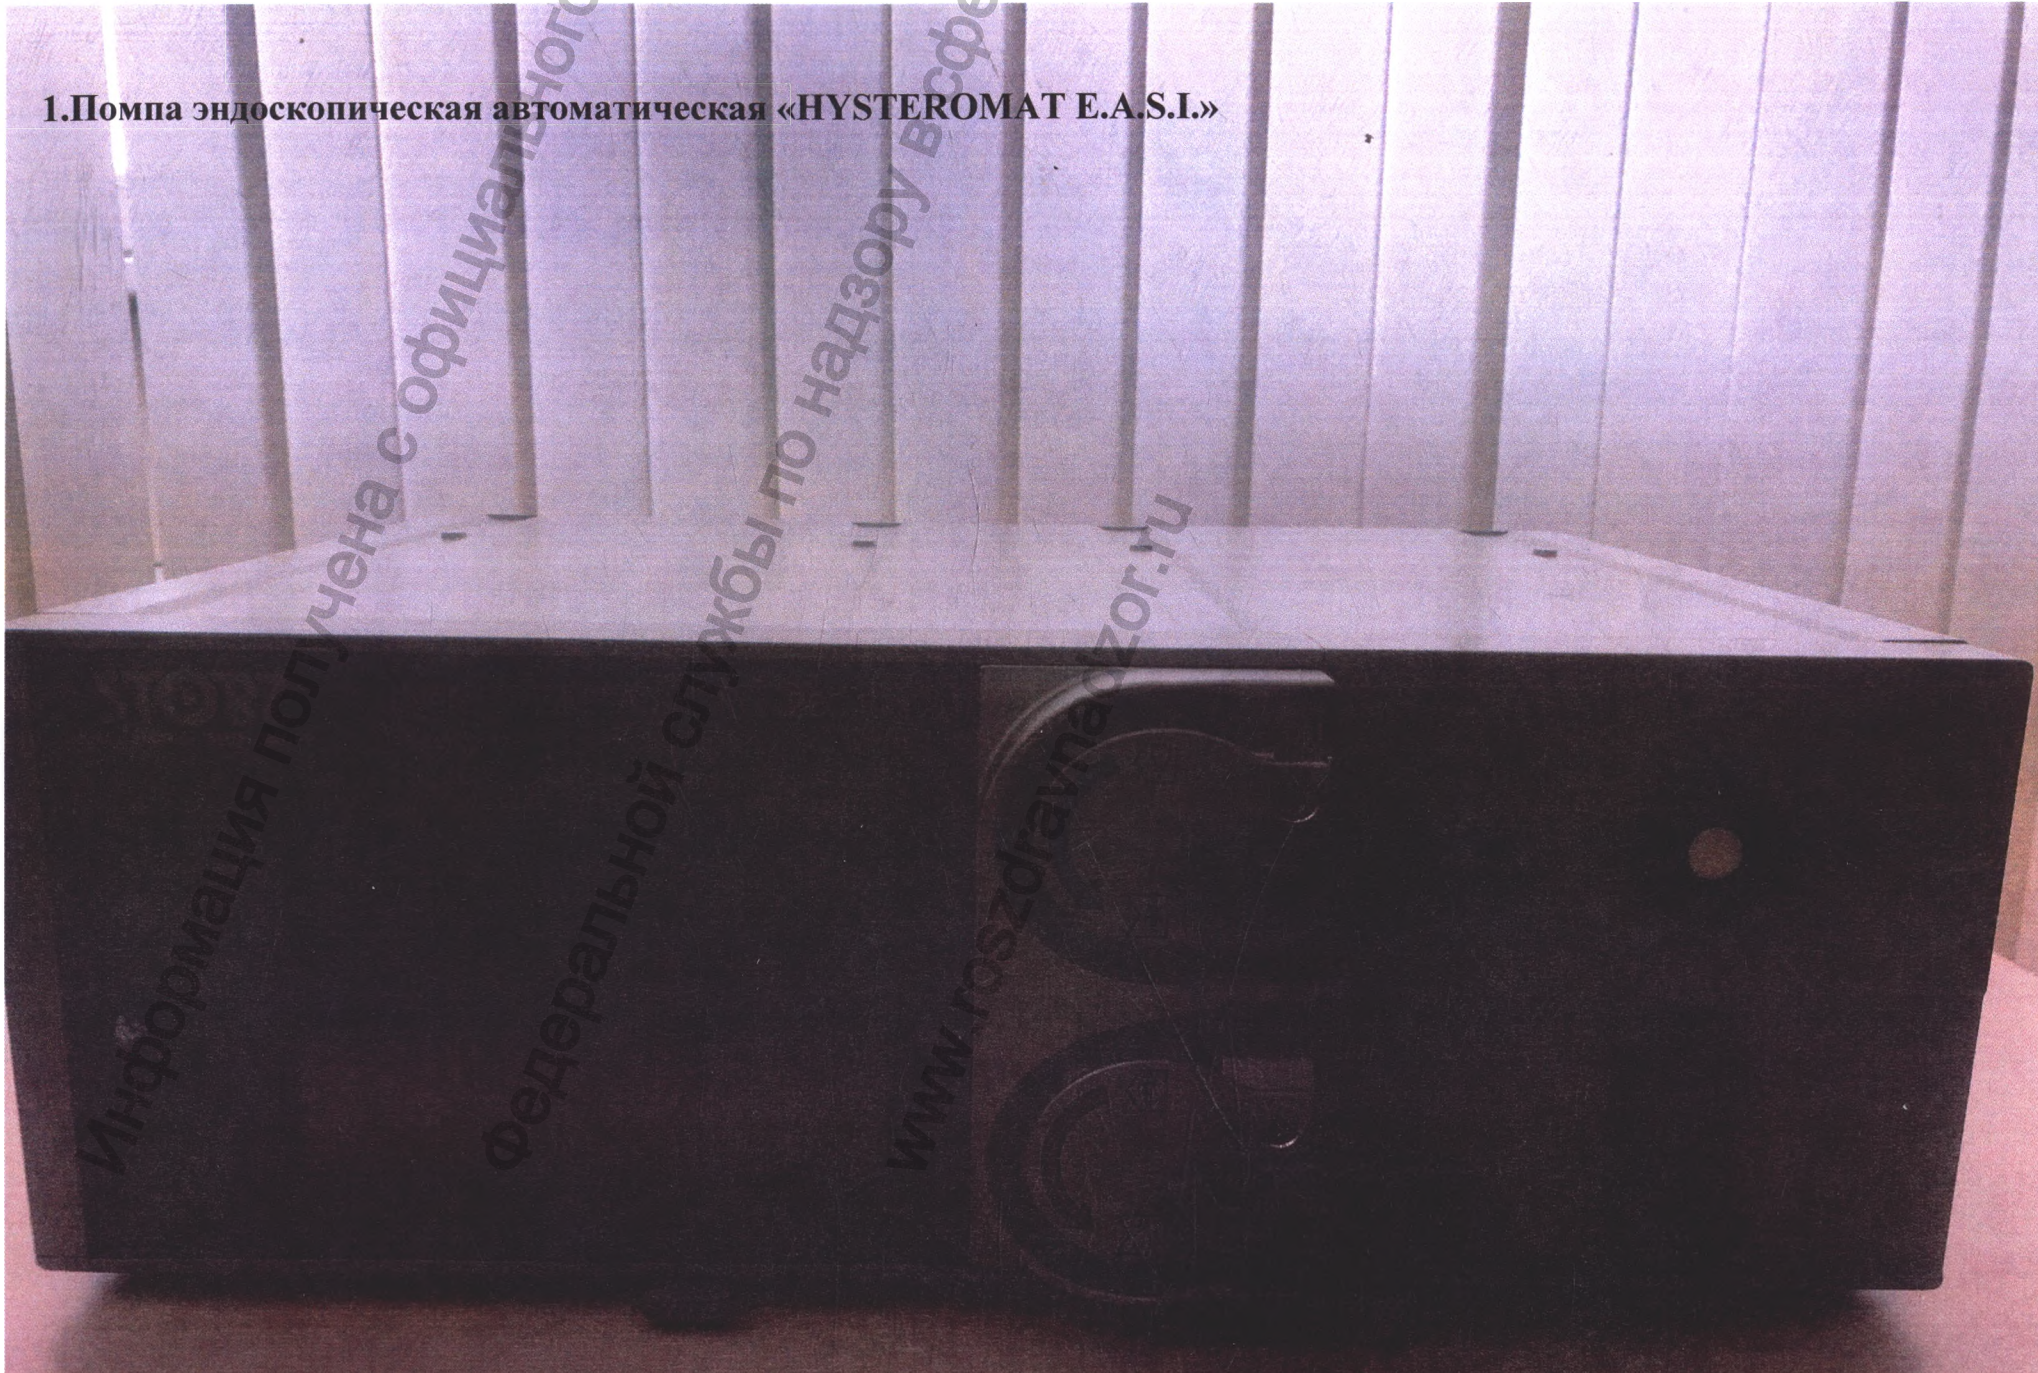


2. Кабель сетевого питания



Информация получена от официального
Федеральной службы по надзору в сфере
www.szdravnadzor.ru

3. Кабель соединительный SCB

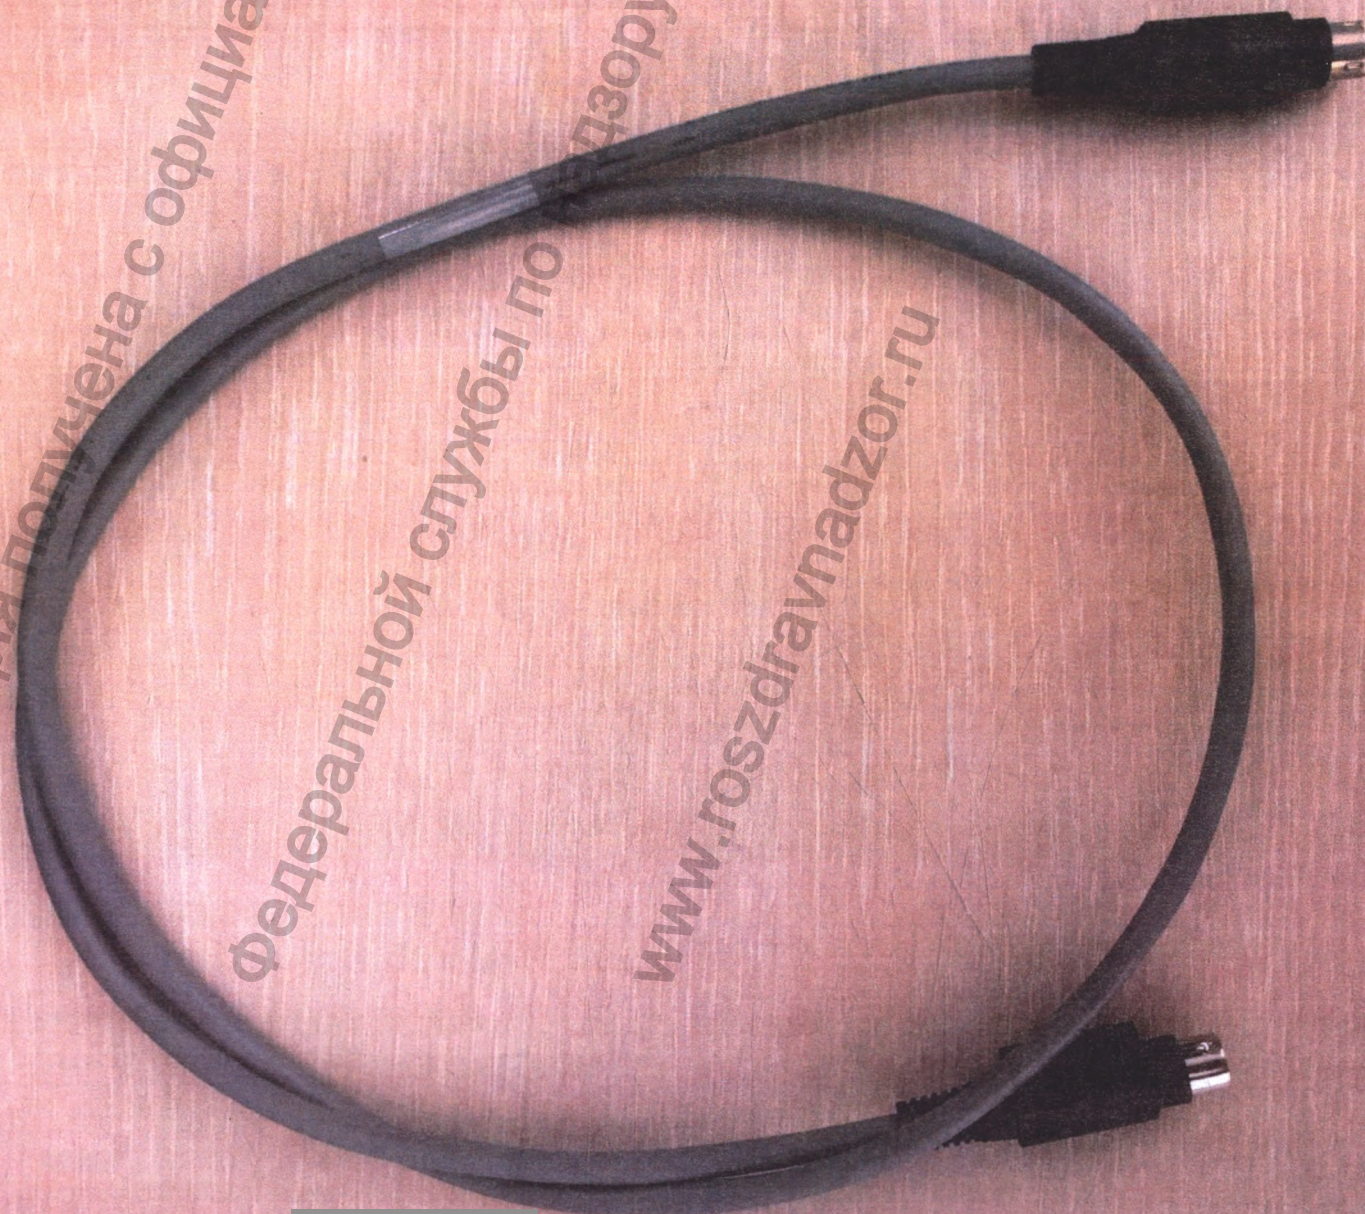

Информация получена с официального
Федеральной службы по
www.goszdravnadzor.ru

4. Инструкция по эксплуатации

STORZ

KARL STORZ — ENDOSKOPE



GEBRAUCHSANWEISUNG
26 3400 20-1 HYSTEROMAT E.A.S.I.®



INSTRUCTION MANUAL
26 3400 20-1 HYSTEROMAT E.A.S.I.®



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
26 3400 20-1 HYSTEROMAT E.A.S.I.® / Помпа эндоскопическая
автоматическая HYSTEROMAT E.A.S.I.® для применения в лапароскопии
и гинеколо

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



5. Комплект трубок основной 031917-10

HYSTEROMATEASIS
(RUCTION)

STORZ
KARL STORZ & CO. AG
D-67069 Tuttlingen
www.storz.com

REF 031717-01
REF 031717-01

STERILIZATION: 121°C / 250°F
STERILIZATION TIME: 30 MIN
STERILIZATION METHOD: SATURATED STEAM
STERILIZATION MEDIA: 3% GLYCEROL
STERILIZATION DATE: 2023-06-27

CE 0123

STERILE

2023-06-27

LOT W-022602

RxOnly

HYSTEROMATEASIS
(RUCTION)

STORZ
KARL STORZ & CO. AG
D-67069 Tuttlingen
www.storz.com

REF 031717-01
REF 031717-01

STERILIZATION: 121°C / 250°F
STERILIZATION TIME: 30 MIN
STERILIZATION METHOD: SATURATED STEAM
STERILIZATION MEDIA: 3% GLYCEROL
STERILIZATION DATE: 2023-06-27

CE 0123

STERILE

2023-06-27

LOT W-022602

RxOnly

6. Педальный переключатель



7. Кабель дистанционного управления



Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере з

www.gosdraznadzor.ru

ПРОШТО И СКРЕПЛЕНО
ЛИСТА (ОВ)

Д. Воево

