

Комплекс суточного мониторинга ЭКГ и АД "МедиКом-комби" с регистратором ИН-33М


Электроды ЭКГ
"FIAB"



Аккумулятор
"VARTA" AA



Кардиорегистратор
ИН-33М

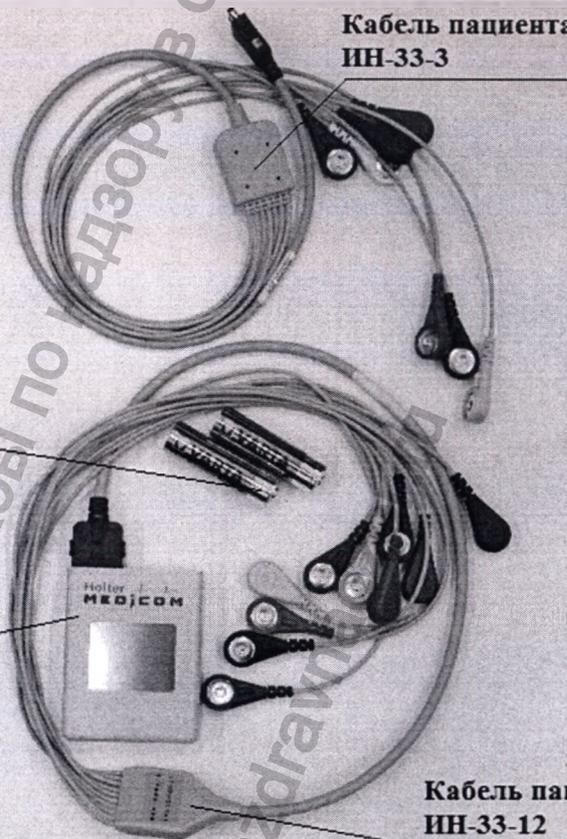

Кабель пациента
ИН-33-3

Кабель пациента
ИН-33-12


Программное
обеспечение
"WinIcar"




Программное
обеспечение
"DiaCard"



Карта памяти
Transcend micro CD



Кабель
интерфейсный
ИН-33

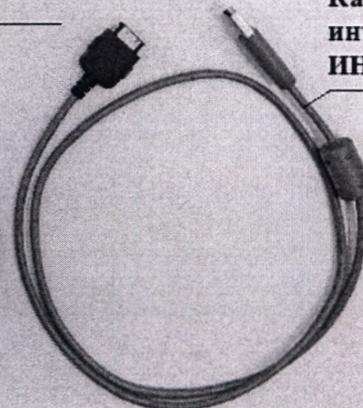

Чехол с
поясным и
плечевым
ремнями



Зарядное устройство "X-1800"



Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД "Медиком-комби" с регистратором ИИ-33Т

Аккумуляторы Li-Ion
типоразмера 14500

Регистратор
ИИ-33Т с

картой MicroSim

Электроды ЭКГ
"ФИАБ"

Программное
обеспечение
"WinCar"

Программное
обеспечение
"DiaCard"

Кабель пациента ИИ-33-3

Карта памяти
Transcend
micro CD

Чехол с поясным и плечевым ремнями

Зарядное устройство для Li-Ion аккумуляторов

Комплекс суточного мониторинга ЭКГ и АД "МедиКом-комби" с регистратором КР-03

Чехол с поясным и плечевым ремнями

Программное обеспечение "DiaCard"

Аккумулятор "VARTA" AA

Кабель КР-03-3

Карта памяти Transcend micro SD

Регистратор КР-03

Шланг воздушный




Кабель КР-03-12

Кабель интерфейсный КР-03

Электроды ЭКГ "FIAВ"

Зарядное устройство "X-1800"

Манжеты:
16-24 см
24-32 см
28-40 см
32-42 см

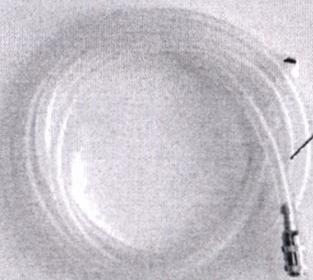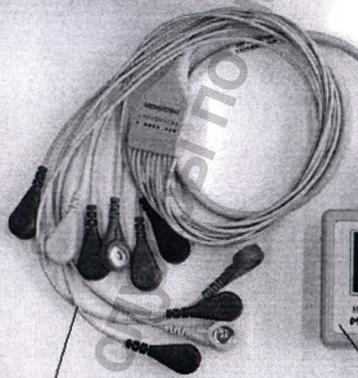

Информация

Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД "МедиКом-комби" с регистратором КР-04

Манжеты:
16-24 см
24-32 см
28-40 см
32-42 см




Электроды ЭКГ "FIAB"




Чехол с поясным и плечевым ремнями

Аккумулятор "VARTA" AA



Карта памяти Transcend micro SD





Программное обеспечение "DiaCard"

Кабель КР-03-3



Шланг воздушный

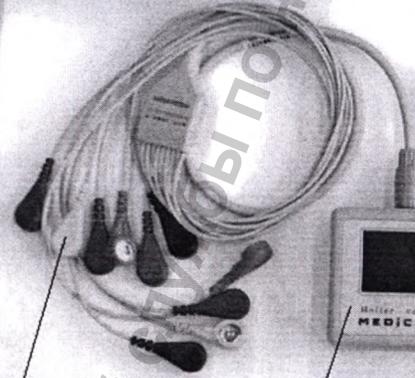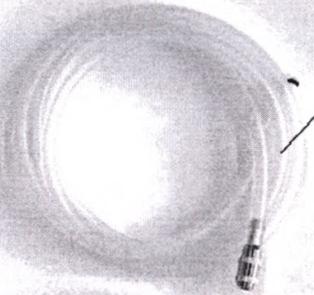


Кабель КР-03-12




Регистратор КР-04

Датчик тонов Короткова со шлангом воздушным

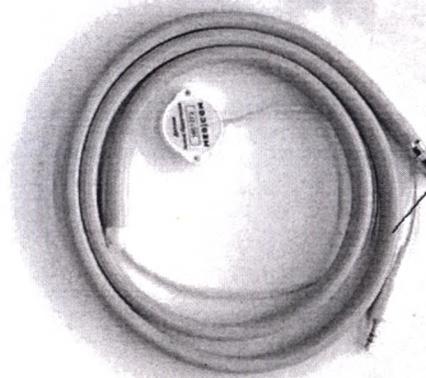

Кабель интерфейсный КР-03

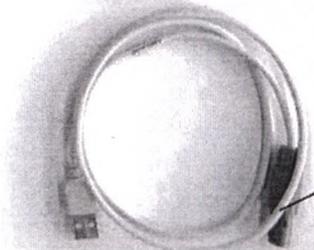

Зарядное устройство "X-1800"

Комплекс суточного мониторинга ЭКГ и АД "МедиКом-комби" с регистратором КР-05

Чехол с поясным и плечевым ремнем

Аккумулятор "VARTA" AA

Карта памяти Transcend micro SD

Программное обеспечение "DiaCard"

Кабель КР-03-3

Шланг воздушный

Датчик тонов Короткова со шлангом воздушным

Регистратор КР-05

Кабель КР-03-12

Датчик SpO₂

Кабель интерфейсный КР-03

Зарядное устройство "X-1800"

Манжеты:
16-24 см
24-32 см
28-40 см
32-42 см


Электроды ЭКГ "FLAV"

Комплекс суточного мониторинга ЭКГ и АД "МедиКом-комби" с регистратором МД-01

Манжеты:
16-24 см
24-32 см
28-40 см
32-42 см



Чехол с
поясным и
плечевым
ремнями




Аккумулятор
"VARTA" AA




Карта памяти
Transcend micro SD



Программное
обеспечение
"ORMAD"



Регистратор МД-01

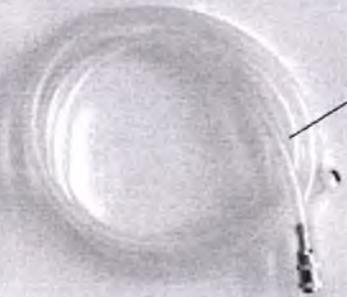

Шланг
воздушный



Зарядное устройство "X-1800"



Кабель
интерфейсный КР-03

Комплекс суточного мониторинга ЭКГ и АД "МедиКом-комби" с регистратором МД-01М

Манжеты:
16-24 см
24-32 см
28-40 см
32-42 см



Чехол с
поясным и
плечевым
ремнями



Аккумулятор
"VARTA" AA



Карта памяти
Transcend micro SD



Регистратор МД-01М




Зарядное устройство "X-1800"




Программное
обеспечение
"ORMAD"



Шланг
воздушный

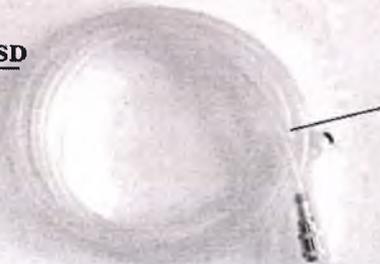

Датчик тонов
Короткова со
шлангом
воздушным

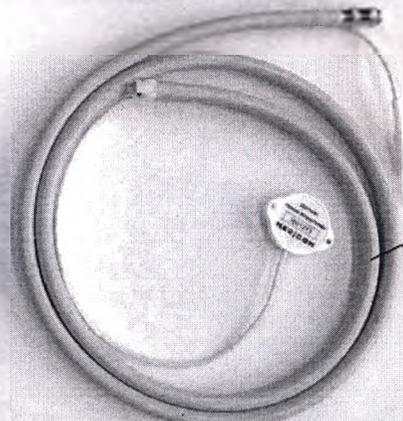


Кабель
интерфейсный
КР-03



Аккумулятор "VARTA" AA



Датчик SpO₂

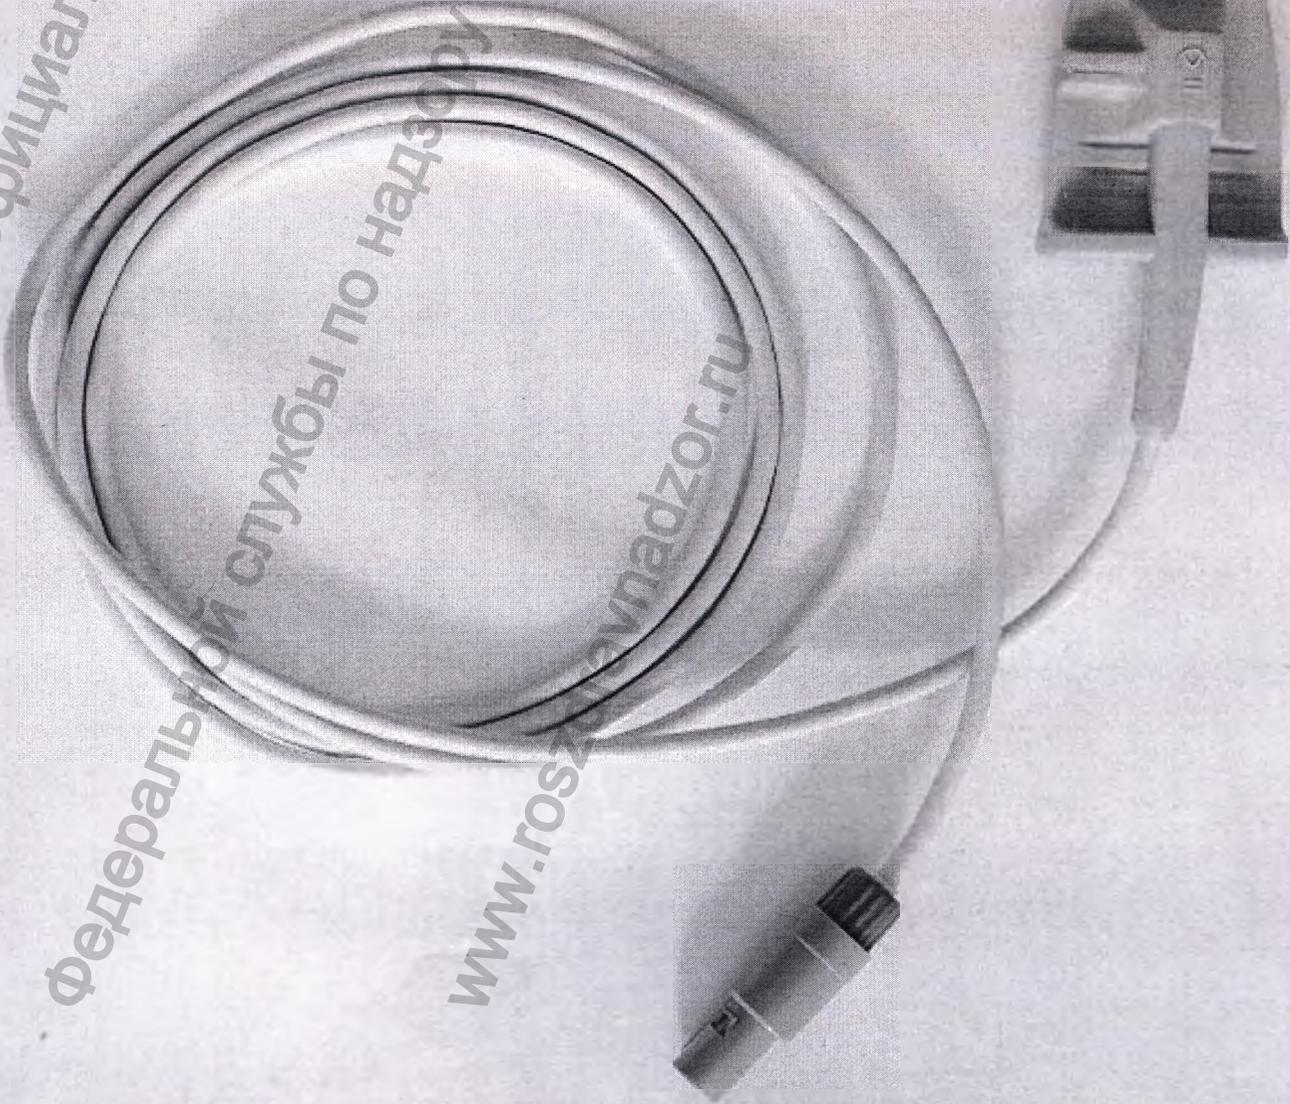


Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

www.gosknaznadzor.ru

Датчик тонов Короткова со шлангом воздушным

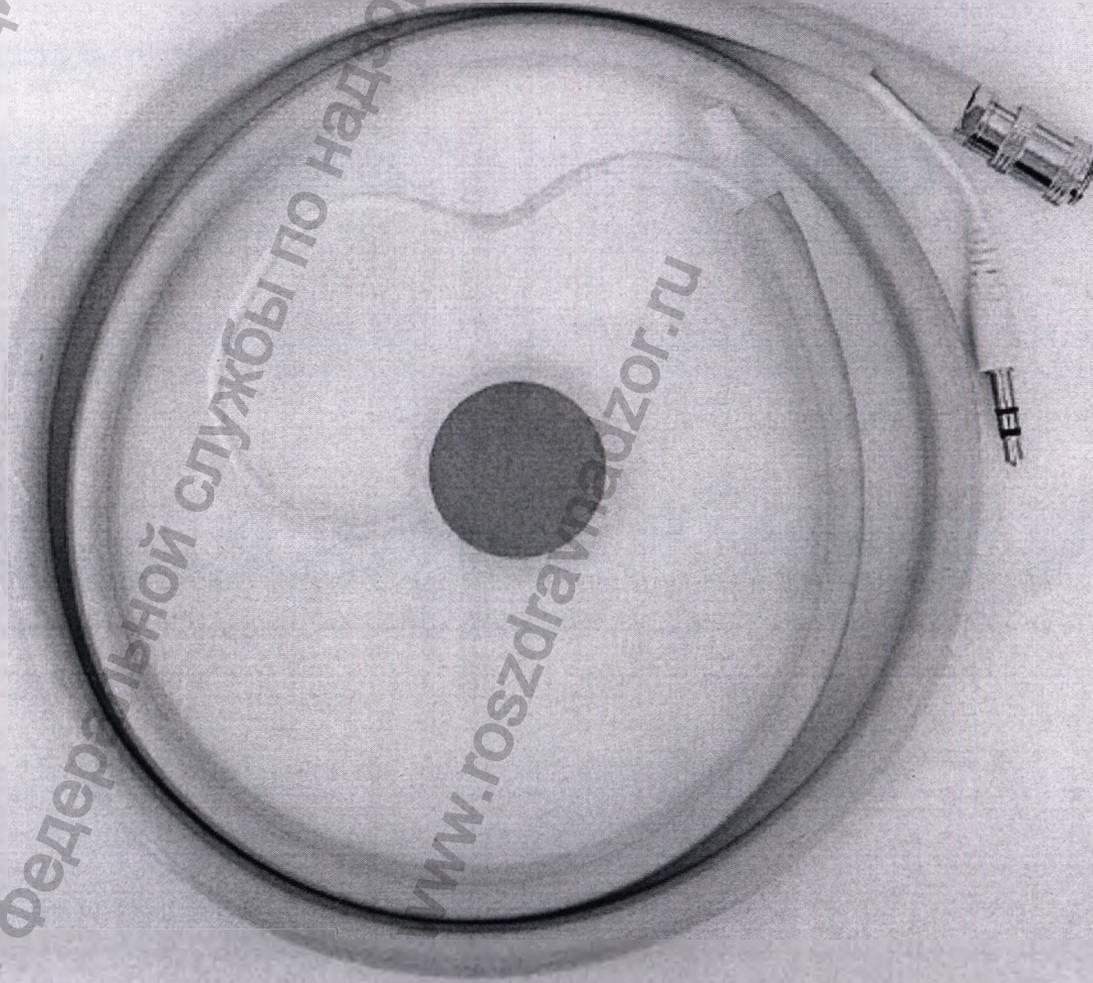




Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.goszdravnadzor.ru

Зарядное устройство "X-1800"



Информация получена
Федерального
Центра
www.fedcenter.ru

Зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов

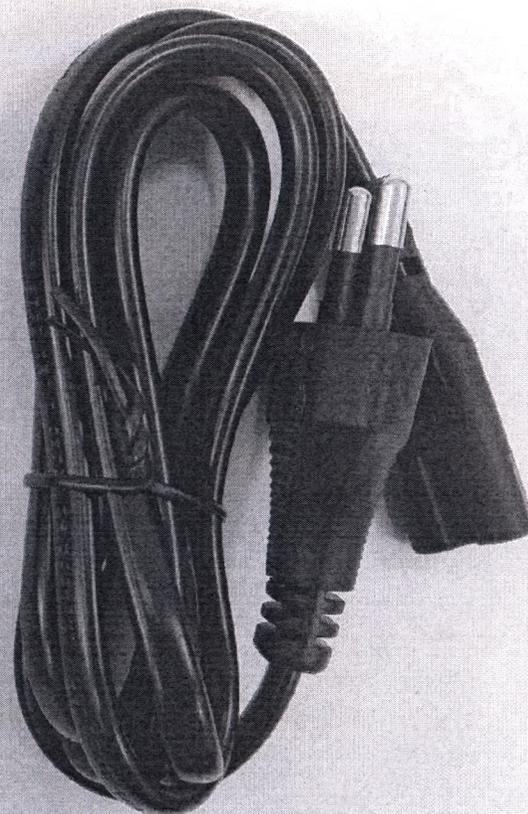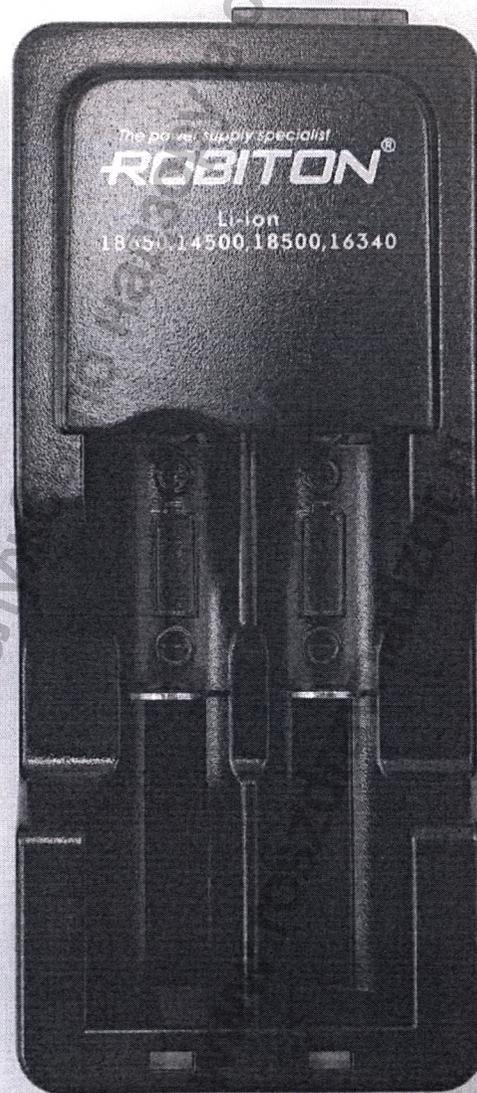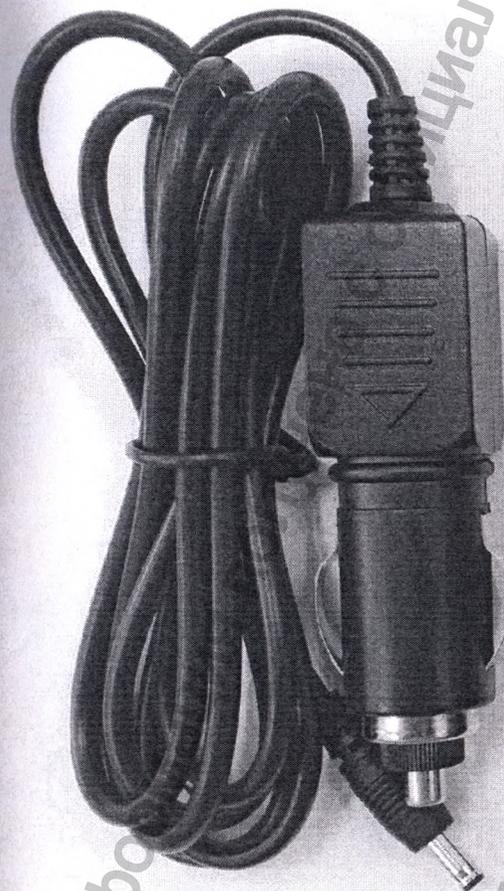

Регистратор ИИ-33М "Комплекса суточного мониторирования ЭКГ и АД "Медиком-комби"

Holter
MEDICOM



Комплекс суточного
мониторирования ЭКГ и АД
"Медиком-Комби"


ТУ 9442-001-86580521-2014

Регистратор ИИ-33М

Заводской № **1707047**




ООО "МЕДИКОМ"
Изготовлено в РОССИИ



Регистратор ИН-33Т "Комплекса суточного мониторирования ЭКГ и АД "Медиком-комби"



Кабель интерфейсный КР-03

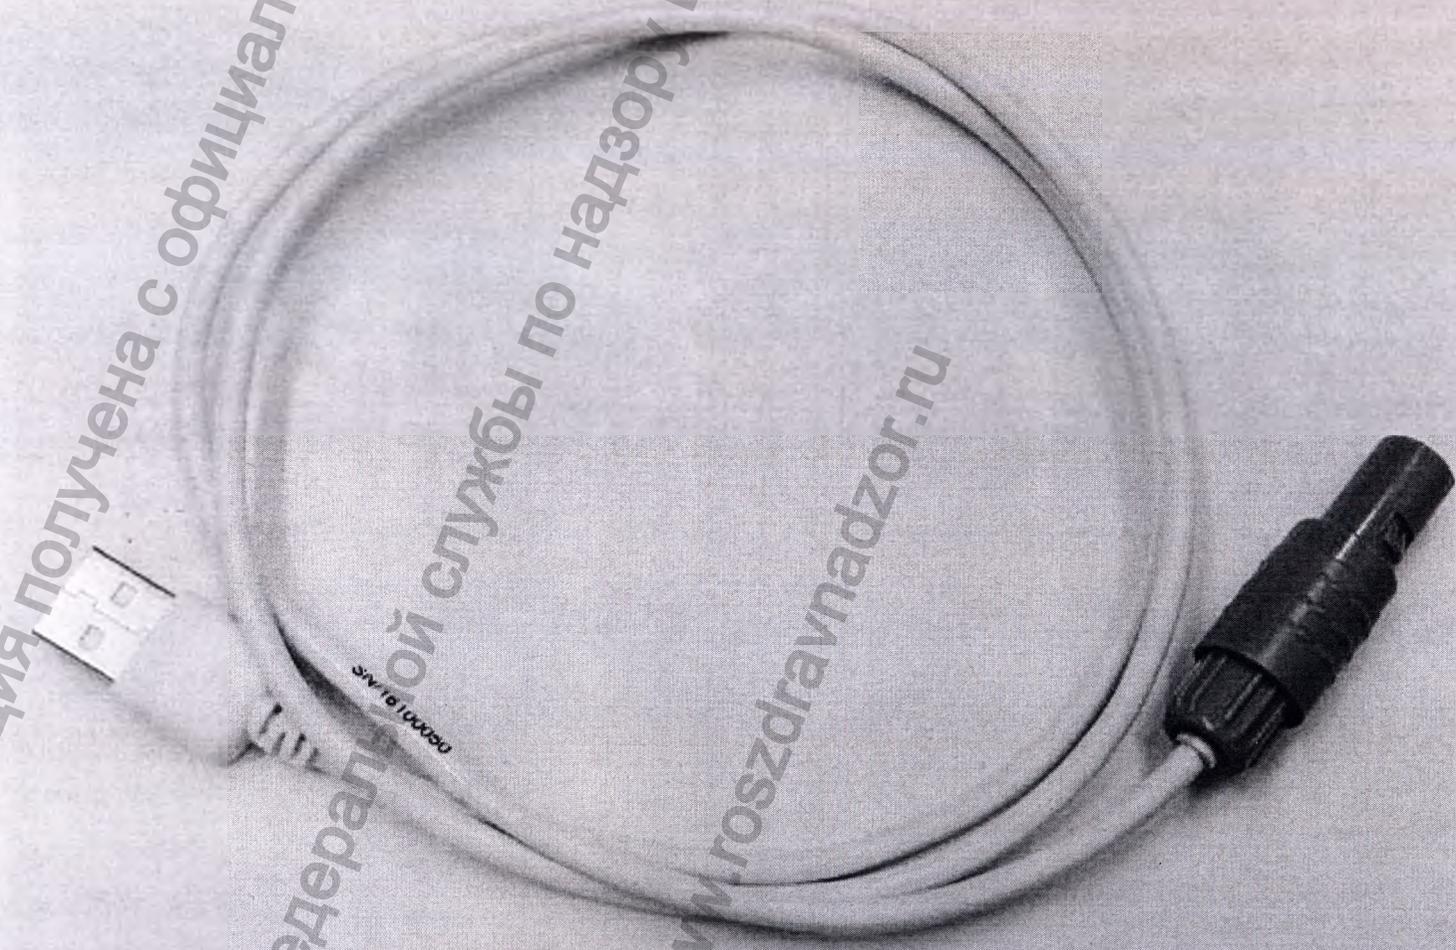


Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

www.goszdravnadzor.ru


Кабель USB2,0A-mini B

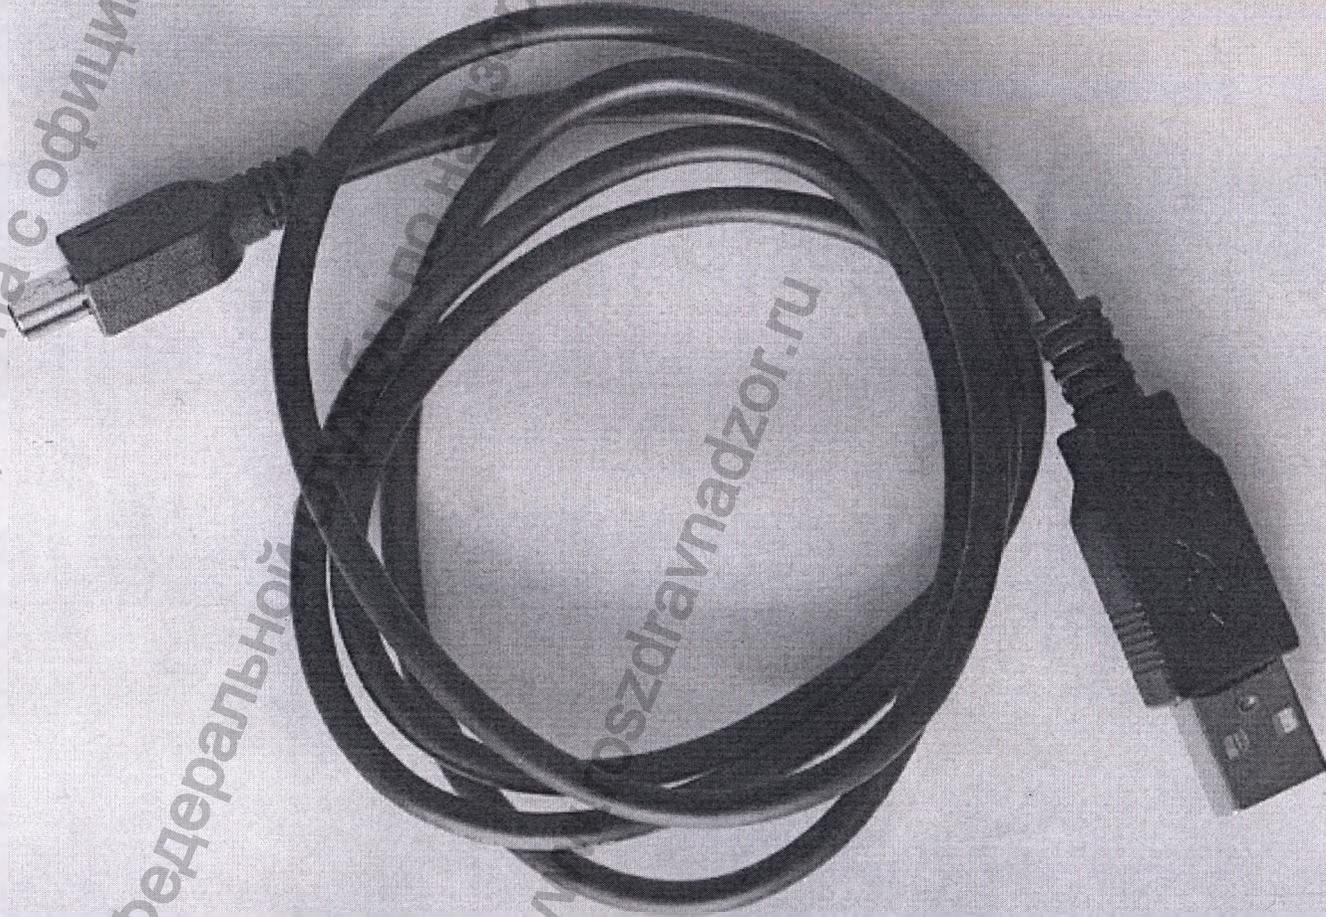

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере

www.roszdravnadzor.ru

Кабель пациента ИН-33-3

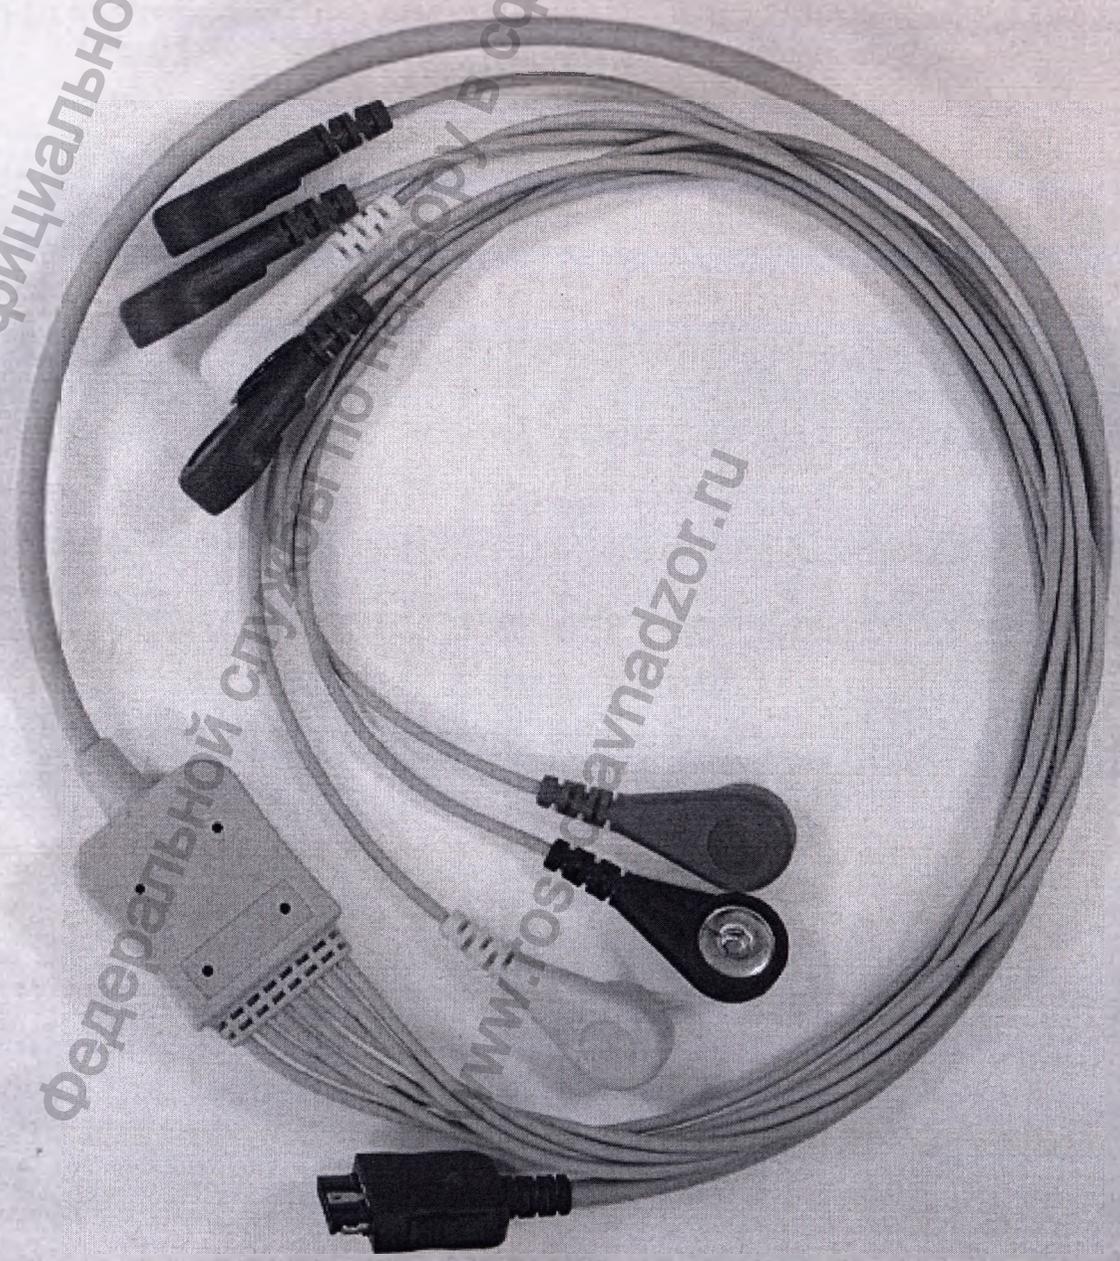


Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии


www.rosstandart.ru

Кабель пациента ИН-33-12

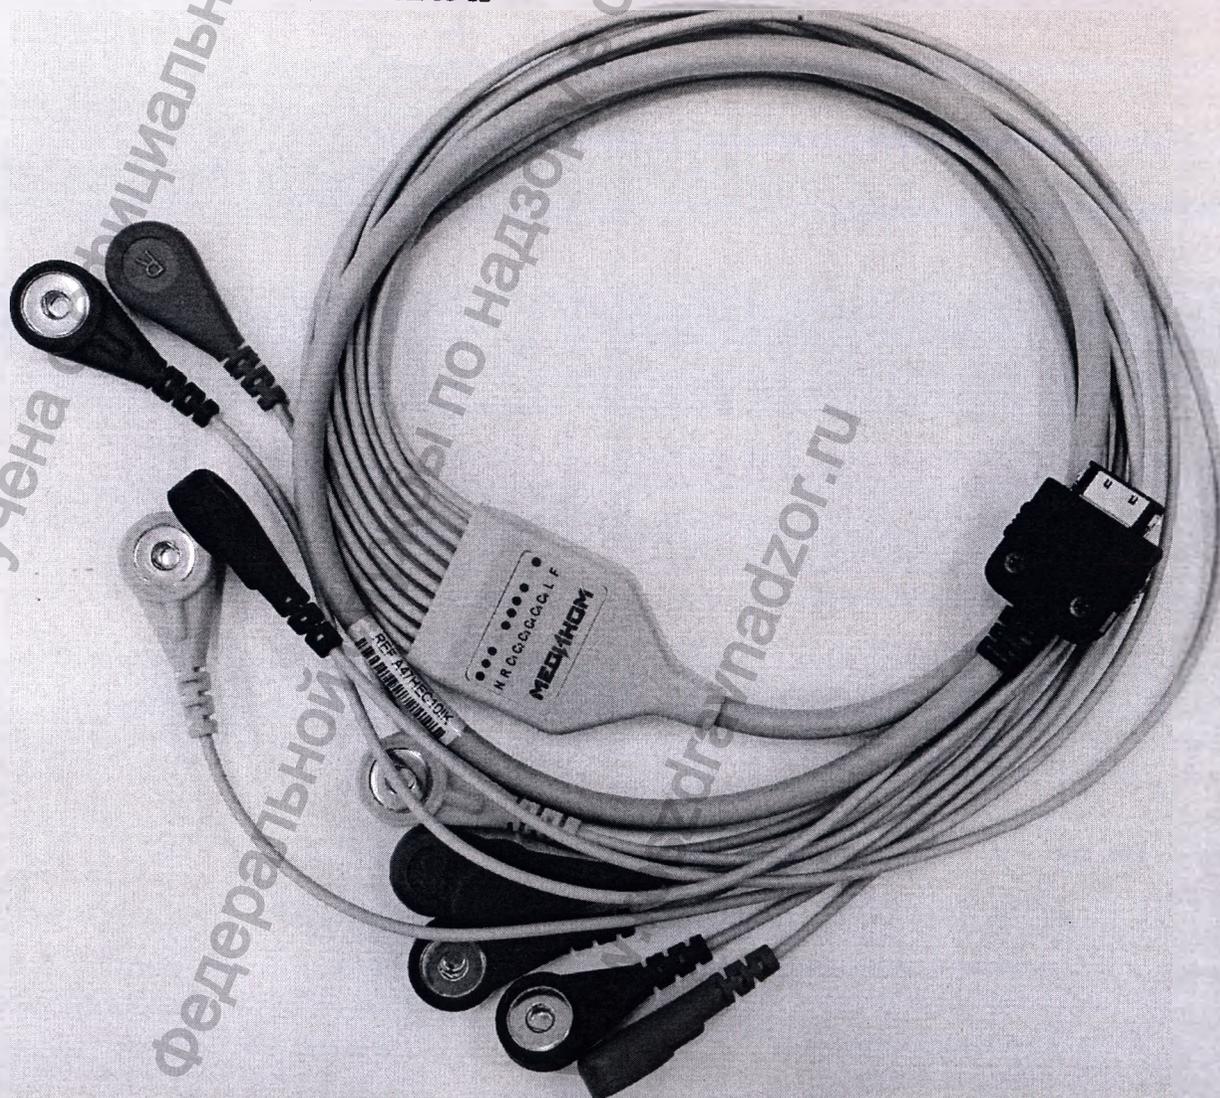

Информация получена
Федеральной
по надзор
сфер

Кабель интерфейсный ИН-33


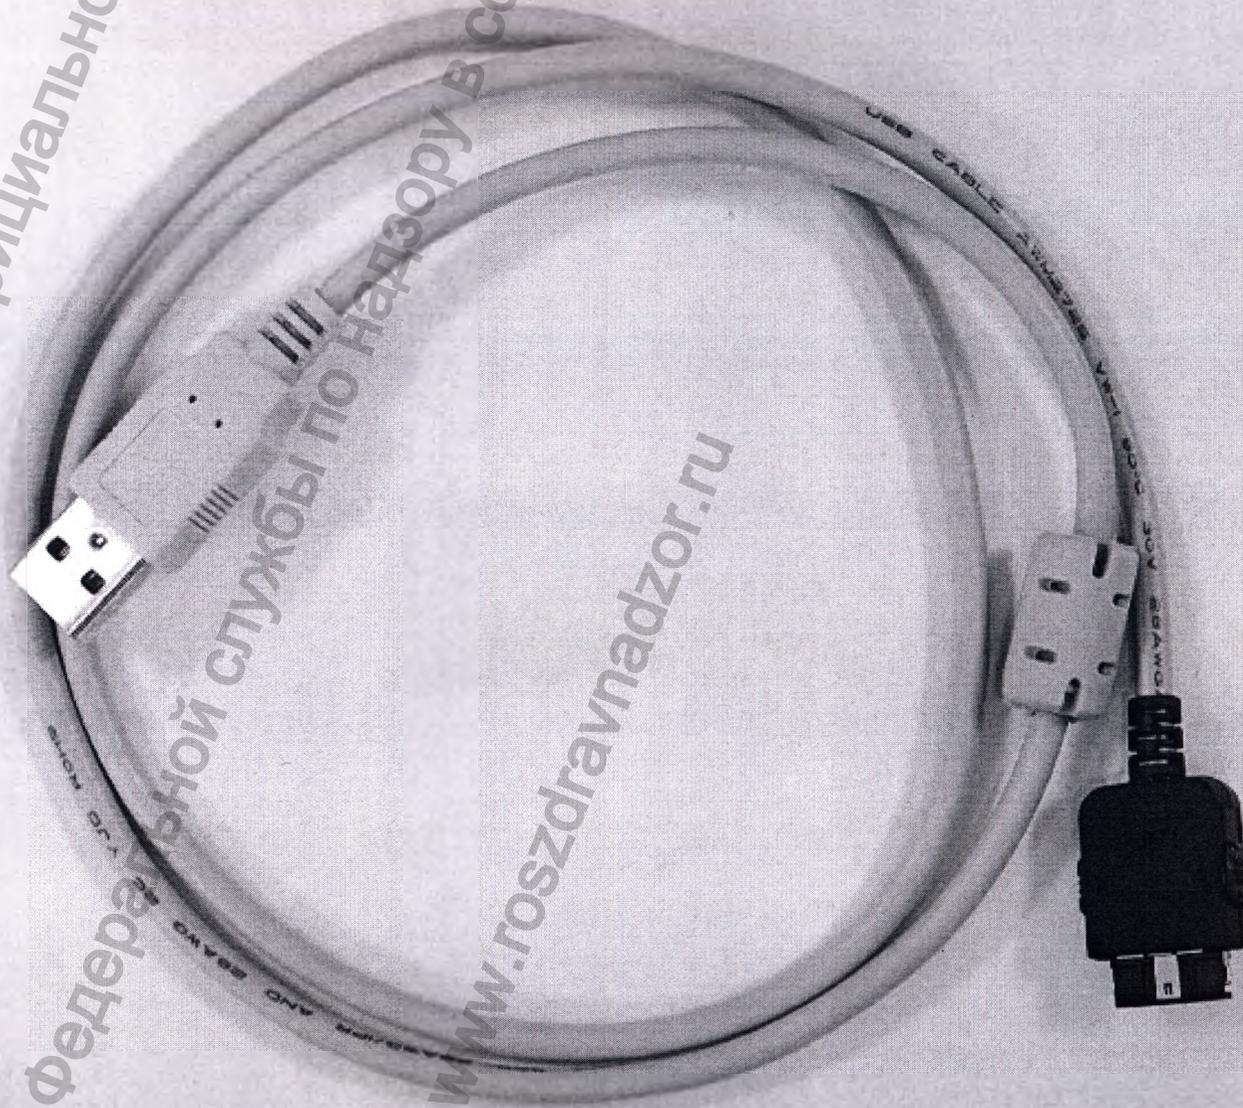


Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения





www.goszdramadzor.ru


Регистратор КР-02 "Комплекса суточного мониторинга ЭКГ и АД "Медиком-комби"

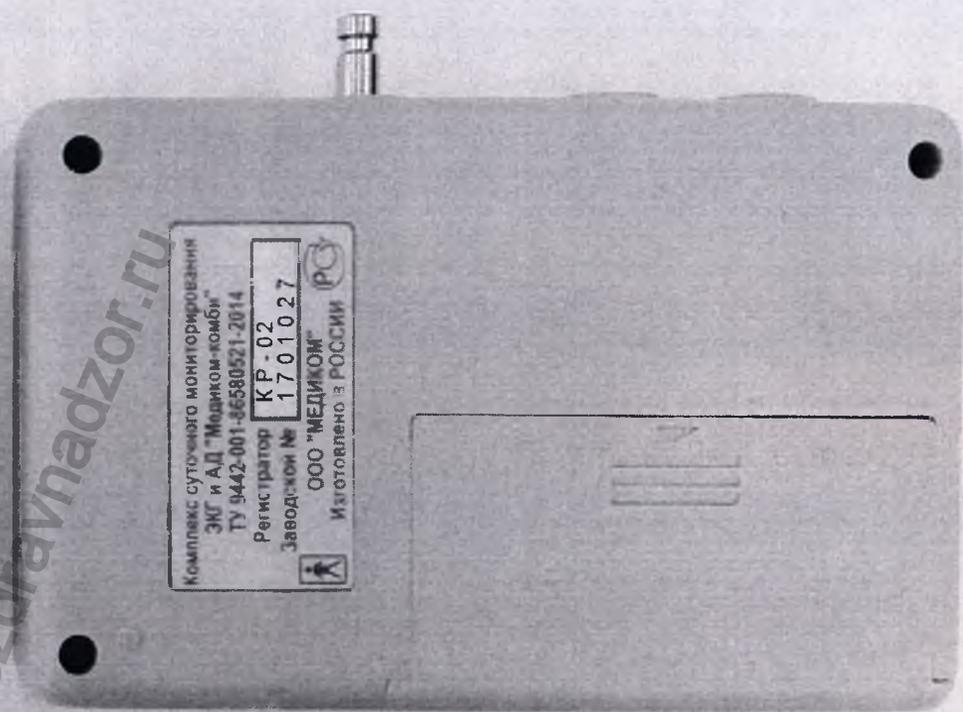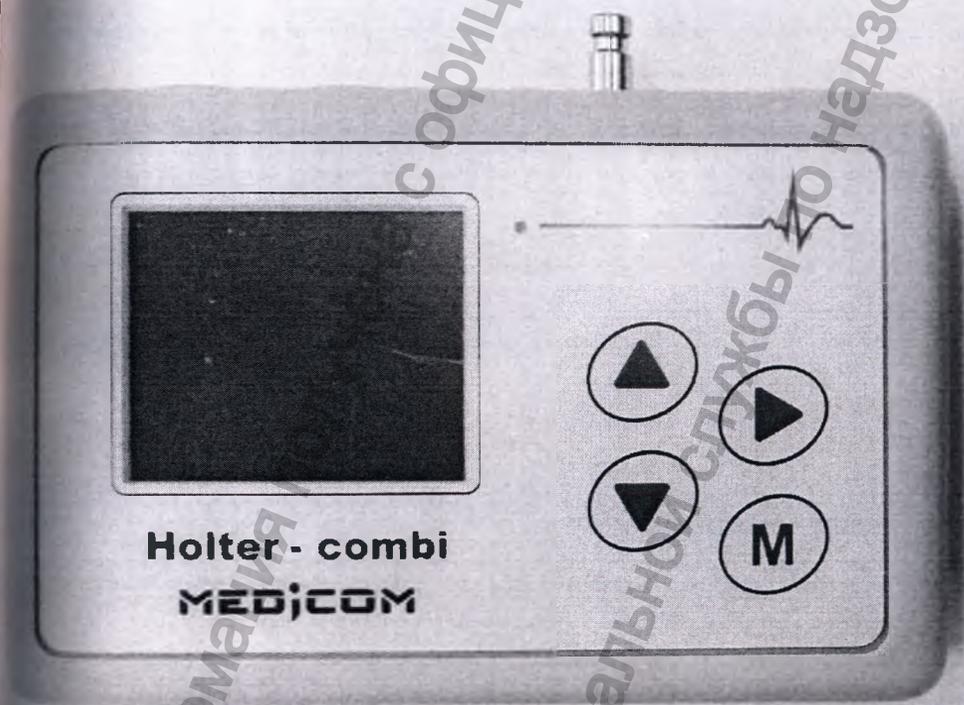

Регистратор КР-03 "Комплекса суточного мониторирования ЭКГ и АД "Медиком-комби"

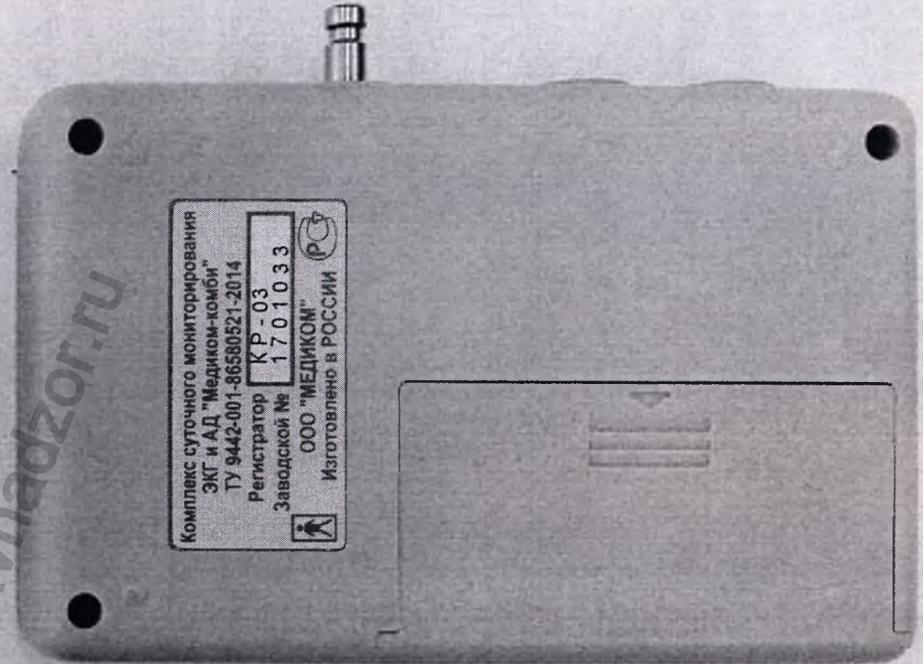
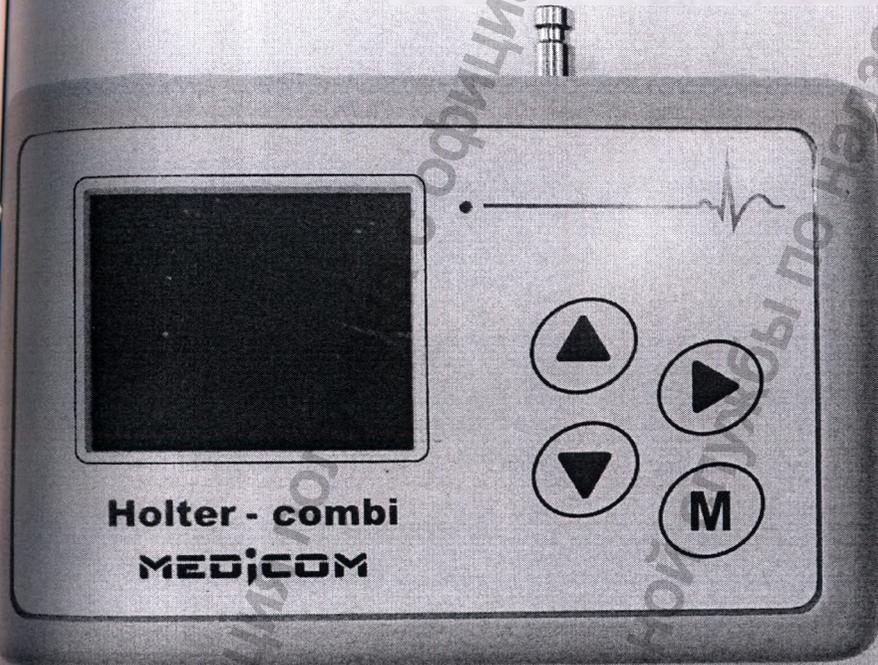


Регистратор КР-04 "Комплекса суточного мониторингования ЭКГ и АД "Медиком-комби"

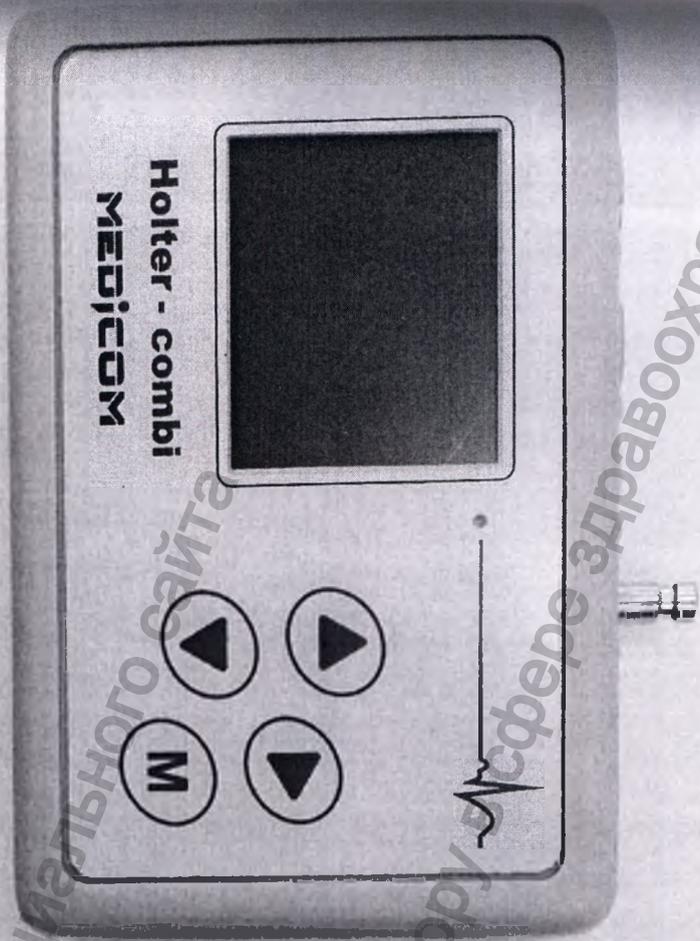

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramnadzor.ru

Регистратор КР-05 "Комплекса суточного мониторинга ЭКГ и АД "Медиком-комби"

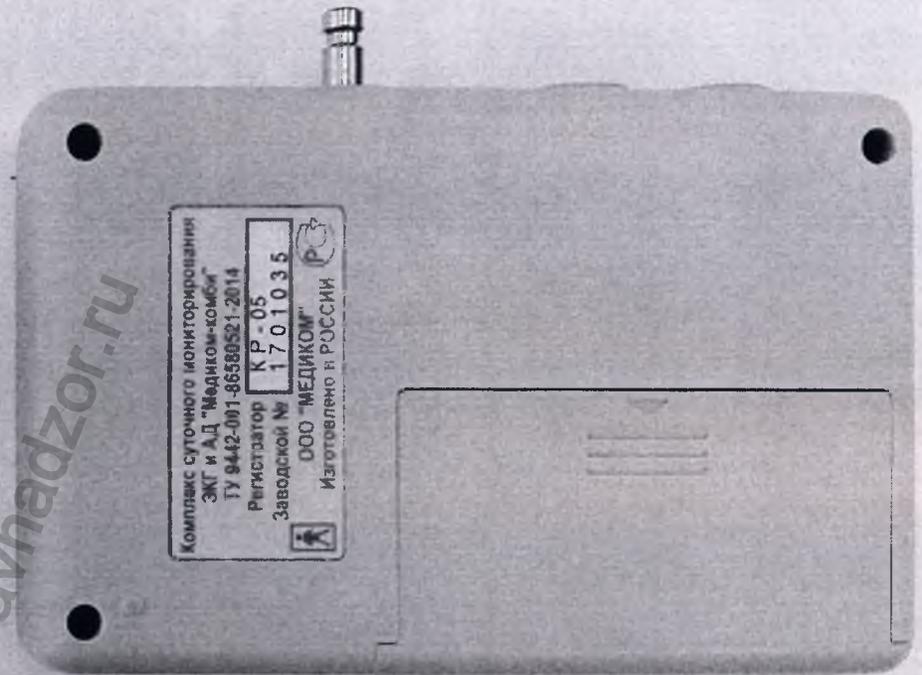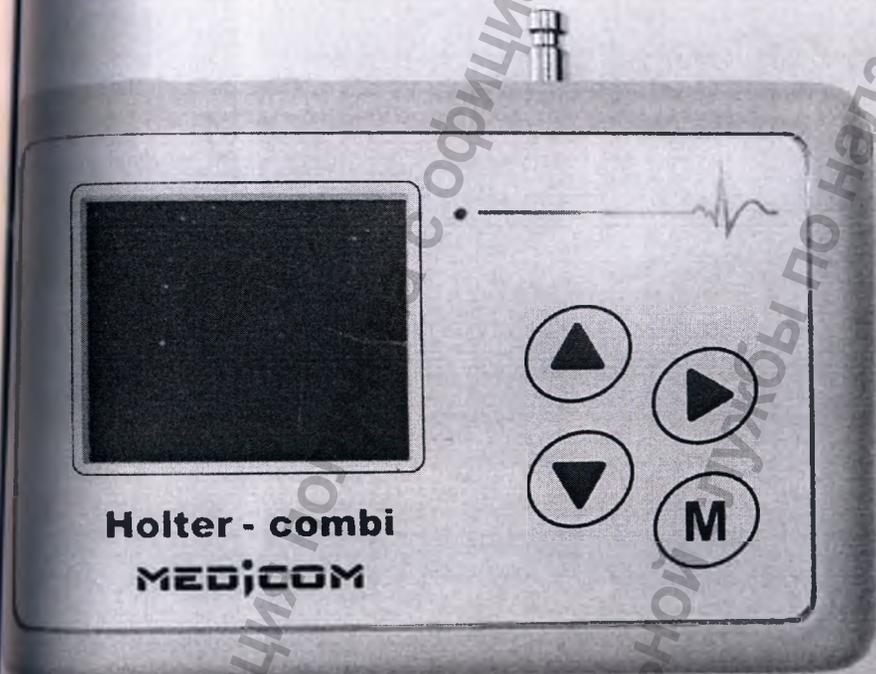

Информация получена с

тору в сфере здравоохранения

МЕДИНОМ

www.mediom77.ru


16-24 см

Latex free




www.goszdravnadzor.ru

Манжета 24-32 см

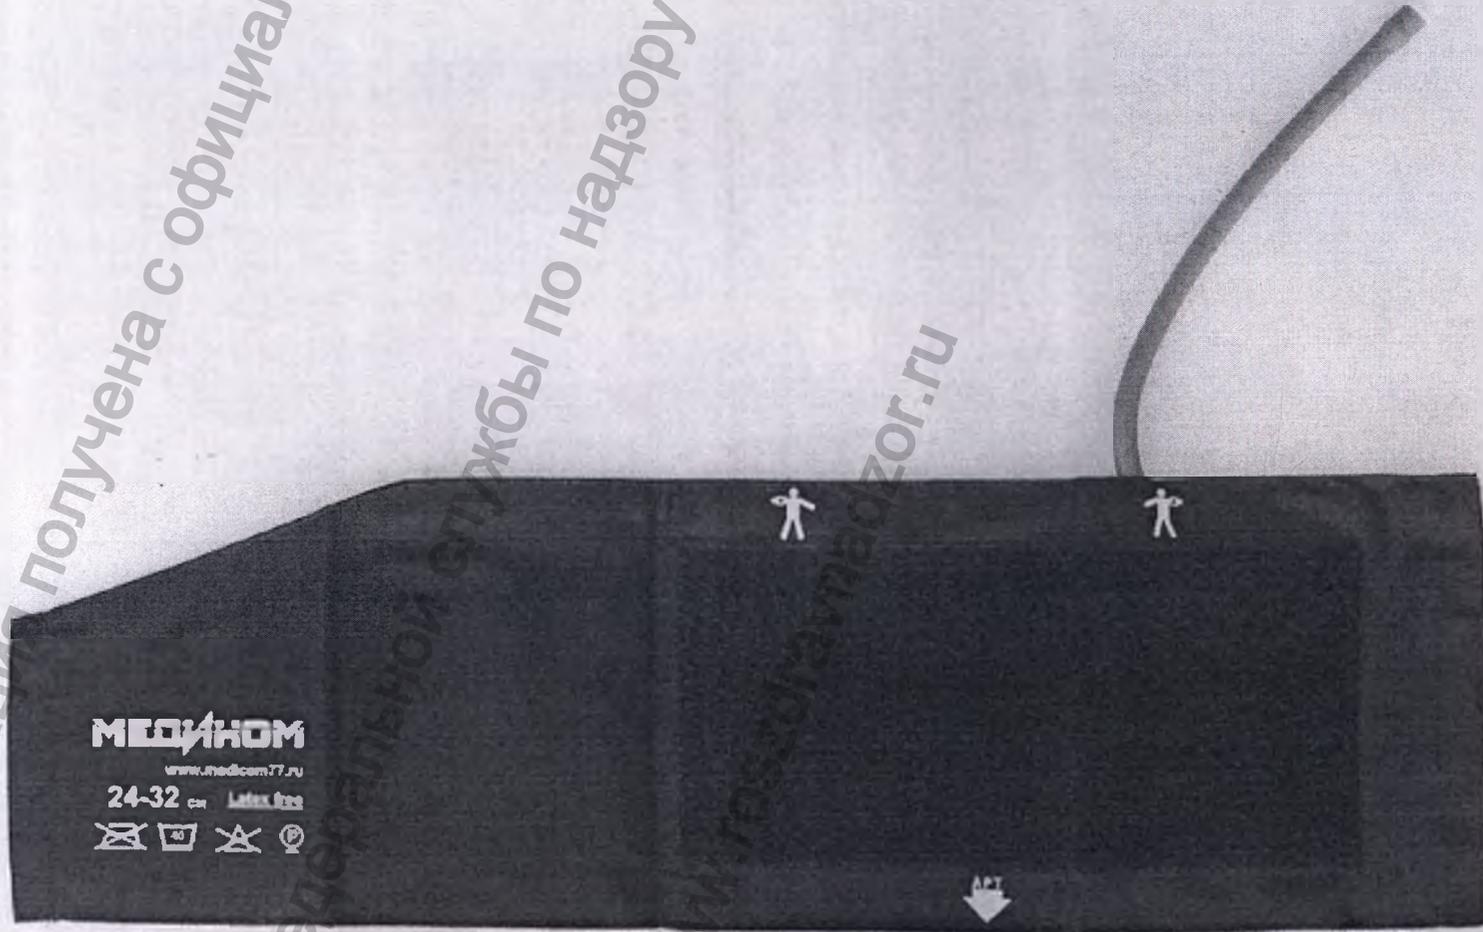

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.fednadzor.ru

Манжета 28-40 см

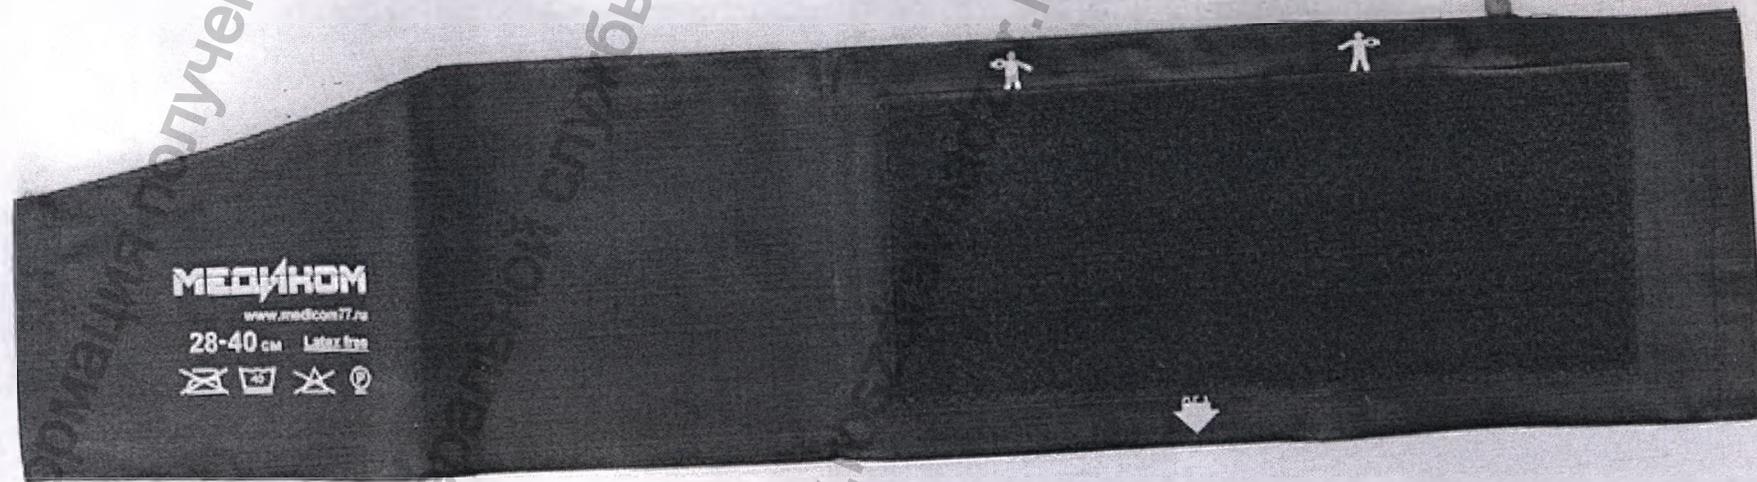


Информация получена с официального сайта
Федерального агентства по надзору в сфере здо
www.medcom77.ru



МЕДИКОМ

www.medicom77.ru

32-42 см Latex free



Информ

Федерал

www.gosz

МЕДИКОМ

Программное обеспечение "DiaCard"



Комплекс суточного
мониторирования
ЭКГ и АД
"Медиком - комби"

ООО "МЕДИКОМ"

Тел.: (495) 724 60 30 (495) 961 09 69

факс: (495) 984 85 21

e-mail: medicom@medicom77.ru

<http://medicom77.ru>

2014 г.

МЕДИКОМ

Программное обеспечение "ORMAD"



Комплекс суточного
мониторирования
ЭКГ и АД
"Медиком - комби"

ООО "МЕДИКОМ"

Тел.: (495) 724 60 30 (495) 961 09 69

факс: (495) 984 85 21


e-mail: medicom@medicom77.ru

<http://medicom77.ru>

2014 г.

МЕДИКОМ

Программное обеспечение "WinIcar"

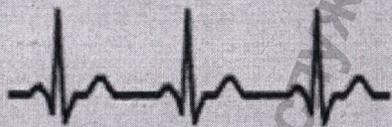

Комплекс суточного
мониторирования
ЭКГ и АД
"Медиком - комби"

ООО "МЕДИКОМ"



Тел.: (495) 724 60 30 (495) 961 09 69



факс: (495) 984 85 21

e-mail: medicom@medicom77.ru

<http://medicom77.ru>

2014 г.

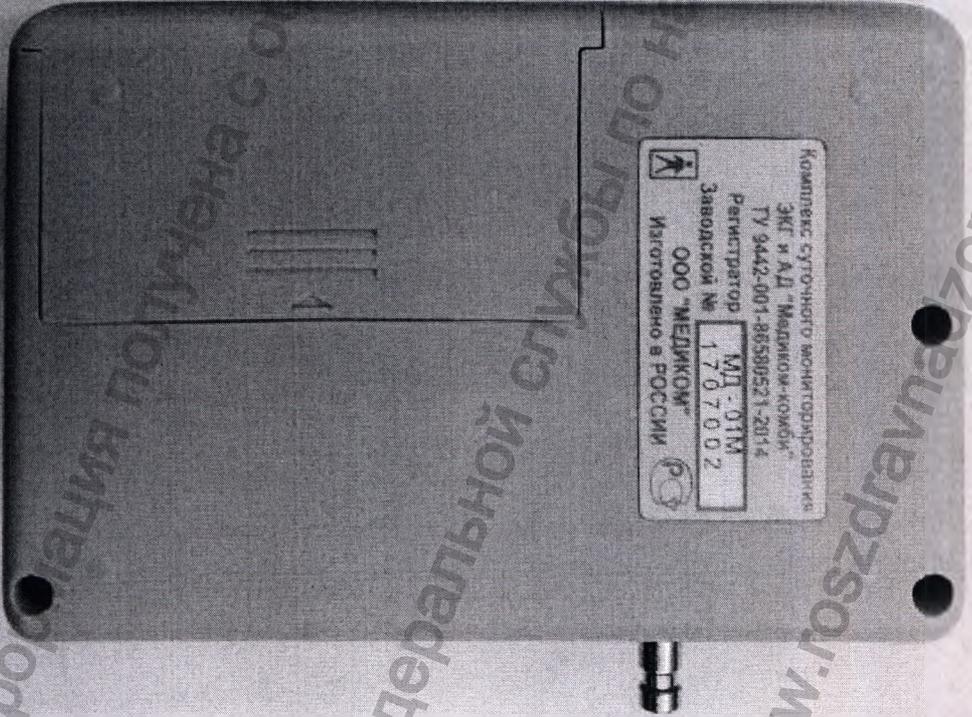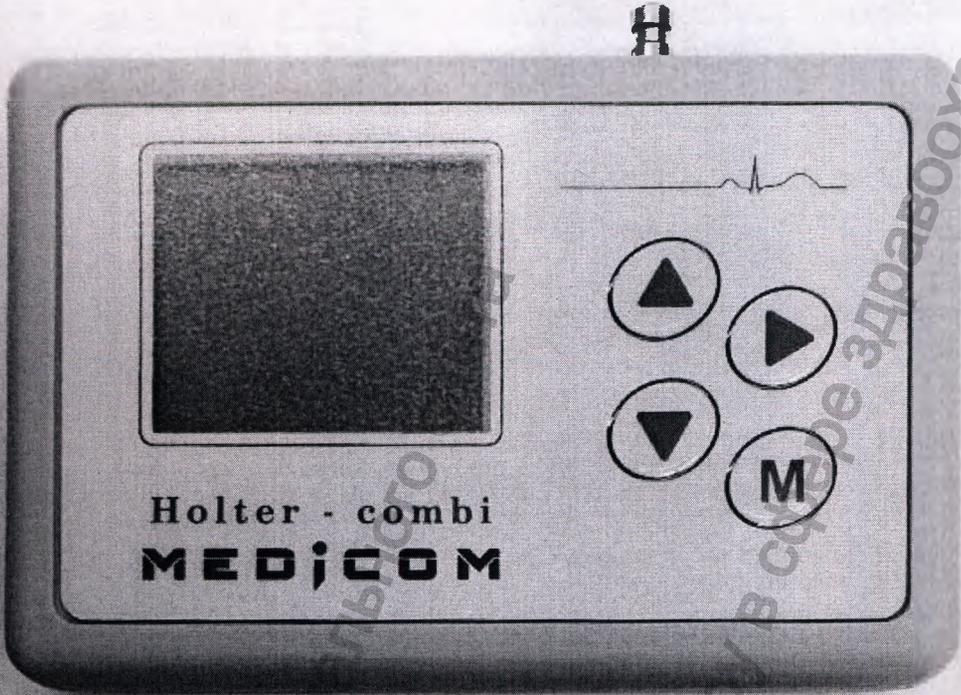

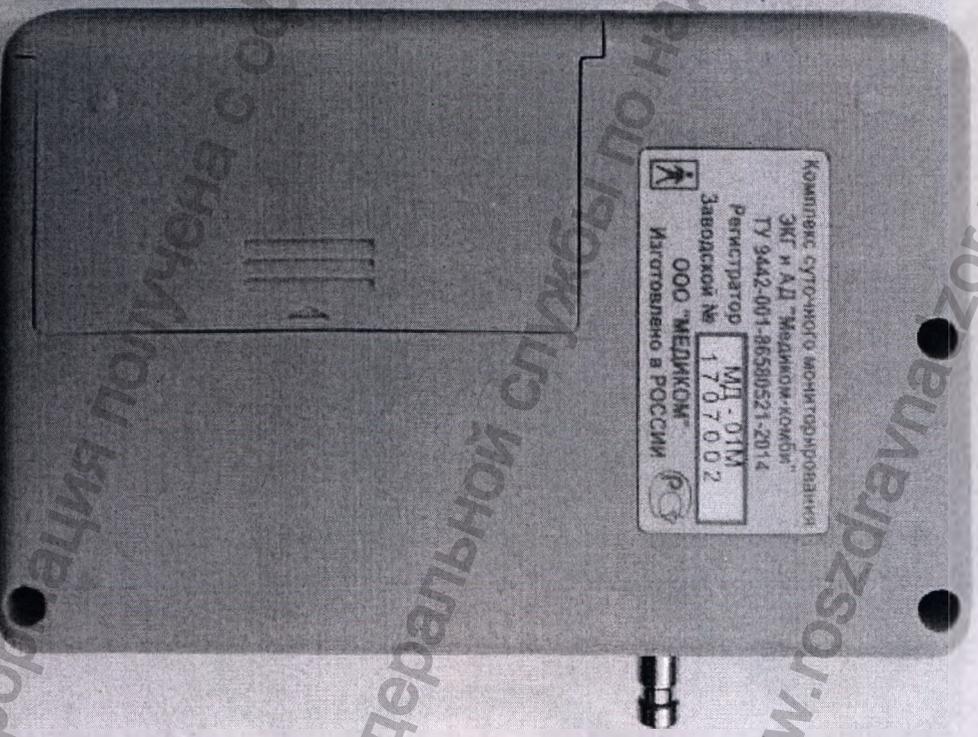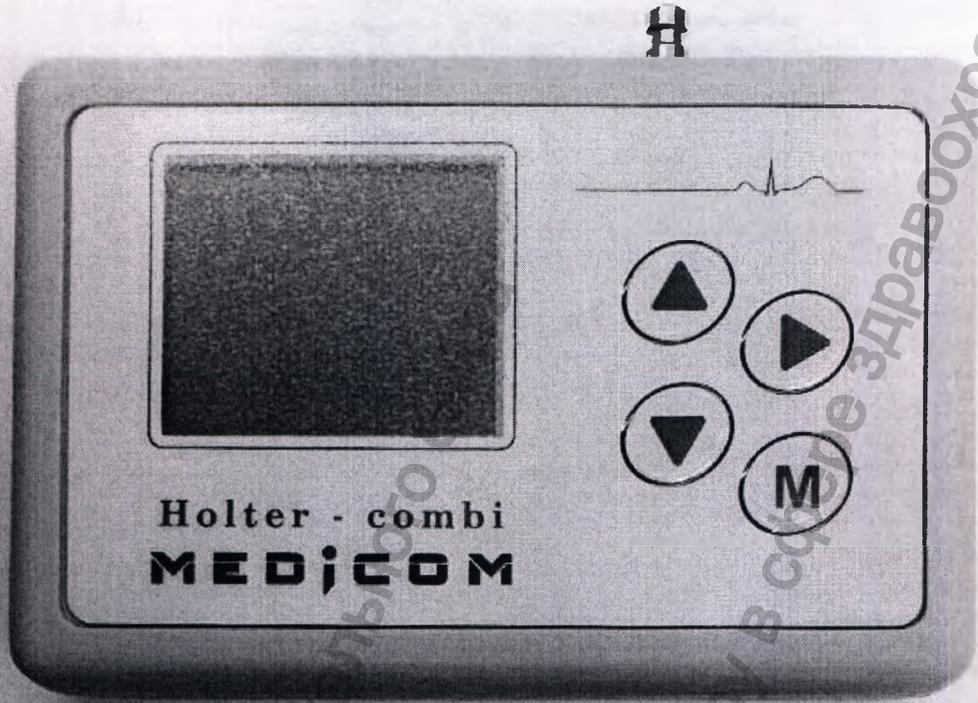

Чехол с поясным и плечевым ремнем для регистраторов ИН




Чехол с поясным и плечевым ремнем для регистраторов КР



Чехол с поясным и плечевым ремнем для регистраторов МД



Шланг воздушный

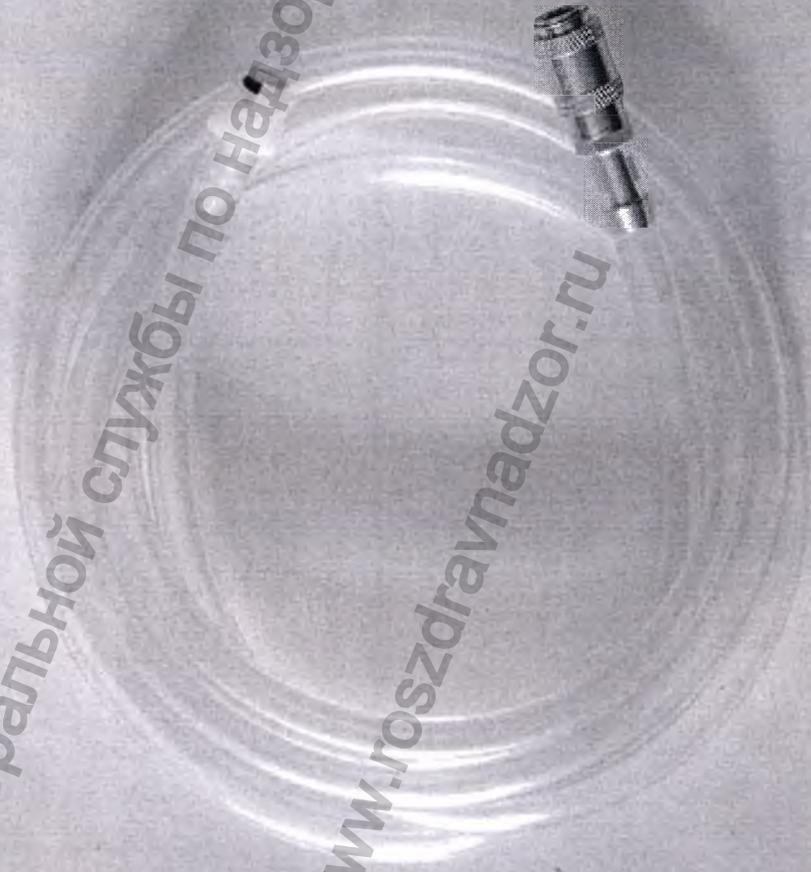

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

www.roszdravnadzor.ru

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью
Всего 31 листа (ов)
Шокин В.И.



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.roszdravnadzor.ru