



# Макет маркировки картонной коробки медицинского изделия «Система контроля уровня глюкозы в крови

Gmate Life по ТУ 26.60.12-001-87060442-2018»




# Gmate LIFE

Система контроля уровня глюкозы в крови Gmate Life GOD

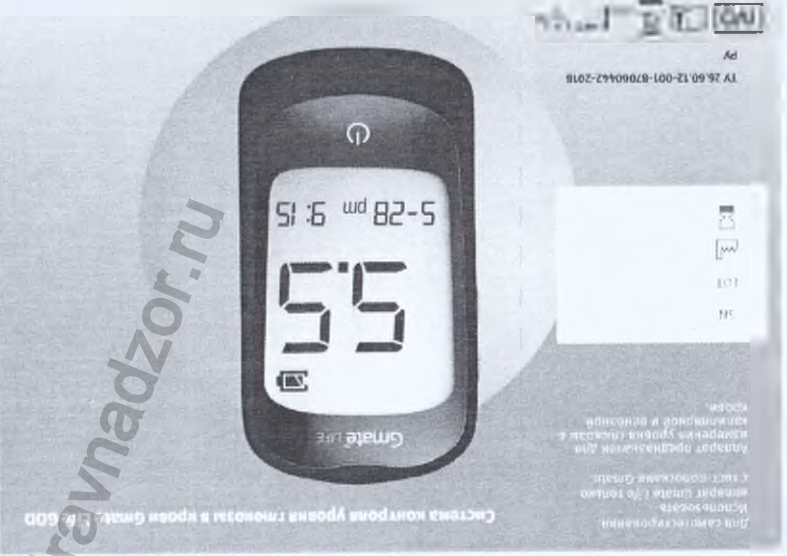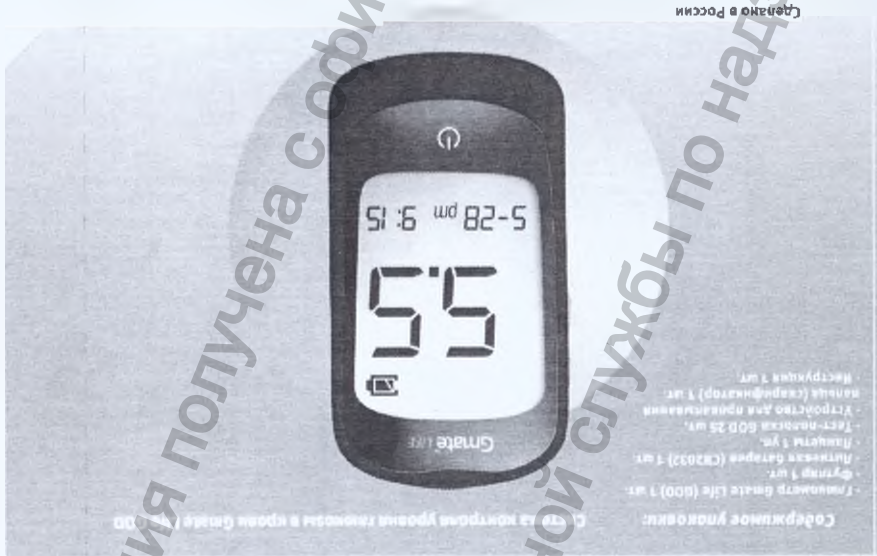


Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Система контроля уровня глюкозы в крови Gmate Life по ТУ 26.60.12-001-87060442-2018»

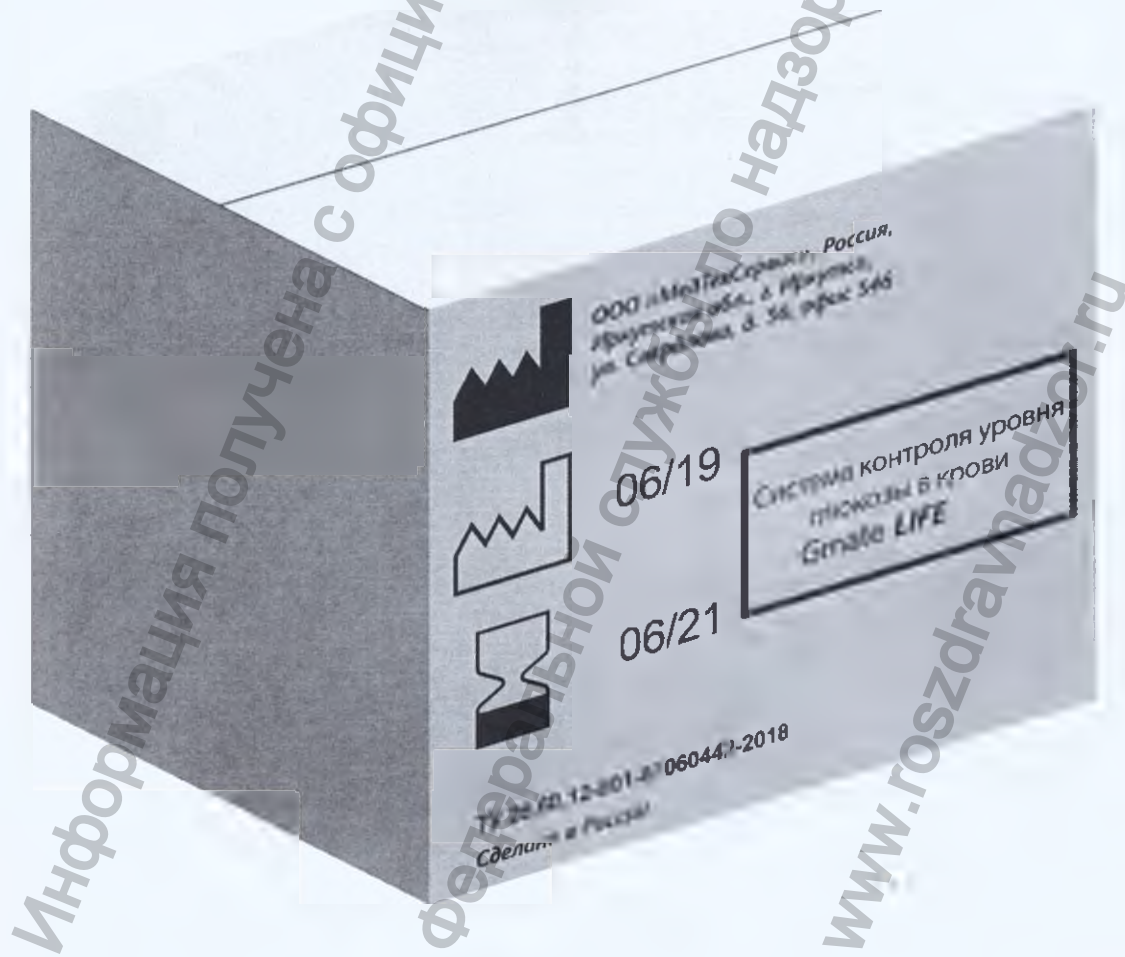

Макет маркировки грузовых мест медицинского изделия «Система контроля уровня глюкозы в крови

Gmate Life по ТУ 26.60.12-001-87060442-2018»

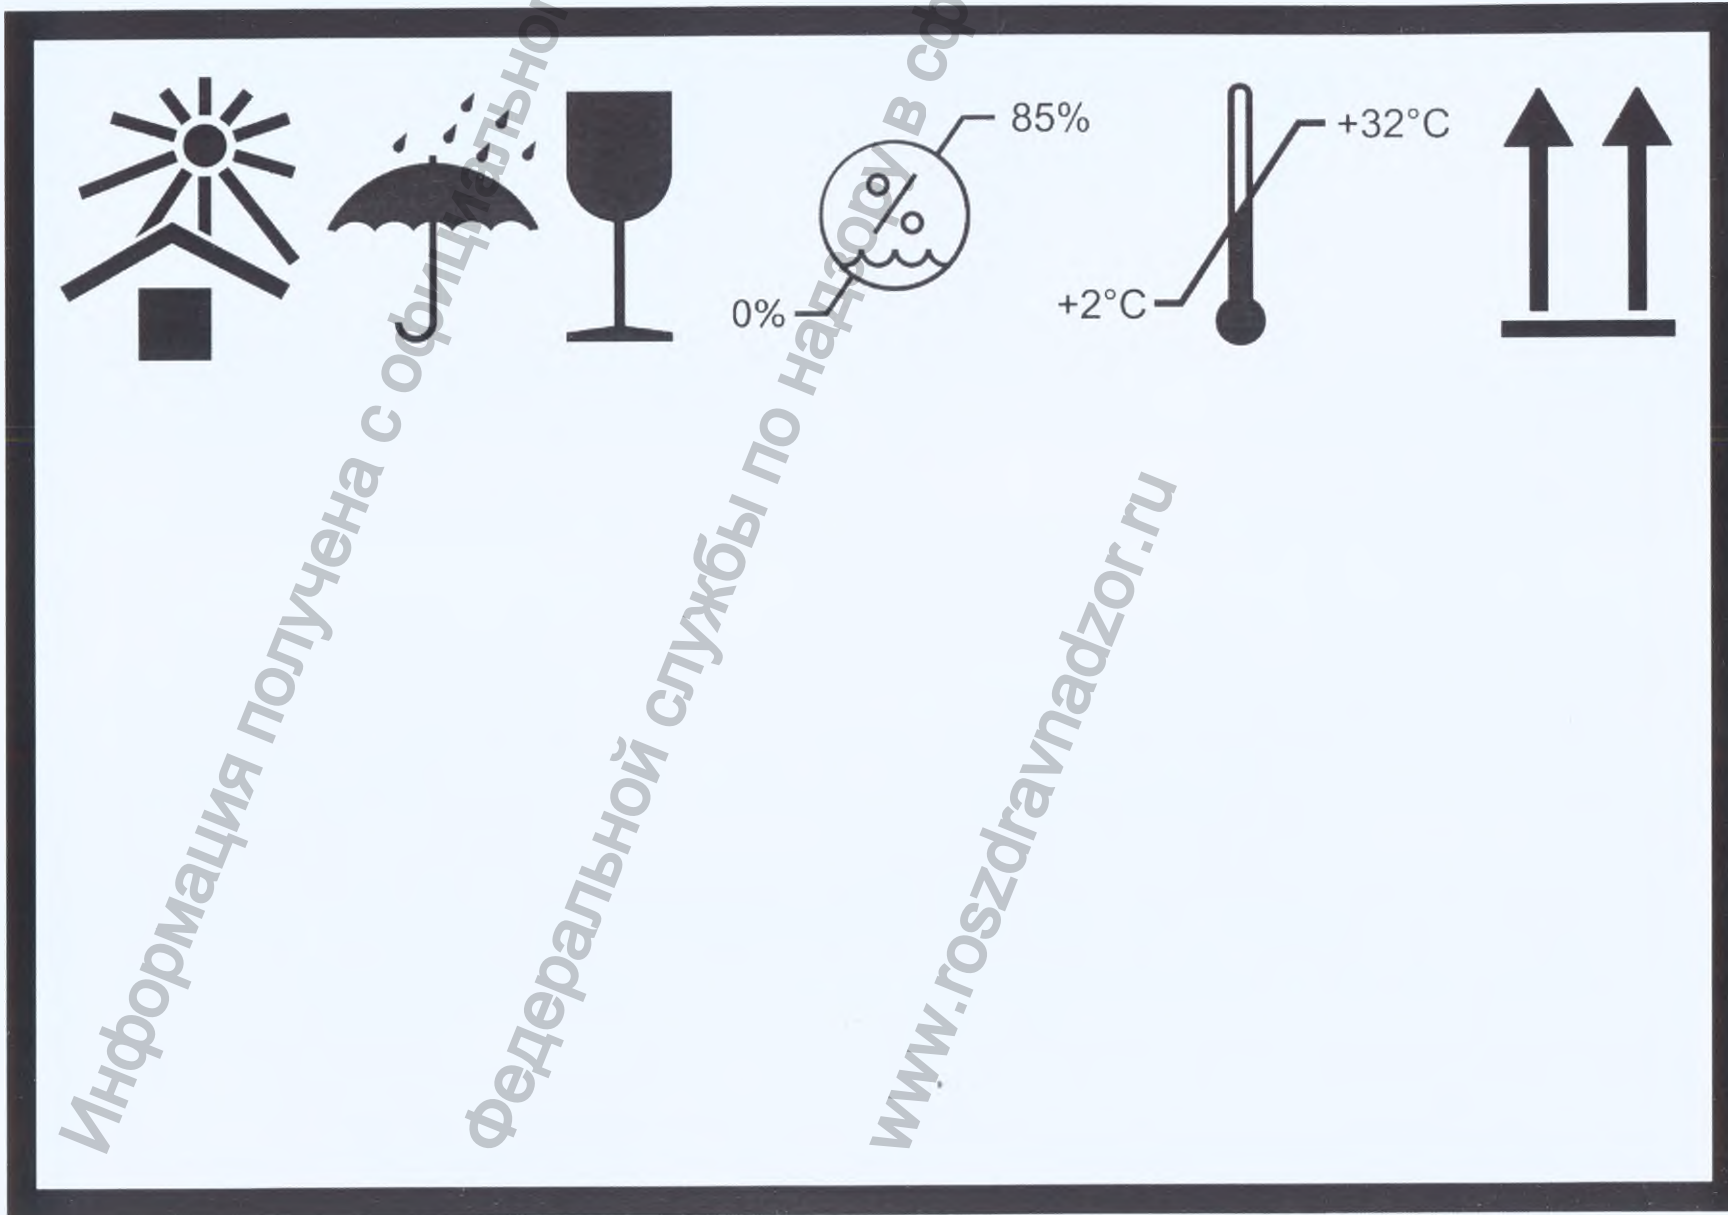



Маркет маркировки глюкометра «Система контроля уровня глюкозы в крови Gmate Life по ТУ 26.60.12-001-87060-442-2018»

Система контроля уровня глюкозы в крови

# Gmate *LIFE* GDH

3V  CR2032 10mW

Для самотестирования.

Использовать только  
с тест-полосками Gmate Life.



SN

LOT



ООО «МедТехСервис», Россия, Иркутская обл.  
г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 36, офис 546

Генеральный директор  
ООО «МедТехСервис»



Система контроля уровня глюкозы в крови

# Gmate *LIFE* GOD

3V  CR2032 10mW

Для самотестирования.

Использовать только  
с тест-полосками Gmate Life.



SN

LOT



ООО «МедТехСервис», Россия, Иркутская обл.  
г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 36, офис 546

Журавлев Артём Андреевич

Всего враншо, крстариован  
и сурвешно мексико (1.5.18)  
мисов.  
Генеральный директор  
А.А. Мухоморов  
И.И. Мухоморов



Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения


[www.goszdravnadzor.ru](http://www.goszdravnadzor.ru)

## Фотографические изображения

«Система контроля уровня глюкозы в крови Gmate Life по ТУ 26.60.12-001-87060442-2018», в вариантах исполнения



Глюкометр Gmate Life (GDH)

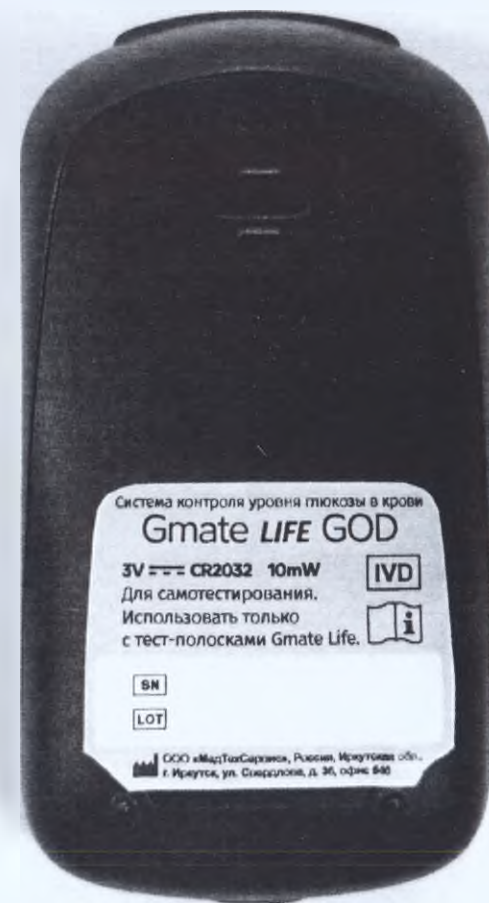

Глюкометр Gmate Life (GOD)





Тест-полоски GOD 35×5 мм

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере з  
www.goszdravnadzor.ru



Тест-полоски GDH 30x5 мм

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по контролю за оборотом в сфере з

www.goszdrnadzor.ru



Литиевая батарея (CR2032)

Информация получена с официального сайта


Федеральной службы по надзору в сфере з

www.goszdravnadzor.ru

Футляр







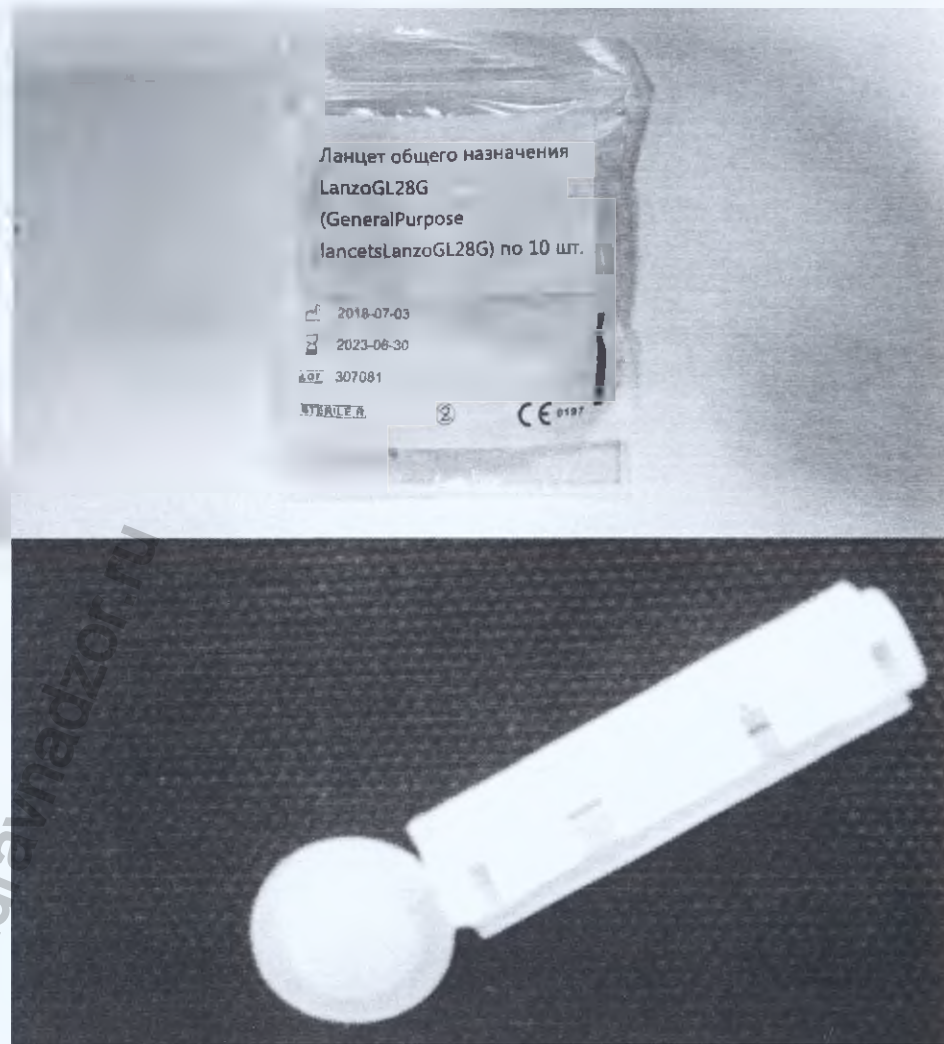


Устройство для прокалывания пальца (скарификатор) (РУ №ФСЗ 2012/13227 от 09.11.2012 г.)

Ланцеты (РУ №ФСЗ 2012/13227 от 09.11.2012 г.)

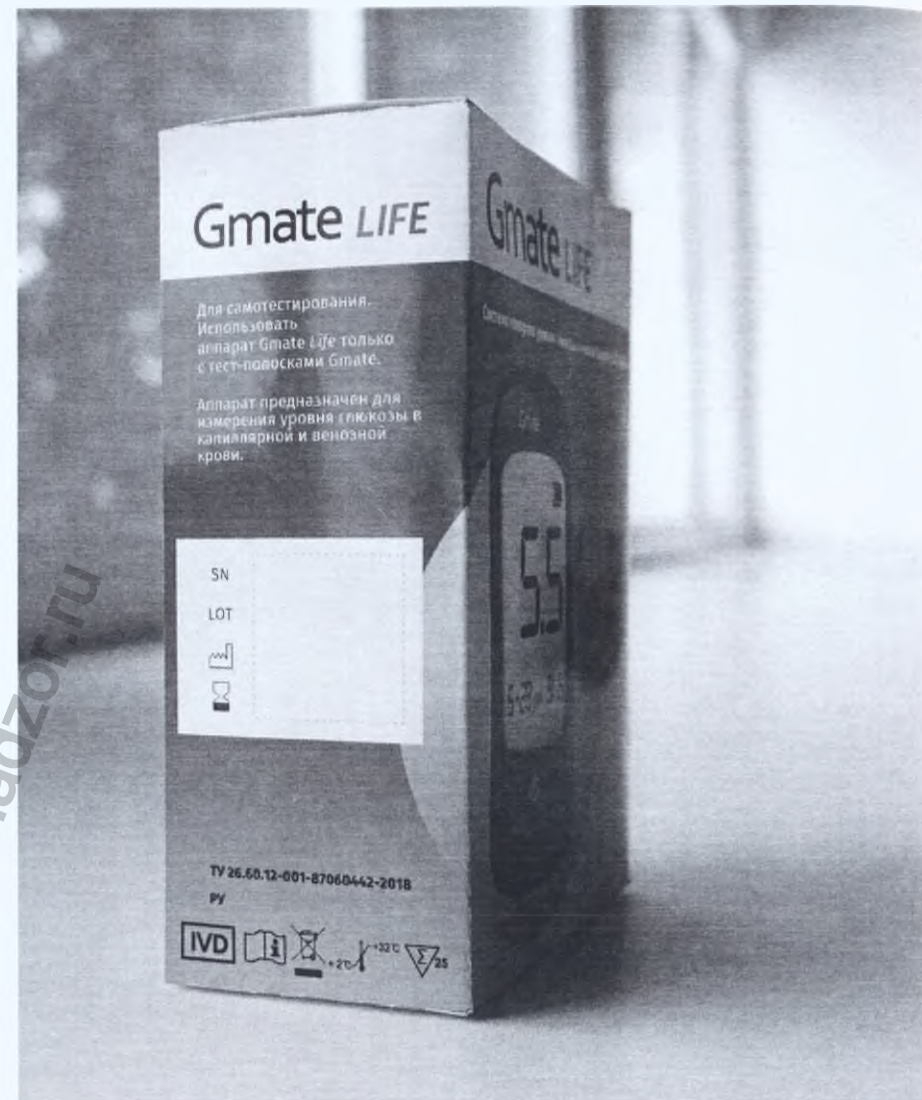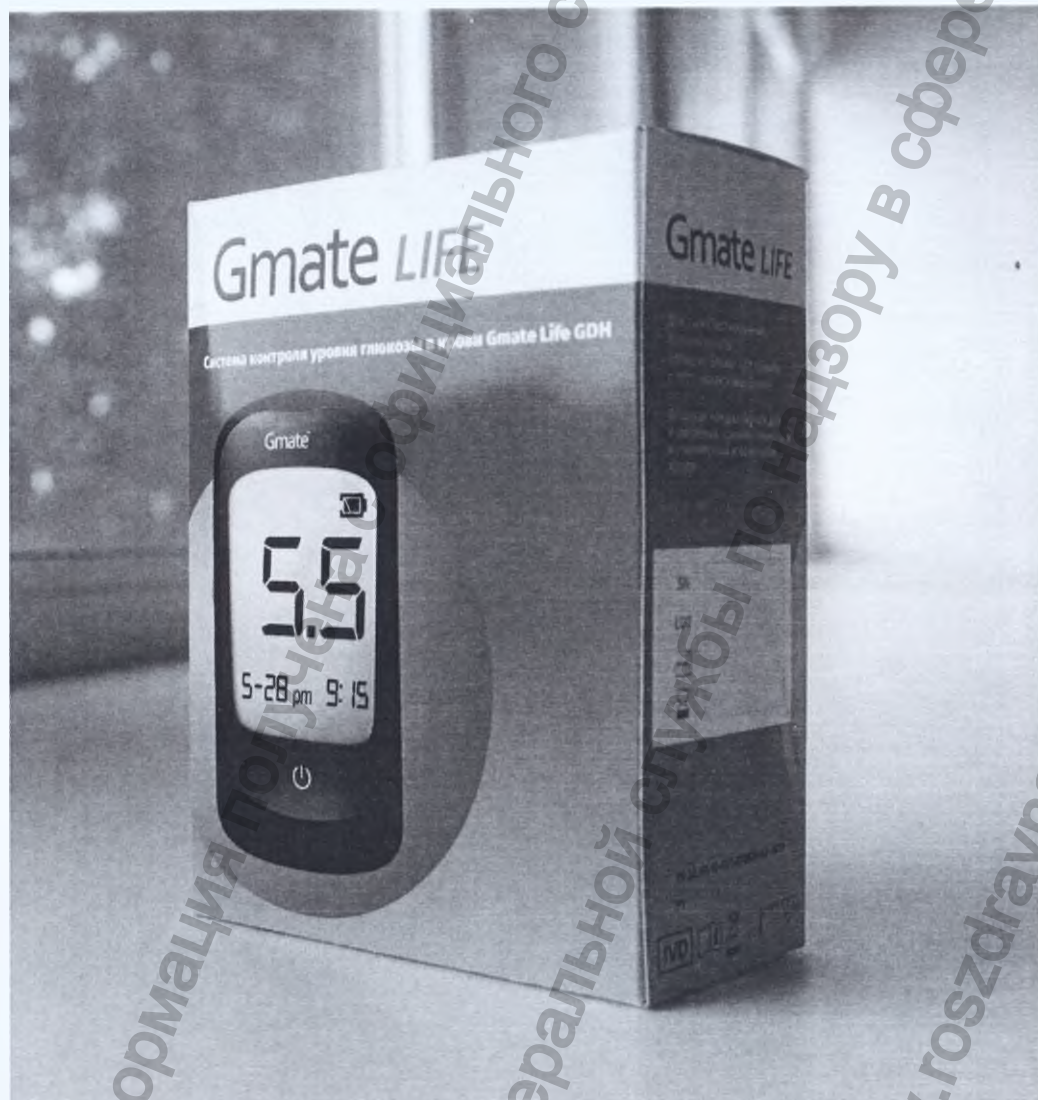

Система контроля уровня глюкозы в крови Gmate Life GDH



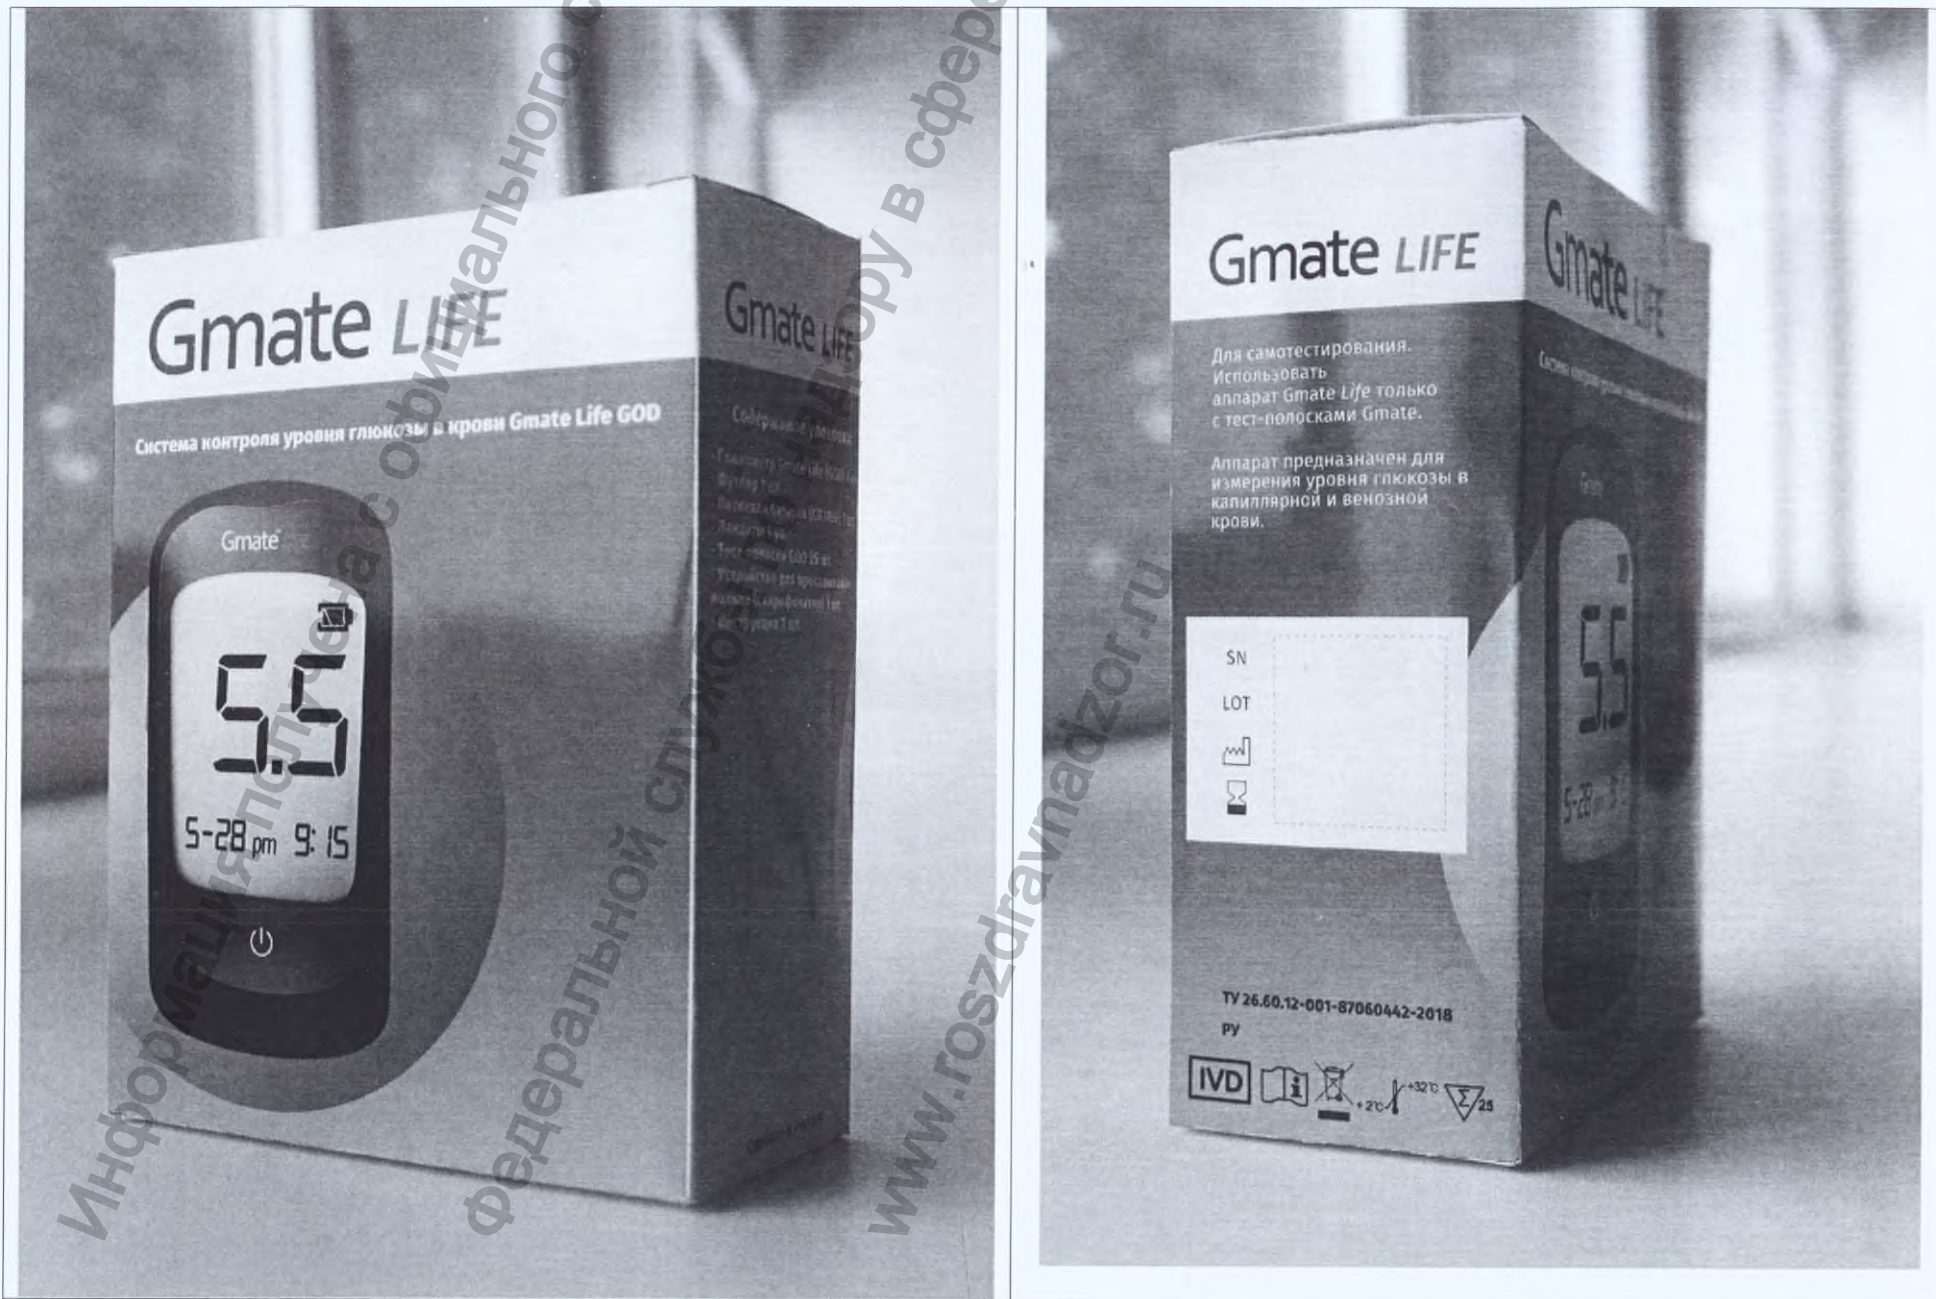

Система контроля уровня глюкозы в крови Gmate Life GOD

Всего страниц, пронумеровано  
и сериально исчислено (включая  
титлы  
Титульный лист  
ООО «МедТекСервис»  
д.д. Мухоморова



Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здр

[www.goszdramnadzor.ru](http://www.goszdramnadzor.ru)