

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие:

Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности качественного обнаружения антител класса IgM к вирусу краснухи иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Rubella антитела IgM Контрольные материалы (Alinity i Rubella IgM Controls)"


(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramnadzor.ru

Фотографические изображения Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности качественного обнаружения антител класса IgM к вирусу краснухи иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Rubella антитела IgM Контрольные материалы (Alinity i Rubella IgM Controls)"

Alinity i Rubella IgM Controls

	CONC	RANGE	CONC	RANGE	
	INDEX	INDEX	S/CO	S/CO	
CONTROL -	1 x 4.0 mL	-	≤ 0.84	-	≤ 0.53
CONTROL +	1 x 4.0 mL	3.50	1.75 - 5.25	2.19	1.09 - 3.28



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Fintskirt Business Park
Sligo
Ireland
+353-71-9171712

IVD


CE
0843



CONTAINS: AZIDE

PRODUCT OF IRELAND

Фотографические изображения Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности качественного обнаружения антител класса IgM к вирусу краснухи иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Rubella антитела IgM Контрольные материалы (Alinity i Rubella IgM Controls)"

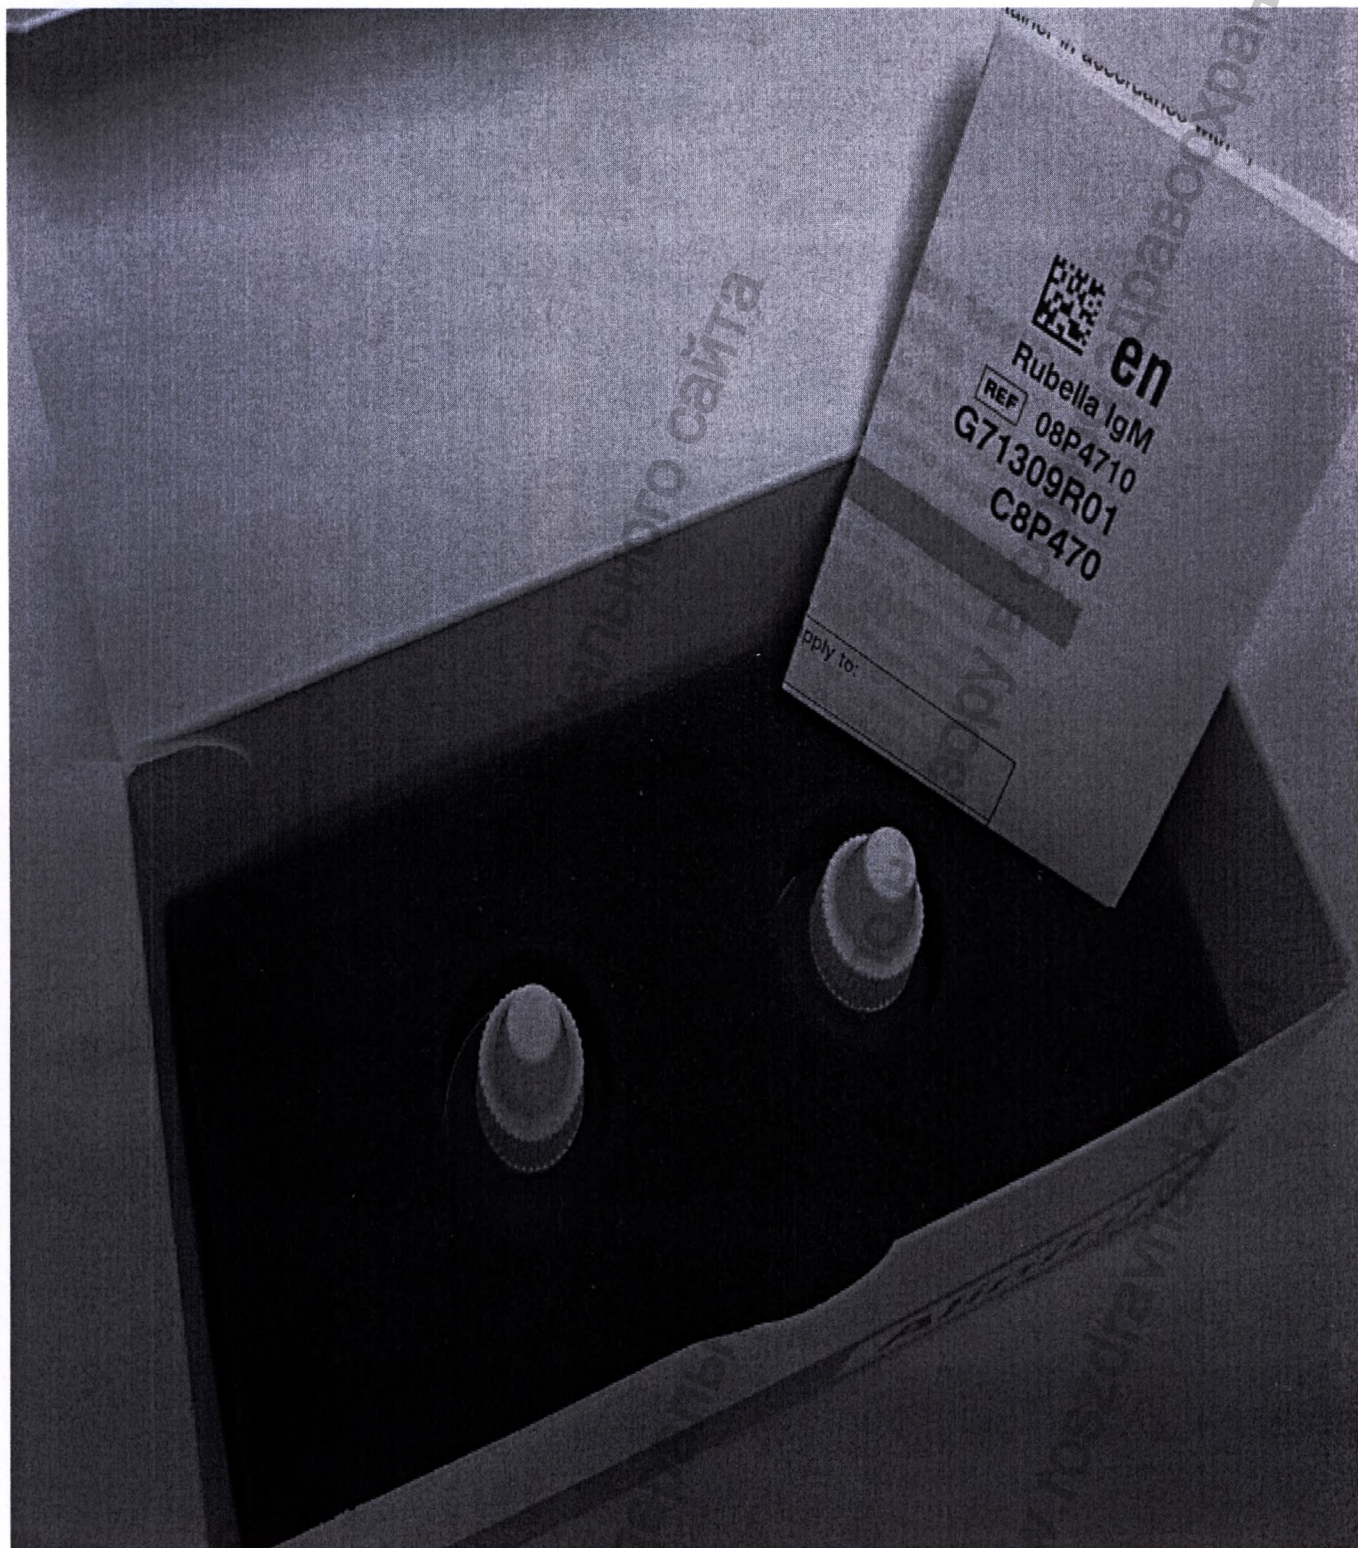


Информация

Федеральное

www

Фотографические изображения Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности качественного обнаружения антител класса IgM к вирусу краснухи иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Rubella антитела IgM Контрольные материалы (Alinity i Rubella IgM Controls)"

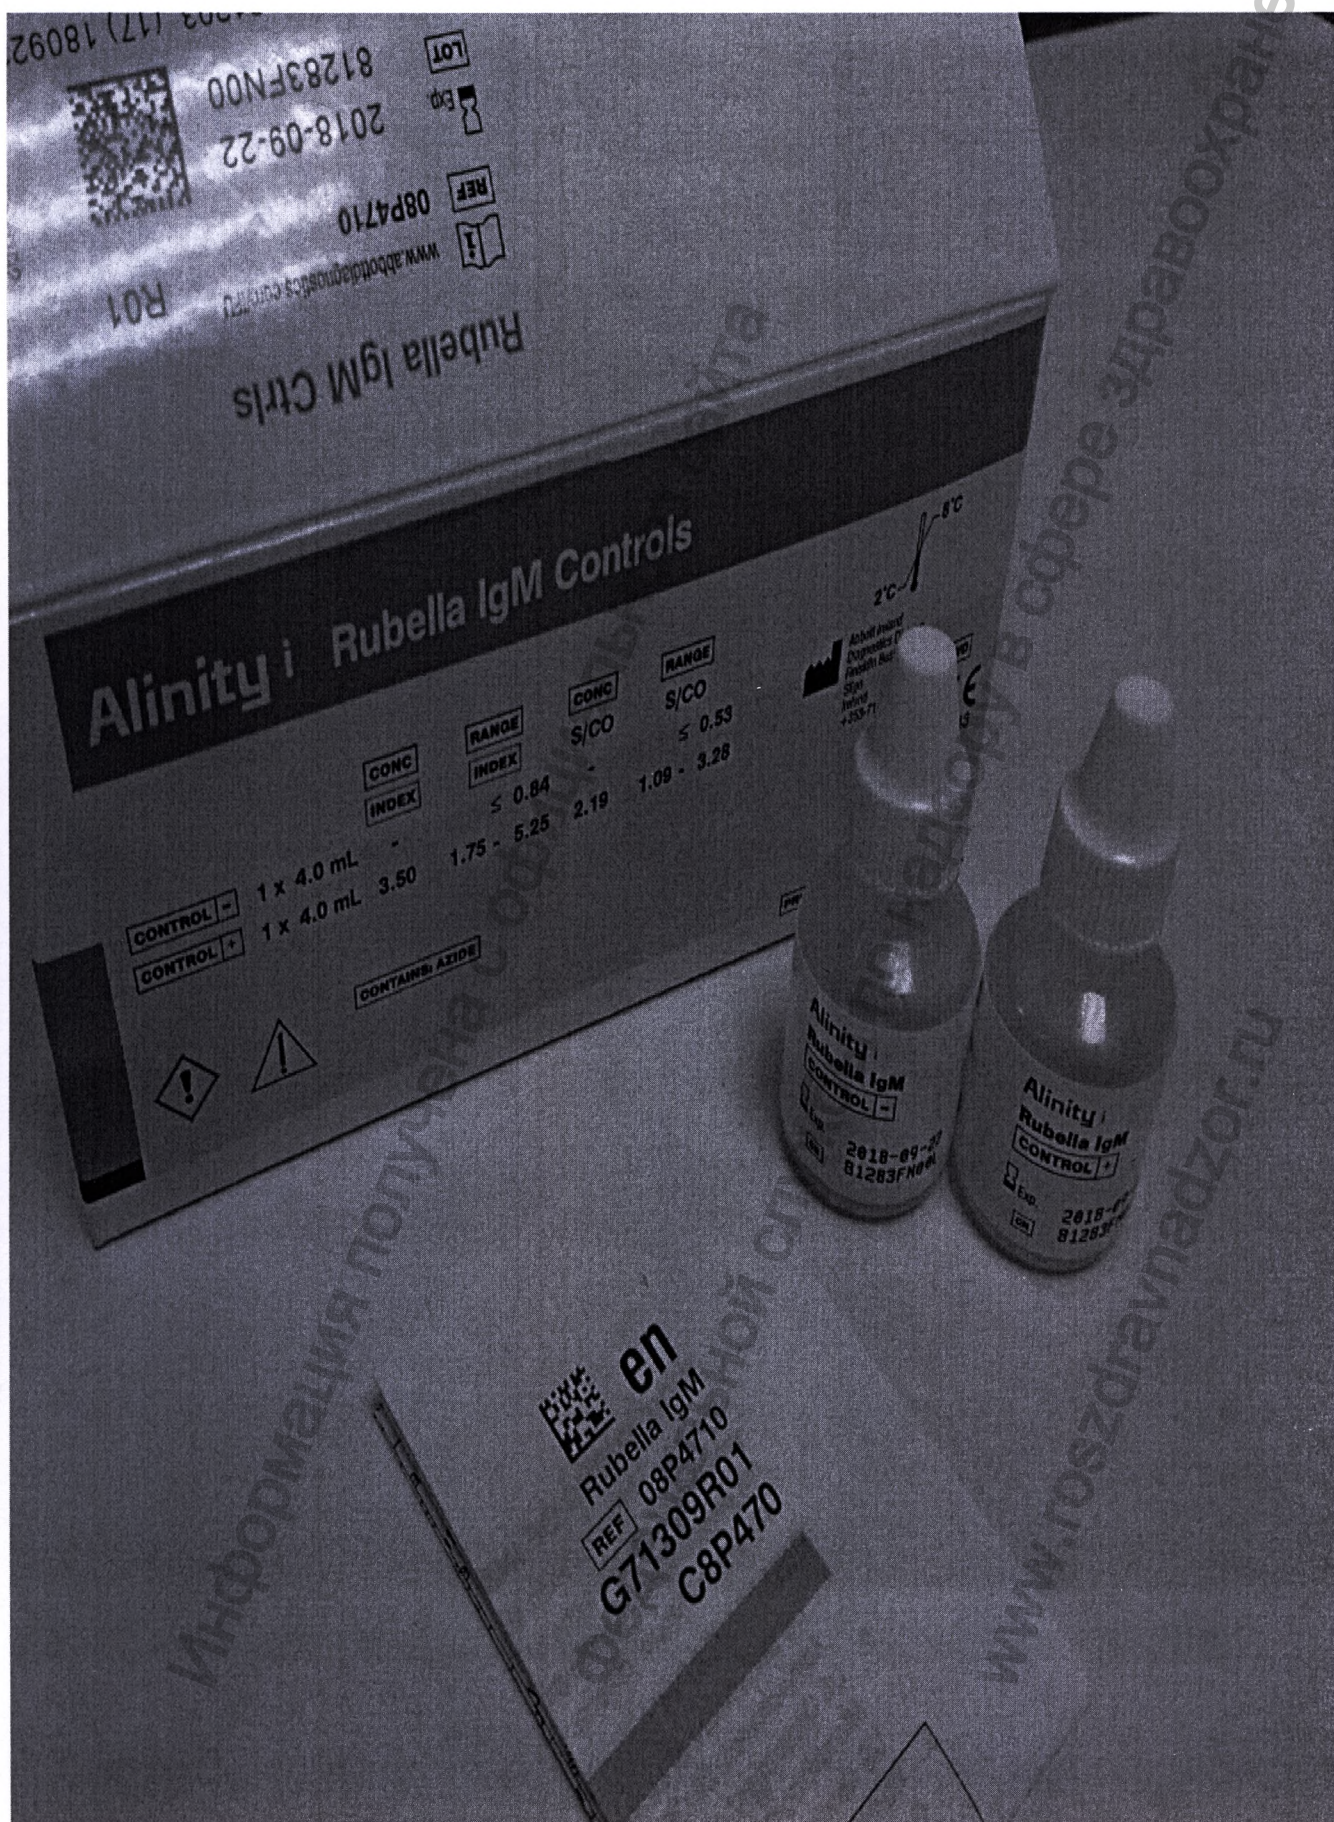

Фотографические изображения Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности качественного обнаружения антител класса IgM к вирусу краснухи иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Rubella антитела IgM Контрольные материалы (Alinity i Rubella IgM Controls)"



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

листов



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.ru