

Фотографические изображения

Система для самоконтроля протромбинового времени/МНО Коагулометр CoaguChek® INRange

Информация получена с официального сайта


Федеральной службы по надзору в сфере

www.roszdravnadzor.ru

СИСТЕМА ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПРОТРОМБИНОВОГО ВРЕМЕНИ/МНО Коагулометр CoaguChek® INRange

Состав:

1. Коагулометр CoaguChek® INRange, 1 шт.
2. Устройство для прокалывания кожи CoaguChek XS Softclix с инструкцией по использованию, 1 шт.
3. Ланцеты CoaguChek Softclix одноразовые, стерильные, 20 шт. в 1 упаковке.
4. Руководство пользователя, 1 шт.
5. Краткое справочное руководство, 1 шт.
6. Кабель USB, 1 шт. (при необходимости)
7. Щелочные батареи 1,5В, тип AAA (LR03), 4 шт. (при необходимости)
8. Сумка для переноски системы, 1 шт.

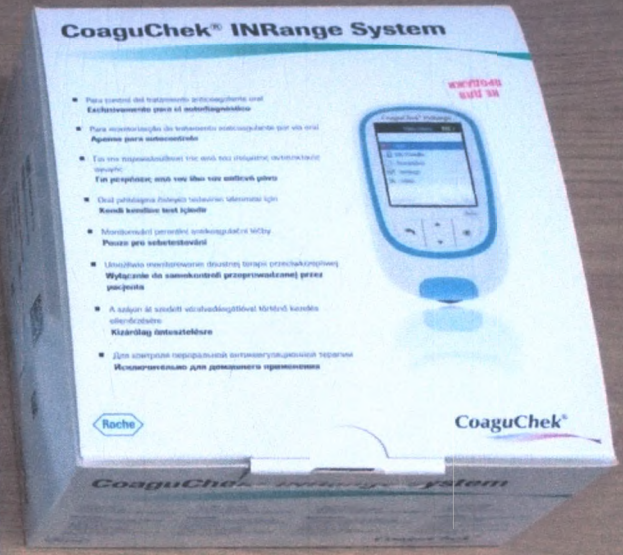


CoaguChek® INRange



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramnadzor.ru

Информация получена с официального сайта
СоагуСчек® XS Softclix
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.ru

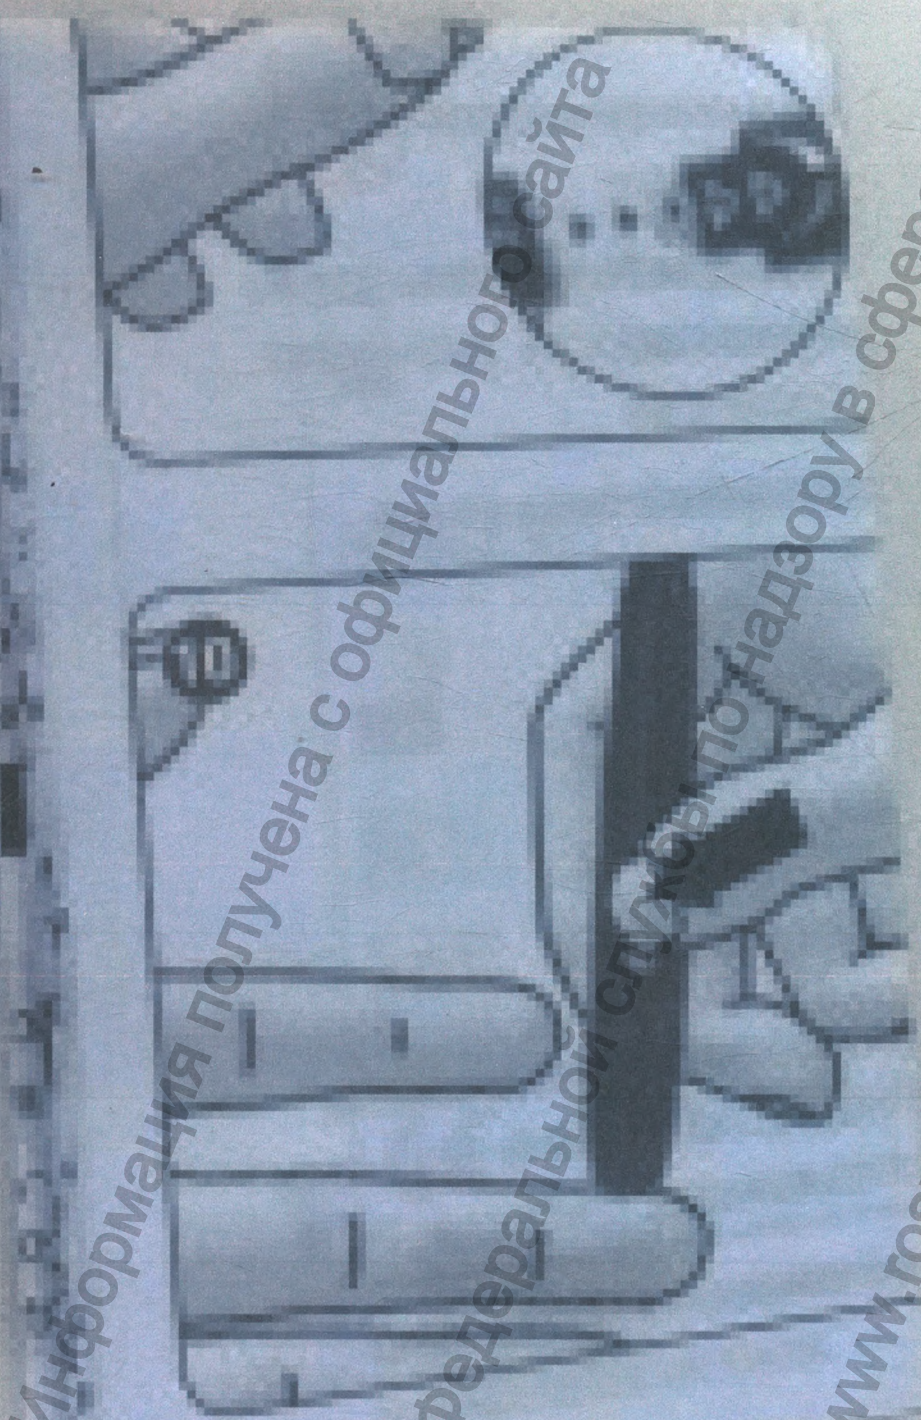

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.ru

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения



www.goszdravnadzor.ru

СоагусЧек® INRange
Руководство пользователя
Návod k obsluze

СоагусЧек®

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения



www.goszdravnadzor.ru





CoaguChek® INRange

Краткая инструкция

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramnadzor.ru

CoaguChek®

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

CoaguChek®




www.goszdravnadzor.ru



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramadzor.ru

Щелочные батареи 1,5В, тип ААА (LR03), 4 шт

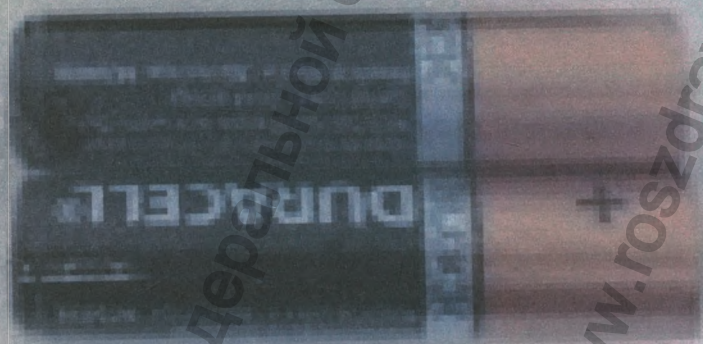

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.ru

Образцы маркировки

Маркировка вторичной упаковки

CoaguChek® INRange System

- Para control del tratamiento anticoagulante oral
Exclusivamente para el autodiagnóstico
- Para monitorização do tratamento anticoagulante por via oral
Apenas para autocontrolo
- Για την παρακολούθηση της από του στόματος αντιπηκτικής αγωγής
Για μετρήσεις από τον ίδιο τον ασθενή μόνο
- Oral pıhtılaşma önleyici tedavinin izlenmesi için
Kendi kendine test içindir
- Monitorování perorální antikoagulační léčby
Pouze pro sebetestování
- Umożliwia monitorowanie doustnej terapii przeciwkrzepliwej
Wyłącznie do samokontroli przeprowadzanej przez pacjenta
- A szájon át szedett véralvadásgátlóval történő kezelés ellenőrzésére
Kizárólag öntesztelésre
- Для контроля пероральной антикоагуляционной терапии
Исключительно для домашнего применения



CoaguChek®


CoaguChek[®] INRange System

COAGUCHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche.

 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Straße 116
D-68305 Mannheim

www.roche.com
www.coaguchek.com

Made in Germany



CoaguChek[®]



Информация получена с официального
Федеральный службного надзору в сфе
www.roszdravnadzor.ru

REF 07404379 015

GTIN 04015630942299

EXP 2018-11-09

CoaguChek® Lancets

LOT 12518025

EXP 2022-08-31

CoaguChek® INRange

LOT 05811093

SN MG 00081214



4 015630 942299

(20) 1 000603338



CoaguChek®

CoaguChek® INRange System

- Jednoduché používání
- Přesný
- Praktická správa výsledků

Obsah:

- 1 měřicí přístroj CoaguChek INRange
- 1 transportní pouzdro pro systém
- 4 baterie AAA
- odběrové pero CoaguChek XS Softclix
- lanceta CoaguChek Softclix
- Návod k použití

- Łatwy w użyciu
- Dokładny i precyzyjny
- Wygodne zarządzanie wynikami

Zawartość:

- 1 aparat CoaguChek INRange
- 1 pokrowiec na system
- 4 baterie AAA
- Nakłuwacz CoaguChek XS Softclix
- Ostrze CoaguChek Softclix
- Instrukcja użytkownika

- Egyszerű használat
- Hiteles és pontos
- Kényelmesen kezelhető eredmények

Tartalom:

- 1 CoaguChek INRange mérőkészülék
- 1 készüléktartó tok
- 4 AAA elem
- CoaguChek XS Softclix ujjbegyszűrő
- CoaguChek Softclix Lancet
- Használati útmutató

- Простота в использовании
- Точность и надежность
- Удобное управление результатами

Содержимое упаковки:

- 1 коагулометр CoaguChek INRange
- 1 сумка для переноса хранения
- 4 батарейки AAA
- Устройство для прокалывания кожи CoaguChek XS Softclix
- Набор ланцетов CoaguChek Softclix
- Руководство пользователя

Roche

CoaguChek®

CoaguChek® Softclix Lancet

20 Sterile lancets

REF 03506517001

LOT 12518025



2022-08-31



STERILE R

CE 0088

COAGUCHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche.

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.roche.com



0791647700101-V1

Информация по

Федеральному

www.goszdravnadzor.ru

Информация по

Федеральному

сфере здравоохранения

CoaguChek® INRange

REF 07404379



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
Made in Germany



This device
contains
transmitter



0123



2018-11-09



04015630943302



MG 00081214

LISTED
Laboratory Equipment
QC70




6V
4 x AAA



07188846001(02)

Информация
Федеральный надзор в сфере здравоохранения
официального сайта
www.roszdravnadzor.ru



Система для самоконтроля протромбинового
времени/МНО Коагулометр CoaguChek®
INRange

Регистрационное удостоверение № _____

Срок годности: Медицинское изделие рассчитано
на проведение 600 измерений протромбинового
времени/МНО

Ограничение температуры хранения см. на
упаковке

Номер лота см. на упаковке

Для использования с Тест-полосками для
самоконтроля протромбинового времени/МНО
«CoaguChek XS PT Test PST; CoaguChek INRange
/ CoaguChek XS»

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH»
("Рош Диагностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse
116, D- 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для
диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ: Общество с
ограниченной ответственностью «Рош
Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»),
107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495
229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail:
moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер: 07404379015

ERC



Система для самоконтроля протромбинового времени/МНО Коагулометр CoaguChek® INRange

Регистрационное удостоверение № _____
Срок годности: Медицинское изделие рассчитано на проведение 600 измерений протромбинового времени/МНО

Ограничение температуры хранения: см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Для использования с Тест-полосками для самоконтроля протромбинового времени/МНО «CoaguChek XS PT Test PST; CoaguChek INRange / CoaguChek XS»

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, D- 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики *in-vitro*

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер: 07404379015

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.ru

Информация получена с официального

Федеральной службы по надзору в сфере

www.roszdravnadzor.ru

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
20 листа (ов)



Лучина И. А.
Руководитель отдела логистики
и качества по доверенности от:

02 ИЮЛ 2018