

ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здоровоохранение»

Горшкова Н.А.

2020 г.



Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Набор реагентов для определения креатинкиназы на анализаторах биохимических
серии Atellica (Atellica CH Creatine Kinase (Atellica CH CK_L))

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdramnadzor.ru

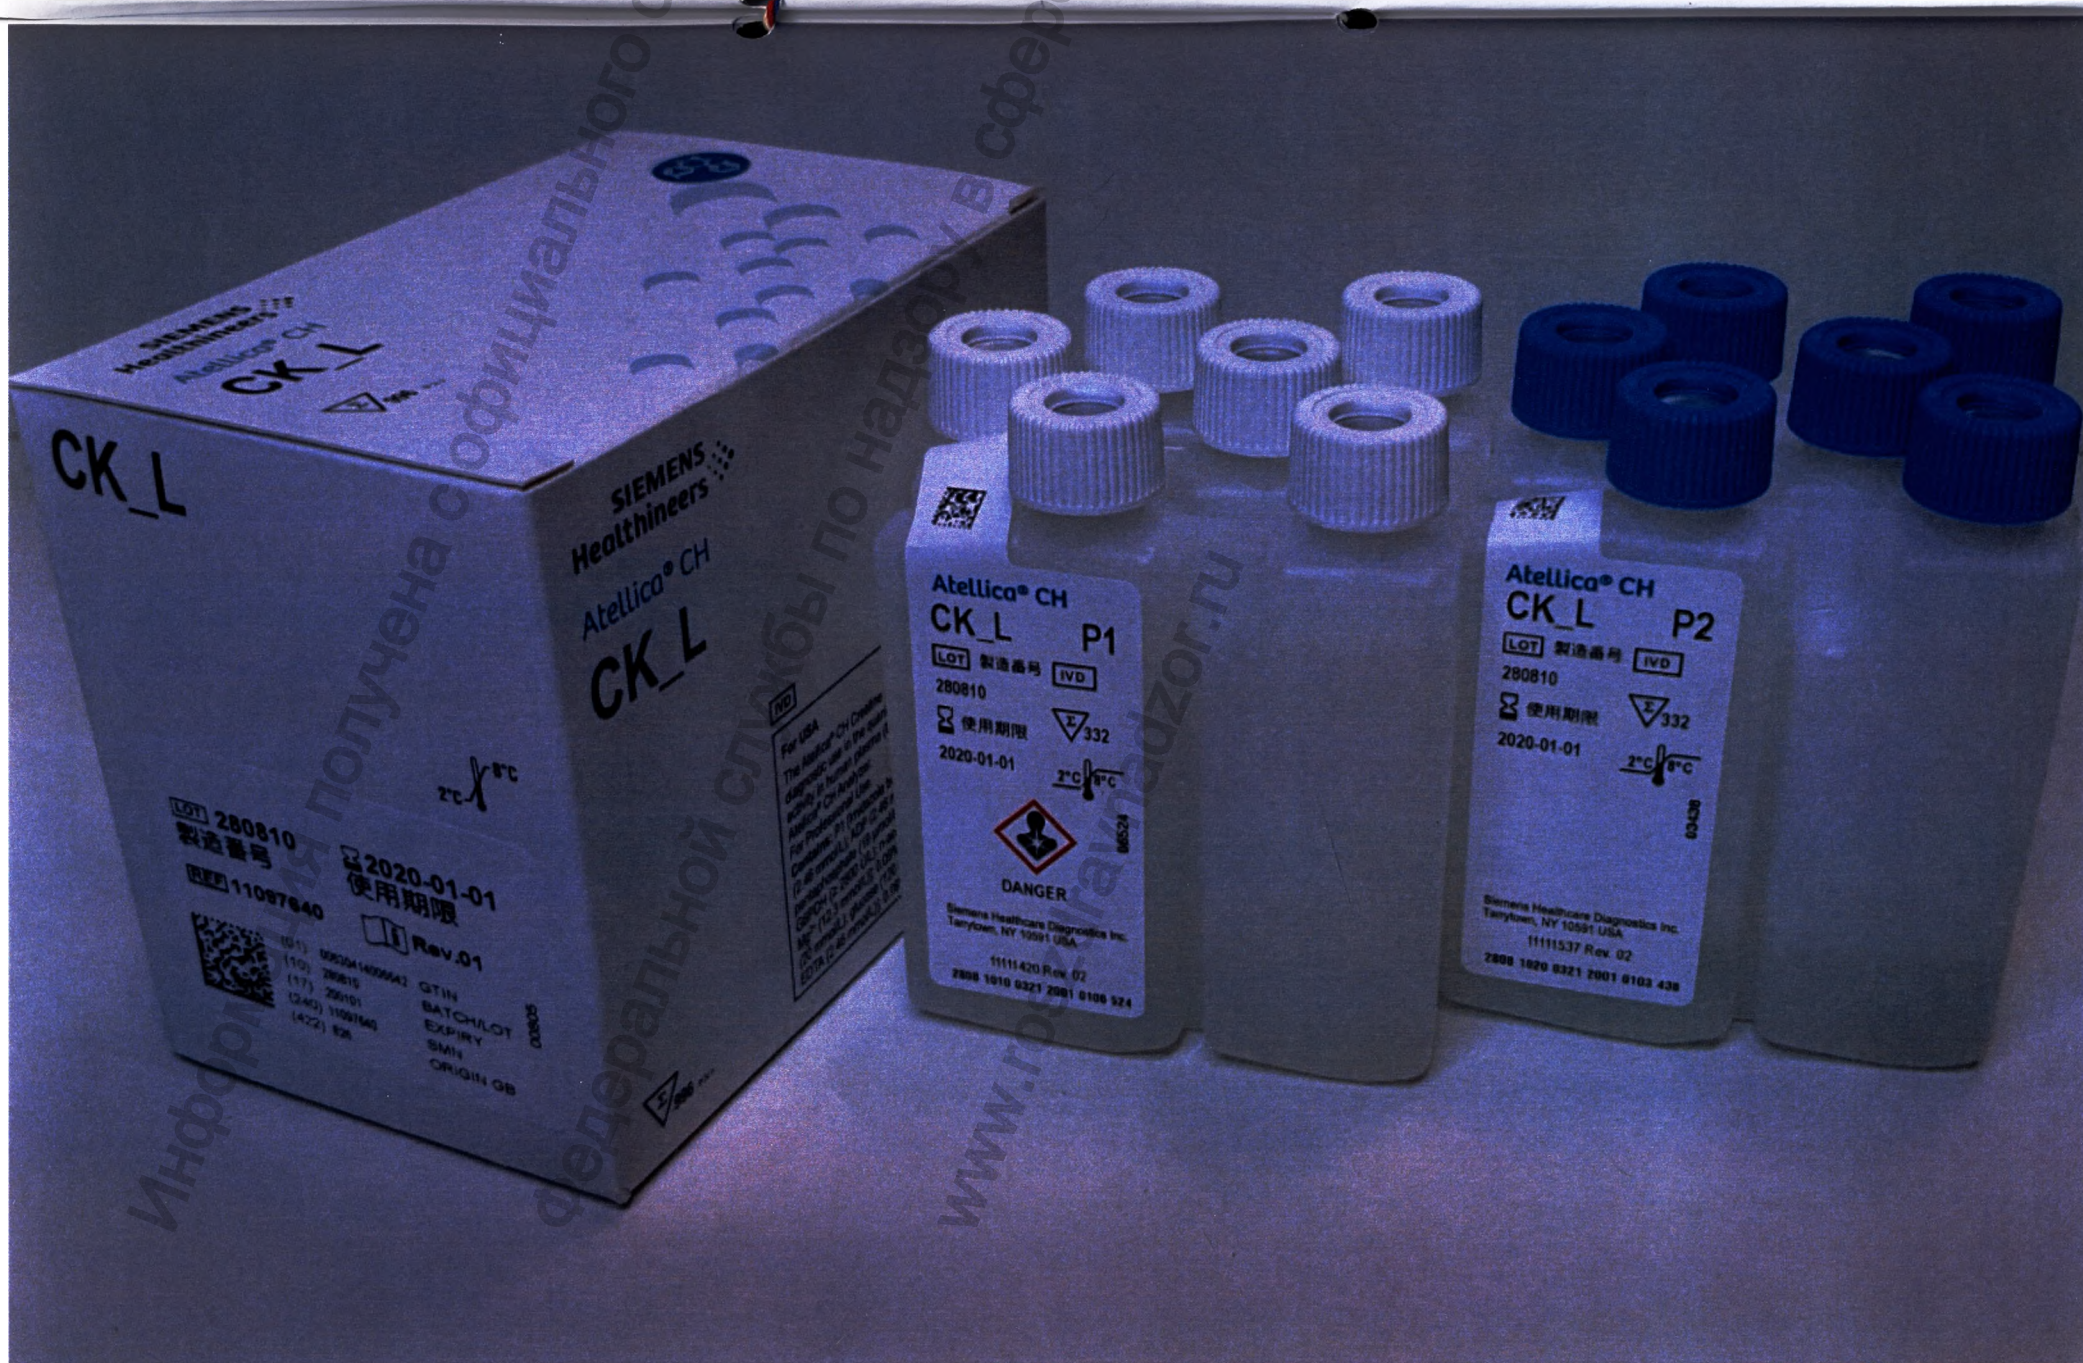


Рисунок 1 Набор реагентов для определения креатинкиназы на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Creatine Kinase (Atellica CH CK_L)): общий вид изделия

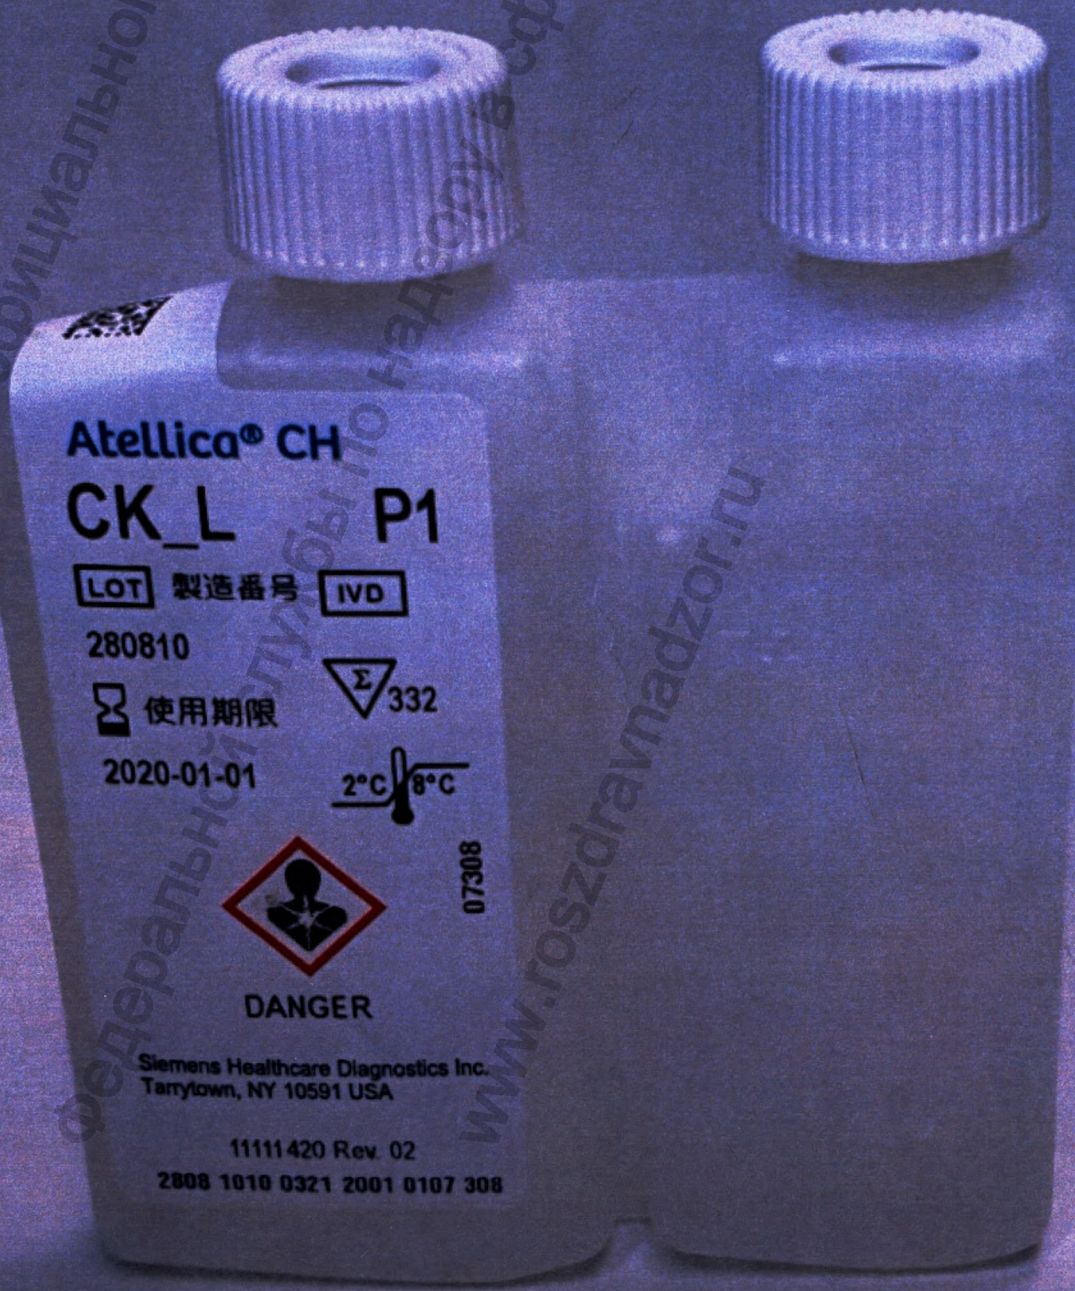


Рисунок 2 Набор реагентов для определения креатинкиназы на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Creatine Kinase (Atellica CH CK_L)): общий вид, упаковка 1

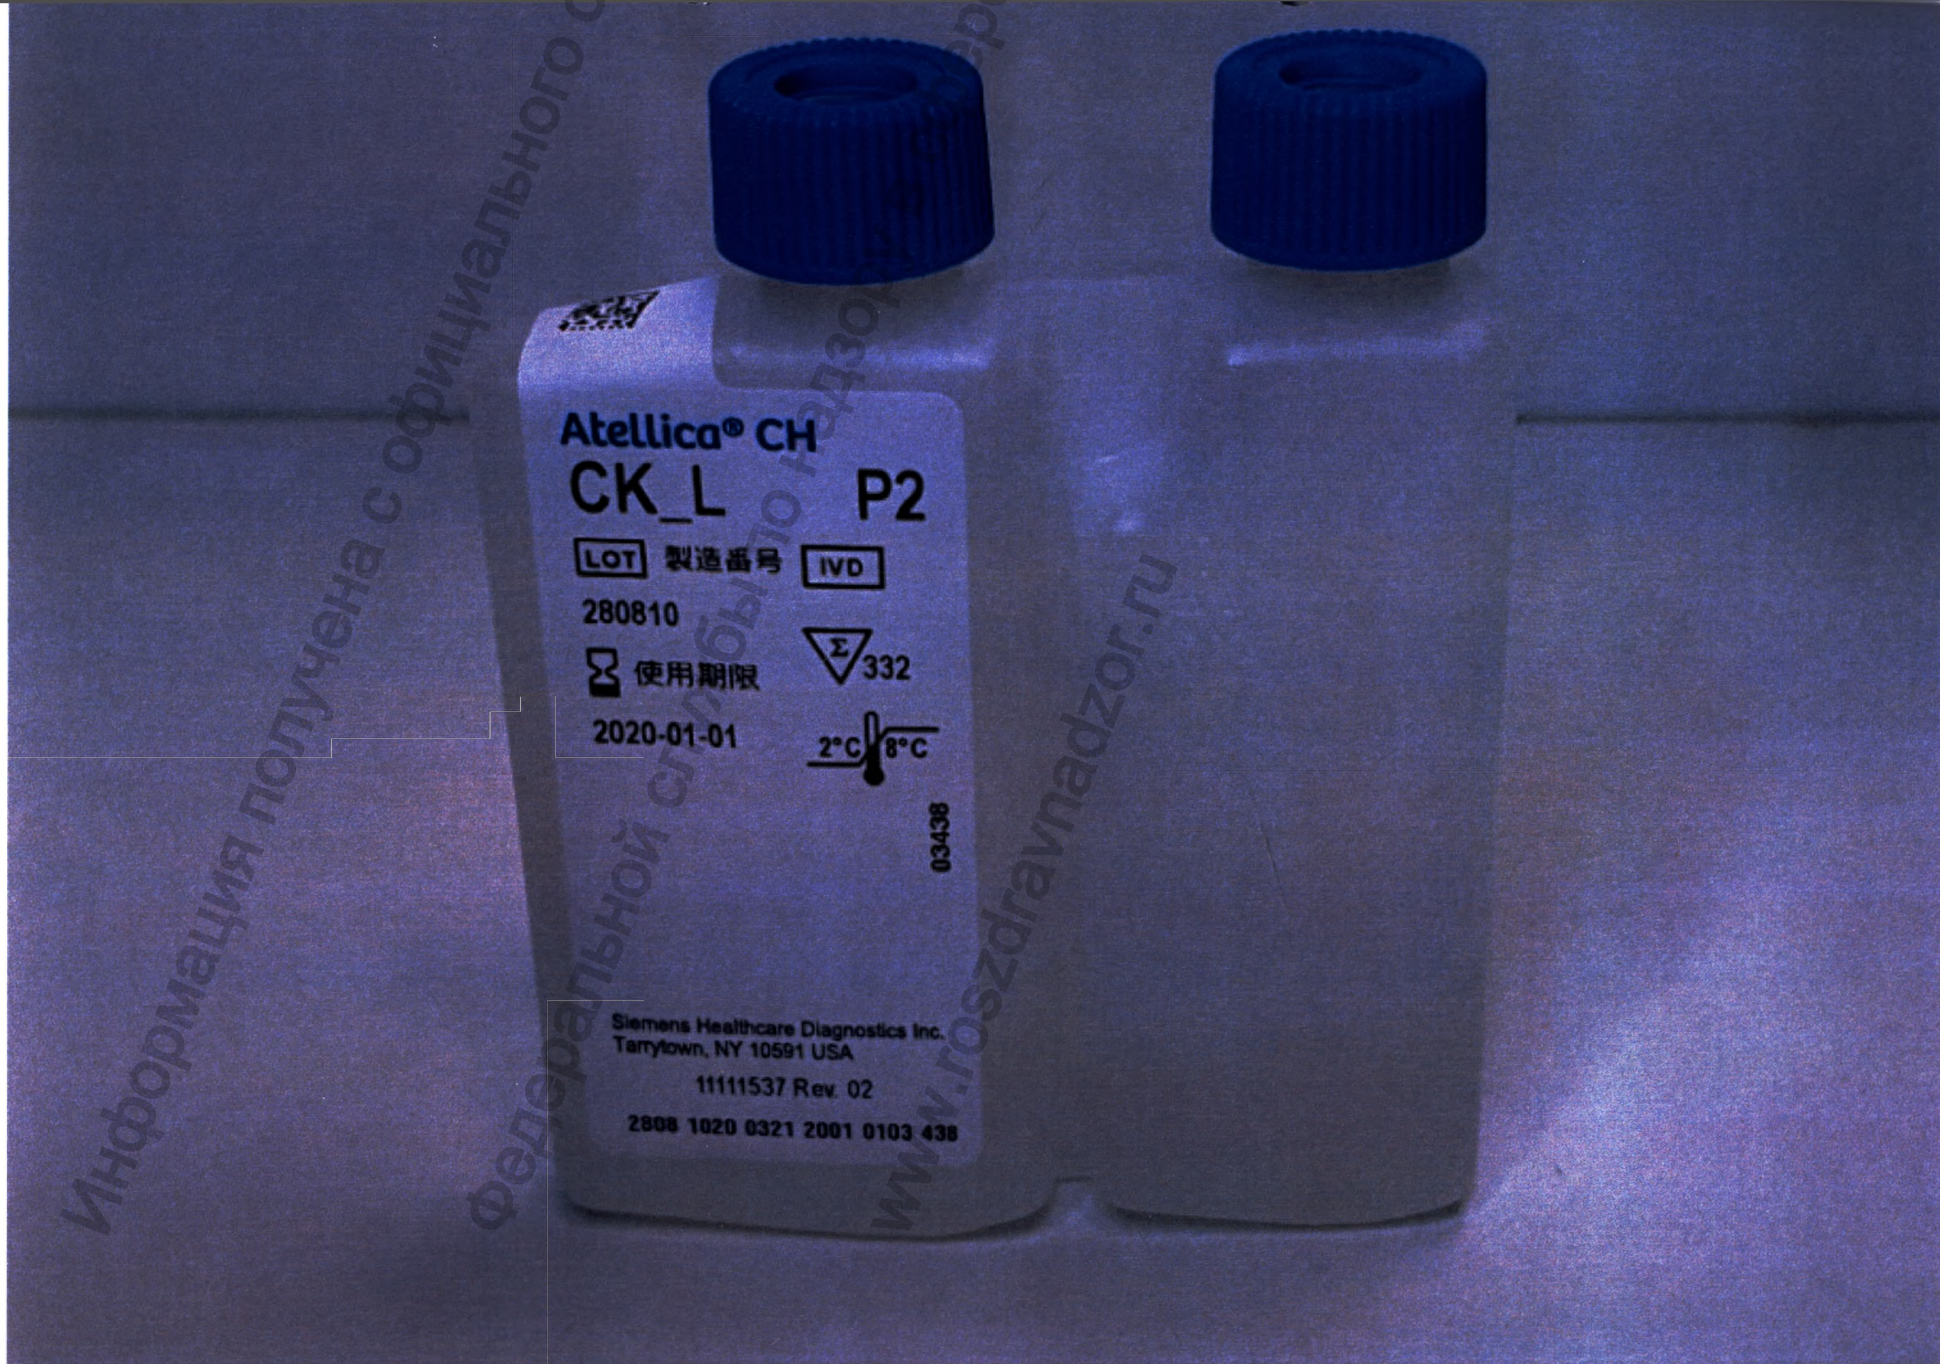


Рисунок 3 Набор реагентов для определения креатинкиназы на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Creatine Kinase (Atellica CH CK_L)): общий вид, упаковка 2

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

www.goszdravnadzor.ru

Всего прошито и пронумеровано 4 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

