

Фотографические изображения

Набор калибраторов для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Ferritin CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

бор калибраторов для количественного определения ферритина в сыворотке и
плазме крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей
иммунохимических cobas e (Ferritin CalSet Elecsys and cobas e analyzers)



Ferrit

edilmiş donorlerin
antikorlarının bulu
yonterimlerinde F
uygun şekilde i.
Ancak, hiçbir tı¹
dislayamayacak
kullanılmamalıdır
direktiflerine
Tüm reaktifle
oluşumunu e

Yöntem Sa)

Bu belgenin
gösterilmek
Bu belgeyi
Web sitesi
olan daha
belgeyi uc

Българс

Предла

За ин в
Спазва
всички
Изхвъ
съотви
Нали
потре

За С
прог

Този

Ferritin

03737586 190
Calibrator F

01206659512072

Ferritin Ca

REF 03737586 190
For USA: Elecsys Ferritin CalSet



03737586 190
dialog.roche.i

English

Precautions and warnings

For in vitro diagnostic use.
Exercise the normal precautions required
Disposal of all waste material should be
Safety data sheet available for profess

For USA: Caution: Federal law restricts
of a physician.

This kit contains components classified
Regulation (EC) No. 1272/2008:

2-methyl-2H-isothiazol-3-one hydrochloride

EUH 208 May produce an allergen

Product safety labeling follows EU GHS

All human material should be considered
derived from human blood are prepared
tested individually and shown to be free from HBsAg and antibodies to HCV
and HIV. The testing methods used assays approved by the FDA or cleared in
compliance with the European Directive 98/79/EC, Annex II, List A.

However, as no testing method can rule out the potential risk of infection with
absolute certainty, the material should be handled with the same level of care
as a patient specimen. In the event of exposure, the directives of the
responsible health authorities should be followed.

Avoid foam formation in all reagents and sample types (e.g.,
and controls).

Method Sheet

бор калибраторов для количественного определения ферритина в сыворотке и
заме крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей
иммунохимических cobas e (Ferritin CalSet Elecsys and cobas e analyzers)



бор калибраторов для количественного определения ферритина в сыворотке и
взяте из крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей
иммунохимических cobas e (Ferritin CalSet Elecsys and cobas e analyzers)



Ferritin CalSet

For USA: **CONTENT**

- Cal1 Ferritin (human, liver) in a human serum matrix
Cal2 Ferritin (human, liver) in a human serum matrix

Rx only

03



REF 03737586190

LOT 38894904

2021-05-31

2020-01-28

GTIN 04015630920242



Набор калибраторов для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Ferritin CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.ru

Ferritin CalSet

Набор калибраторов для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Ferritin CalSet Elecsys and cobas e analyzers), в составе:
1. Калибратор 1 (FERR Cal1), флякон, объем 1,0 мл - 2 шт;
2. Калибратор 2 (FERR Cal2), флякон, объем 1,0 мл - 2 шт;
3. Карты со штрихкодами - 1 шт; 4. Лист со штрих-кодами - 1 шт.

5. Инструкция по применению

Регистрационное удостоверение №


Срок годности см. на упаковке. Гипература хранения см. на упаковке.

Номинальный срок годности см. на упаковке

Амплитека и ВЧЧ 1,2 и выше гепатита С и НВАЧ отсутствуют
Производитель: «Roche Diagnostics GmbH», Германия
Sandholzer Strasse 116, D-8830 Мангейм, Германия
Изготовление предназначено только для диагностики *in vitro*
Уполномоченный представитель, проходит обязательную регистрацию в Ростехнадзоре
Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Русь»
Диагностика Русь, 107031, Москва, Трубная площадь, д. 2 Тел.: +7 495 229-69-99
факс: +7 495 229-63-64 Е-mail: mail@roche-reception.ru
Кат. номер 03737586190


бор калибраторов для количественного определения ферритина в сыворотке и
заме крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей
иммунохимических cobas e (Ferritin CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

Калибратор 1 (FERR Cal1), флакон, объем 1,0 мл

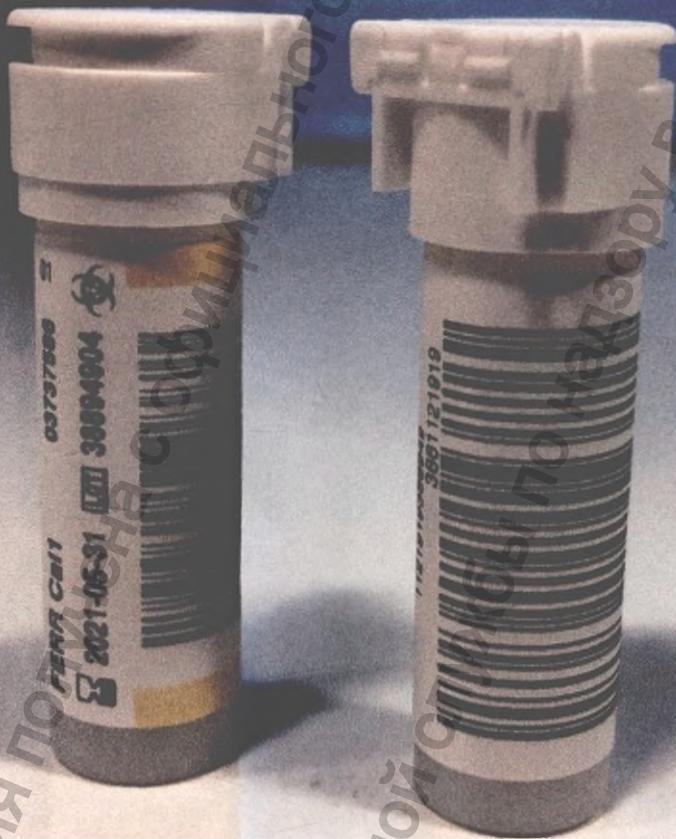

р калибраторов для количественного определения ферритина в сыворотке и
в мясе крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей
иммунохимических cobas e (Ferritin CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

Калибратор 2 (FERR Cal2), флакон, объем 1,0 мл

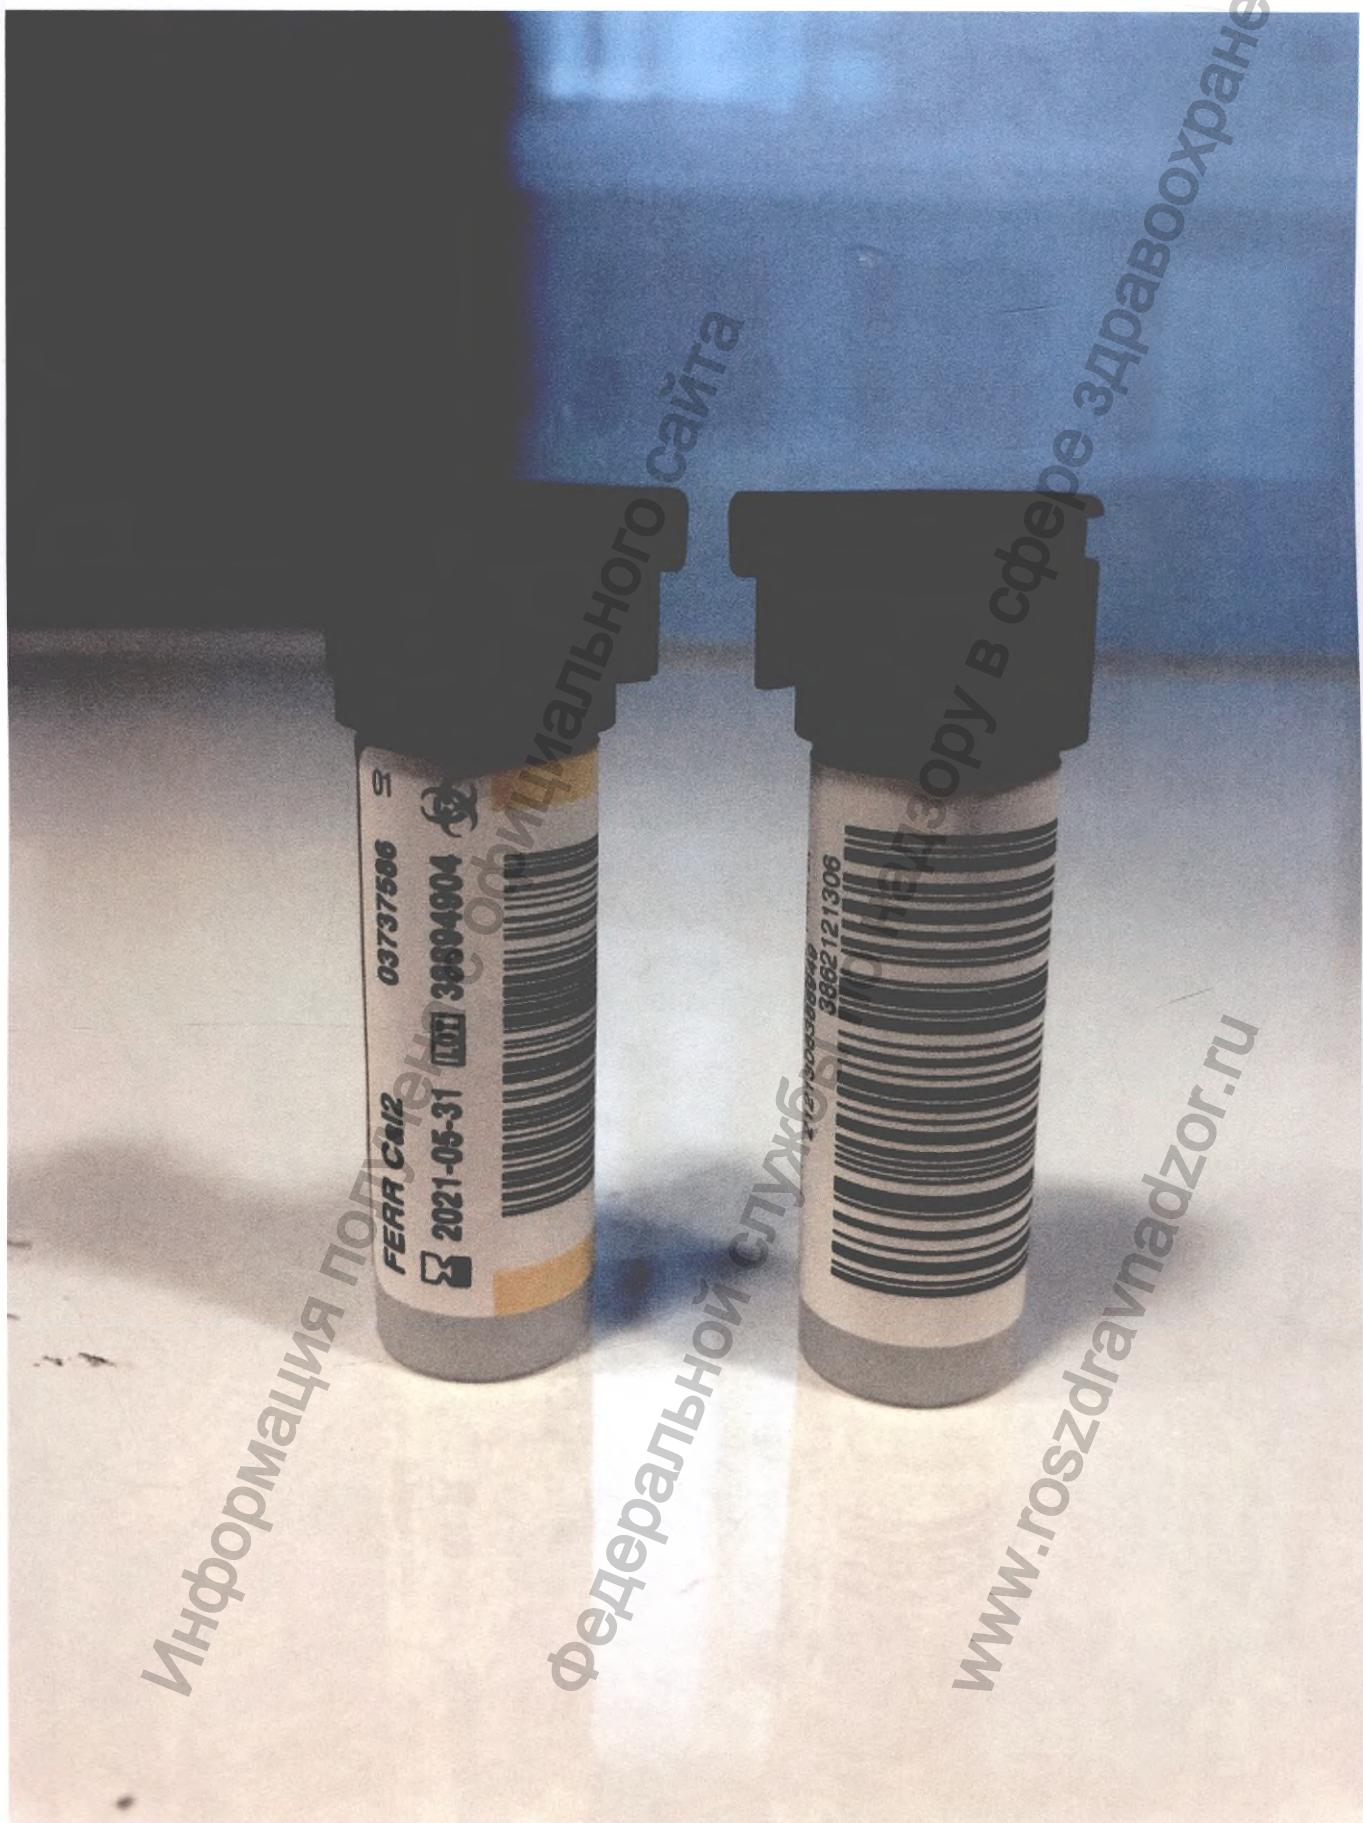

р калибраторов для количественного определения ферритина в сыворотке и
в мякоти крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей
иммунохимических cobas e (Ferritin CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

дата со штрих-кодом

FERR
CalSet
Elecsys
and cobas e analyzers
03737586 381
LOT 388949
Roche 01



калибраторов для количественного определения ферритина в сыворотке и
крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей
иммуохимических cobas e (Ferritin CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

ст со штрих-кодами

Ferritin CalSet

03737586 190

Calibrator Barcode

Roche/Hitachi Modular Analytics E170

LOT 368940

2021-05



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения


www.roszdravnadzor.ru

2018-12



калибраторов для количественного определения ферритина в сыворотке и
крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей
иммуохимических cobas e (Ferritin CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

Инструкция по применению

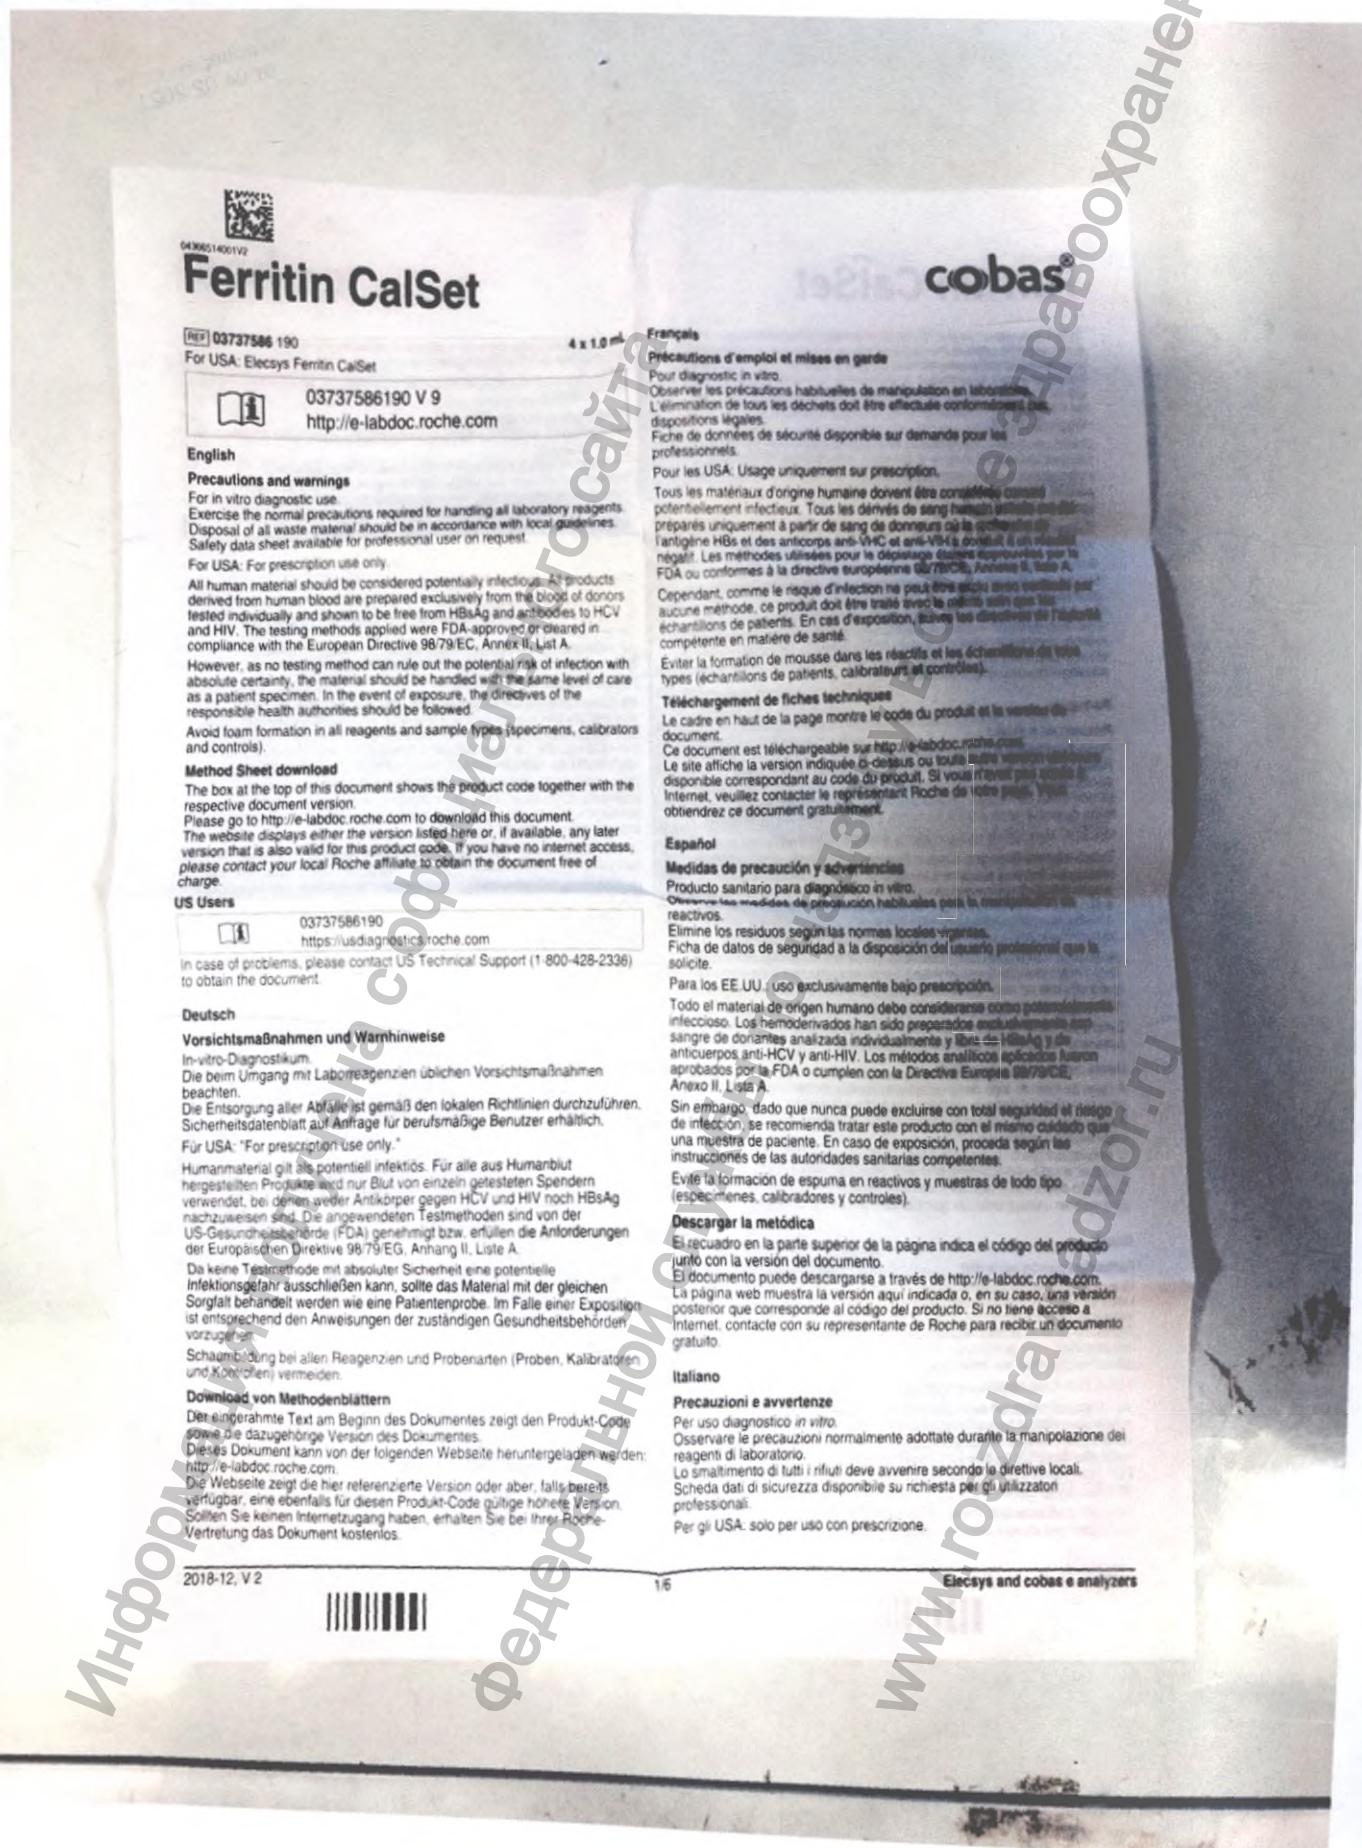

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.roszdravnadzor.ru

Информация получена с официального сайта



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru