

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «КАРЛ ШТОРЦ-
Эндоскопы ВОСТОК»



Мартин Колас

«07» февраля 2014 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

«Помпа эндоскопическая автоматическая «HYSTEROMAT E.A.S.I.» для применения в лапароскопии и гинекологии с принадлежностями»

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdraznadzor.ru

STOZ
S.A. - S.p.A. - INCASSO

hysteromat E.A.S.I.

263400 20

Финансирование от сайта

надзор


серебряный
ре-здрав

Видео


STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

Mittelstrasse 8
D-78532 Tuttlingen
Germany

Model : 263400 20-1
Voltage : 100-240 V~
Frequency : 50 / 60 Hz
Power : 0,7 A


Classification IEC:
Class I 
IPX1

   0123

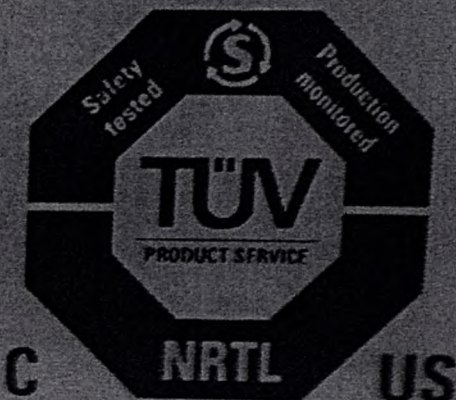


S/N NW00080

Protected
the follow
5,788,688
6,484,221



2 x T1,6AH250V

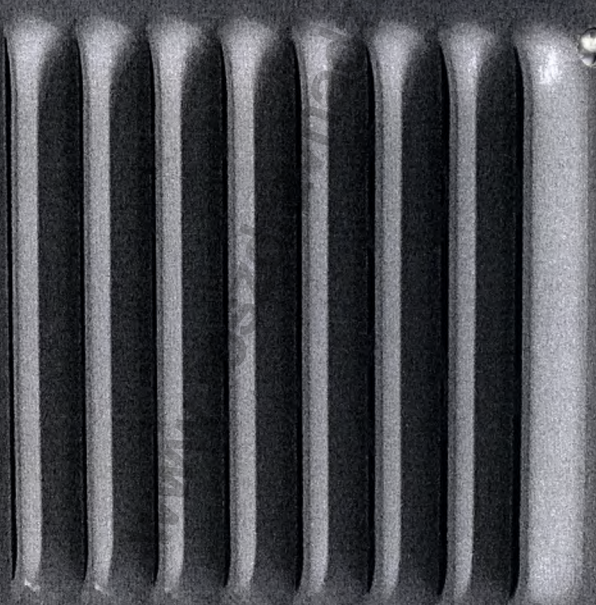

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdraznadzor.ru







KARL STORZ GmbH & Co. KG
Mittelstraße 8
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOP

LOT 101385212

QTY 1




REF 20090170

SCB-Verbindungskabel, 100 cm
SCB Connecting Cable, 100 cm
Câble de raccordement SCB, 100 cm
Cable de conexión SCB, 100 cm
Cavo di connessione SCB, 100 cm
Cabo de conexão SCB, 100 cm



010404855 1009872240 20090170 10101385212

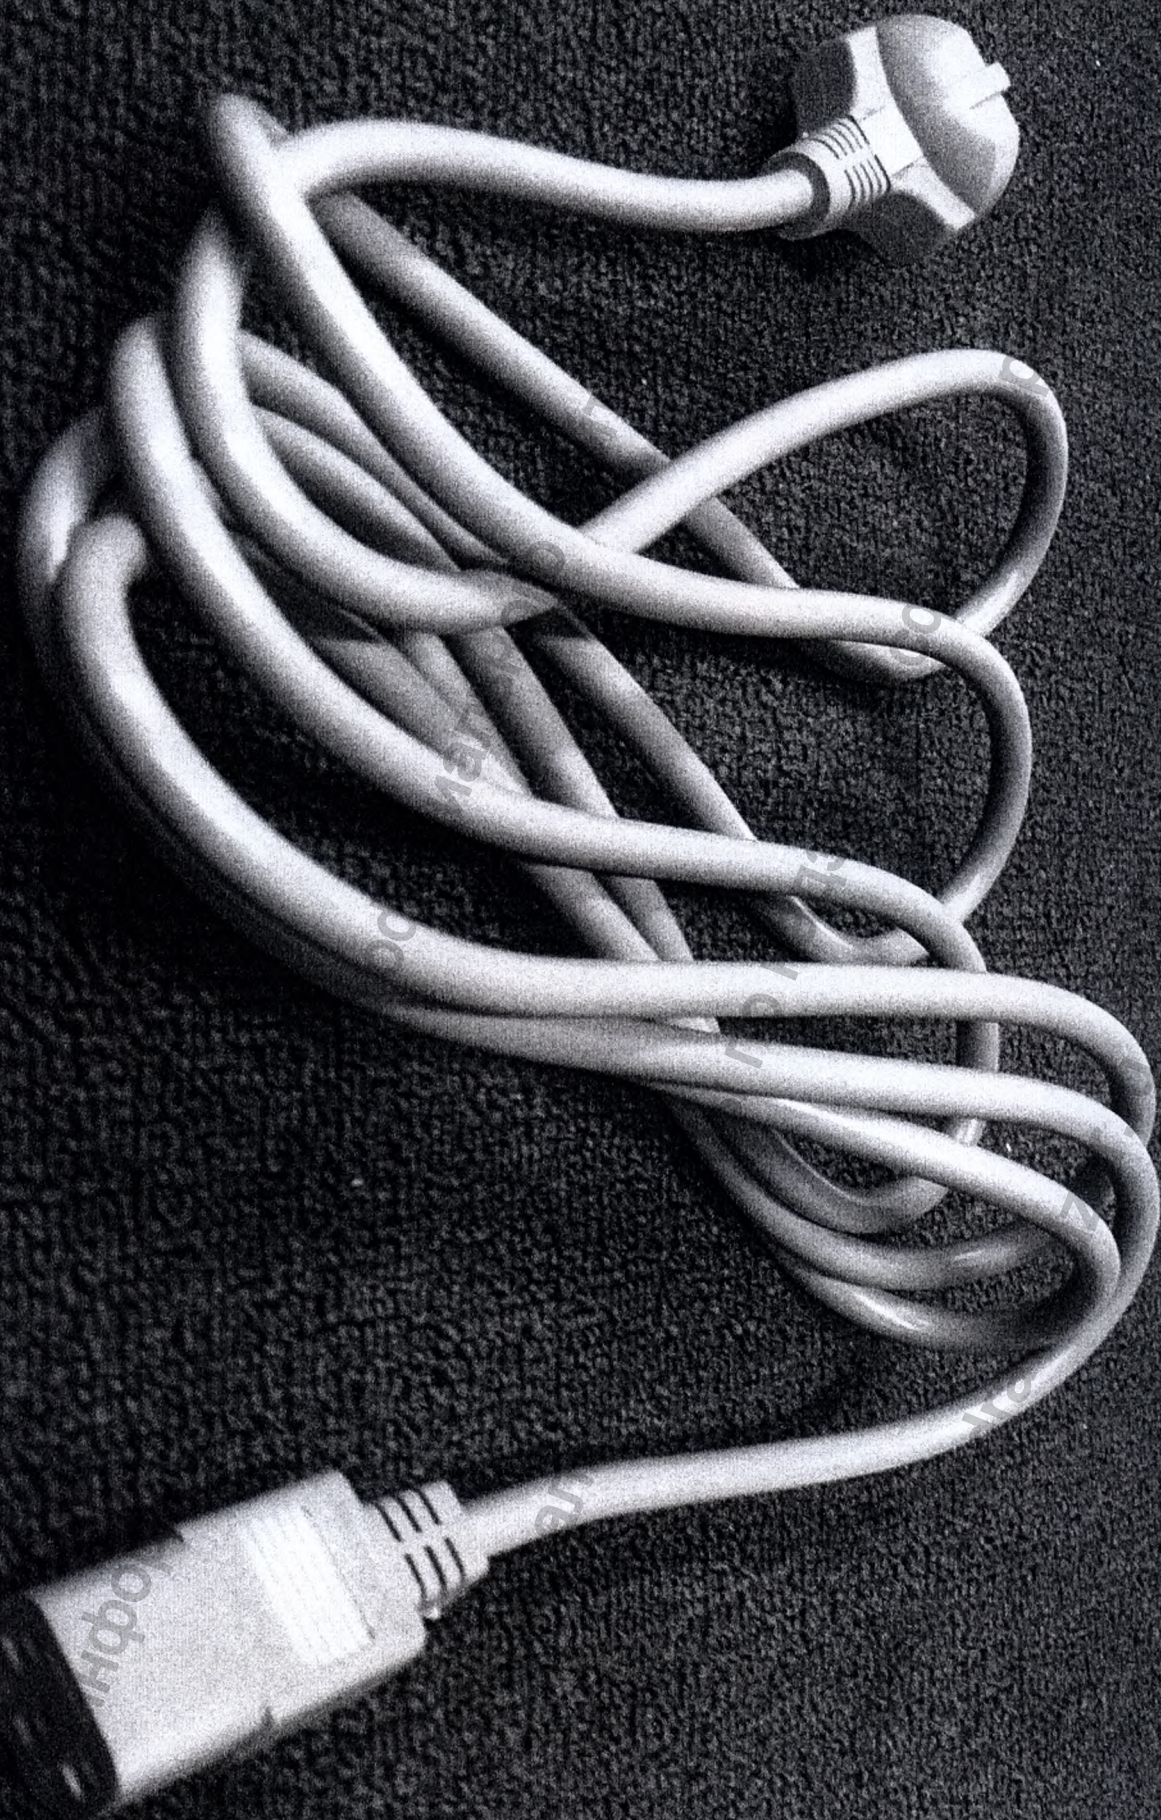



KARL STORZ GmbH & Co. KG
Mittelstraße 8
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPPE

REF 400A


Netzkabel, Länge 300 cm
Mains cord, length 300 cm
Cordon secteur
Cavo di rete, lunghezza 300 cm
Cable de conexión a la red
cabo da tensao principal

LOT NW

QTY 1



(01) 04048551 58555(240)400A(TO)NW

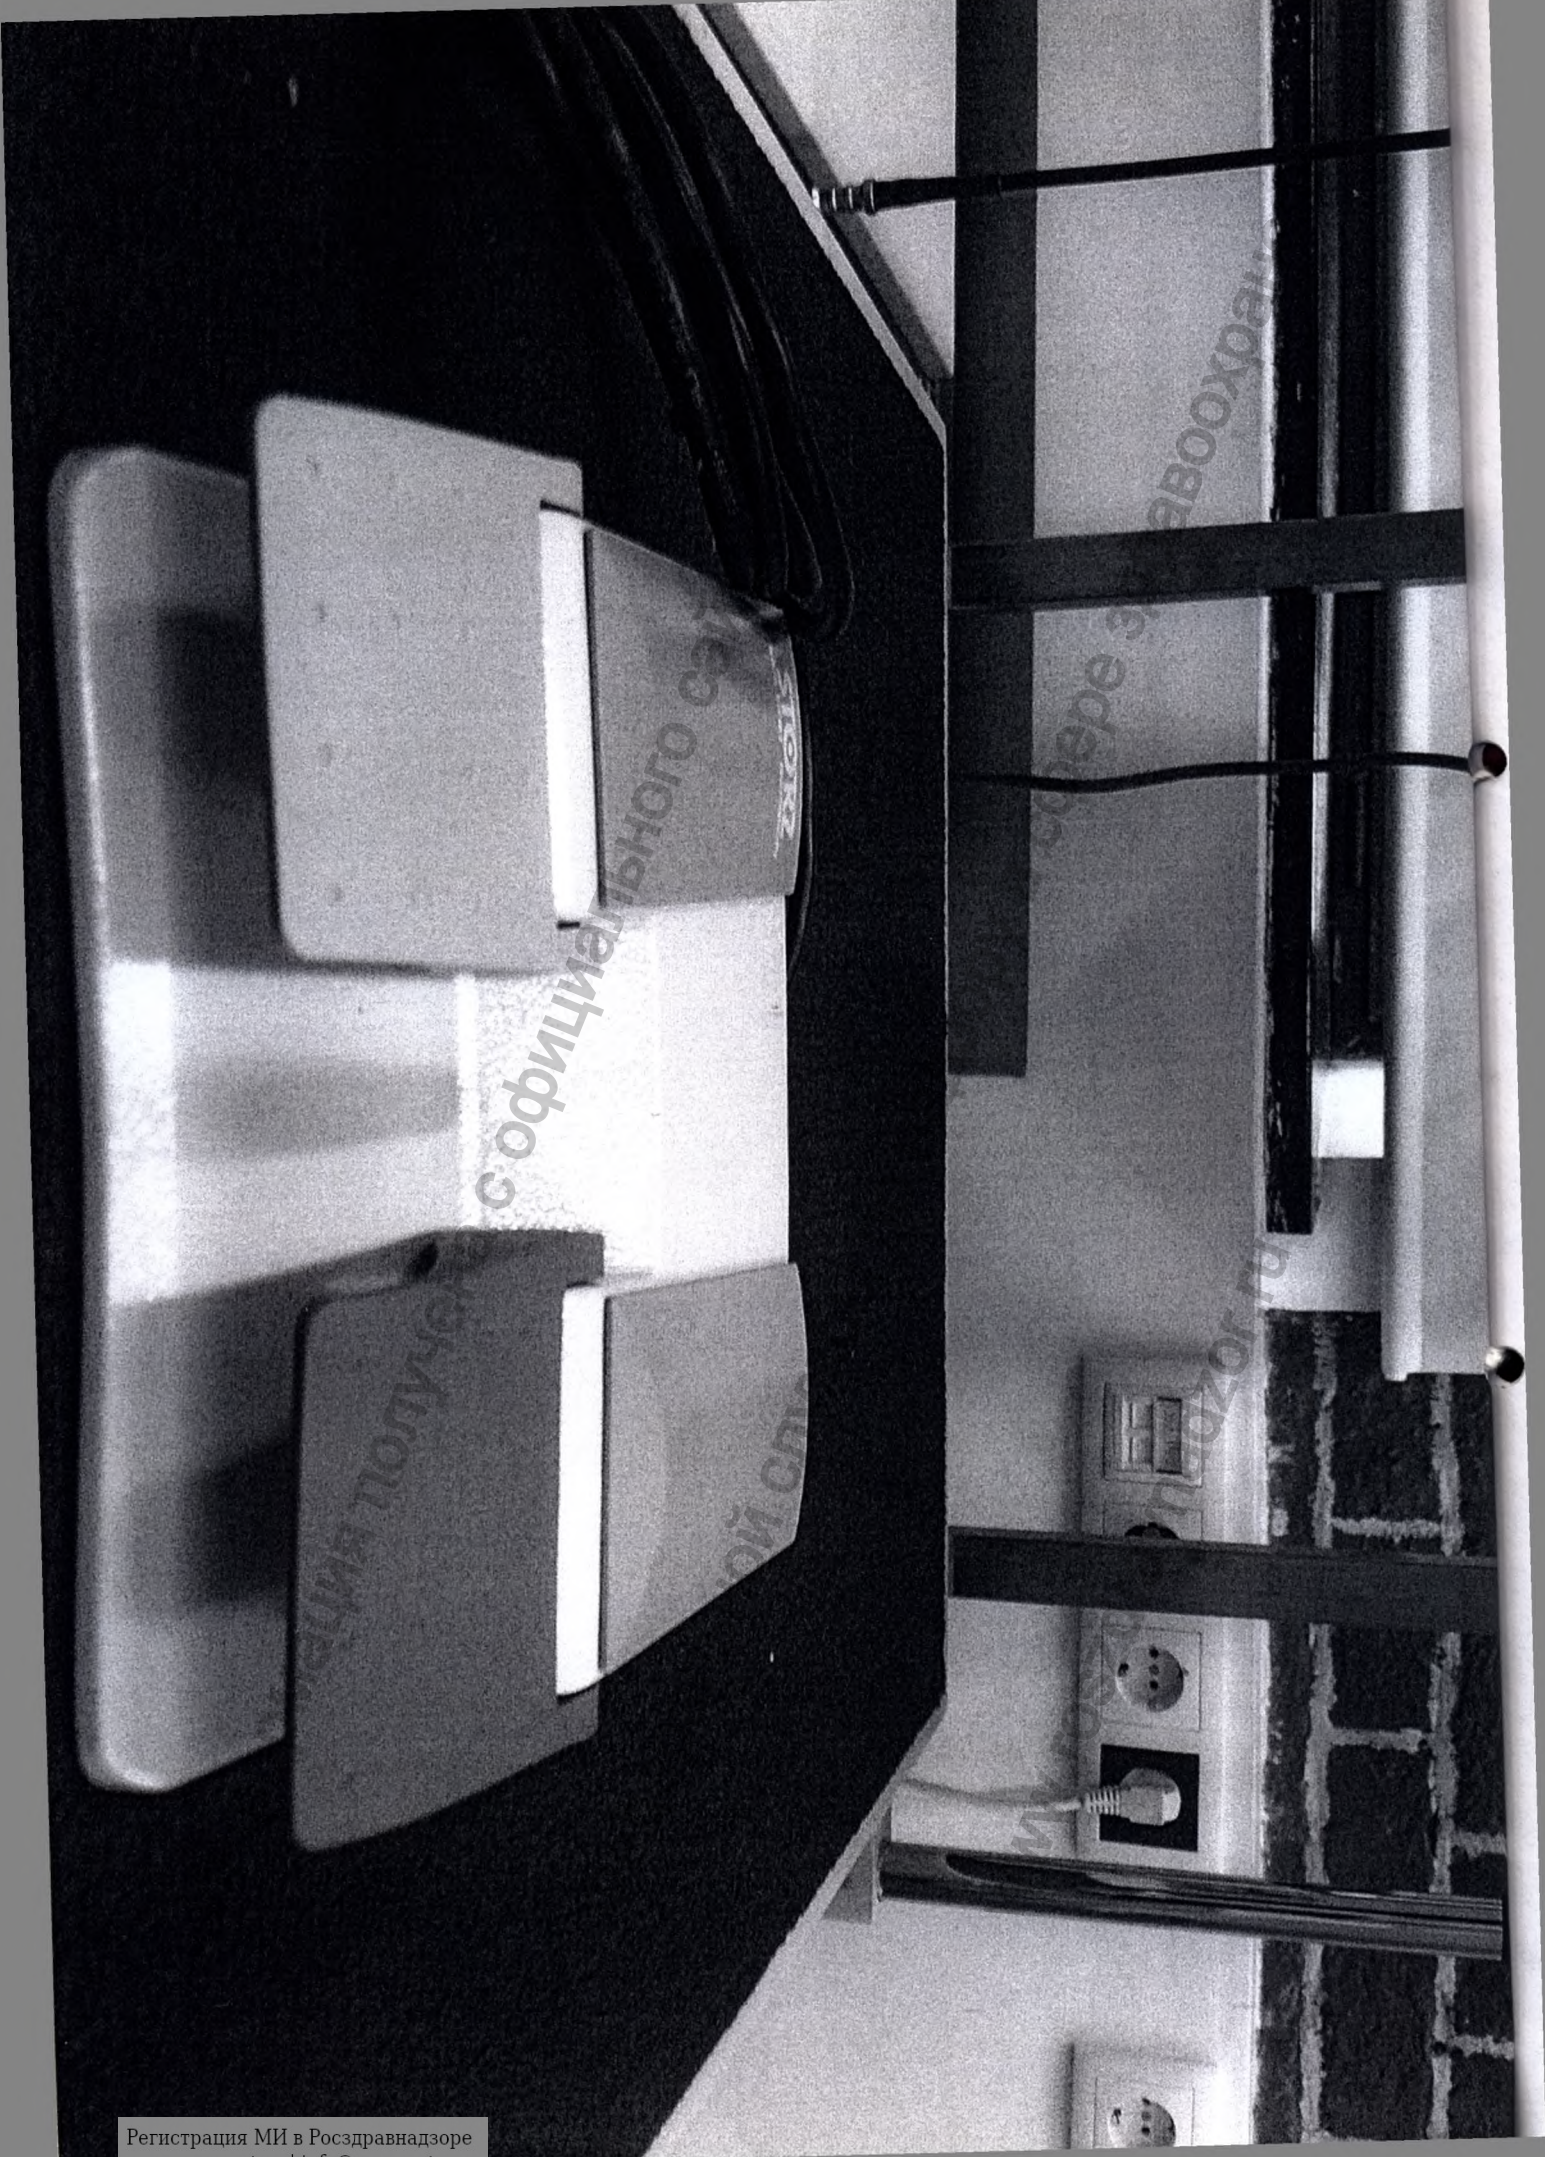

STORZ

KARL STORZ — ENDOSKOPE

Mittelstrasse 8
D-78532 Tuttlingen
Germany

Model :26340330

Voltage

Classification IEC:
IPX 8

Frequency

Power



0123

SN NW1010

11/одинадцать)



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.gosdrazhnadzor.ru