

ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Медтроник»
Плясунова Е.В.



2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

«Электрокардиостимуляторы с сердечной ресинхронизирующей терапией Percerta,
Solara, Serena»
производства: «Медтроник Инк» (Medtronic Inc.), США



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdravnadzor.ru

2021




Рисунок 1. Электрокардиостимулятор с сердечной ресинхронизирующей терапией Percepta CRT-P MRI SureScan, модель WITR04, в составе: Электрокардиостимулятор имплантируемый, Тарированный ключ, Документация по продукции



Medtronic

Bluetooth

**Percepta™ CRT-P
MRI SureScan™**

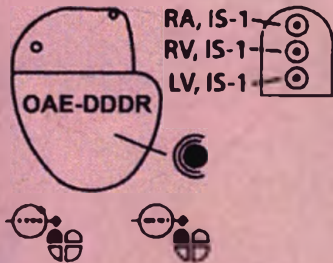

Model W1TR04

SN RNU603615S

2020-12-28
YYYY-MM-DD

2019-07-12
YYYY-MM-DD

REF W1TR04

DDD

↑ 130 min⁻¹
↓ 50 min⁻¹

0.3 mV

0.9 mV

→ 130 ms
→ 100 ms

↓ 3.5 V
→ 0.4 ms

↓ 3.5 V
→ 0.4 ms

↓ 3.5 V
→ 0.4 ms

LVtlp - Can

LV->RV
0 ms

AUTO

Adaptive

AUTO


OFF

60 min⁻¹

AUTO

FCC ID: LFSBLEIMPLANT2
IC: 3408D-BLEIMPLANT2

STERILE EO



55 °C
131 °F
-18 °C
0 °F



www.medtronic.com/manuals

Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432 USA
Medtronic B.V., Earl Bakkenstraat 10, 6422 PJ Heerlen, The Netherlands
Manufactured in Tolochenaz, Switzerland
www.medtronic.com

CE 0123

M876921A001 B - M874569A001 A

Рисунок 2. Маркировка стерильной упаковки Электрокардиостимулятора с сердечной ресинхронизирующей терапией Percepta CRT-P MRI SureScan, модель W1TR04



Рисунок 3. Стерильная упаковка Электрокардиостимулятора с сердечной ресинхронизирующей терапией Percepta CRT-P MRI SureScan, модель W1TR04

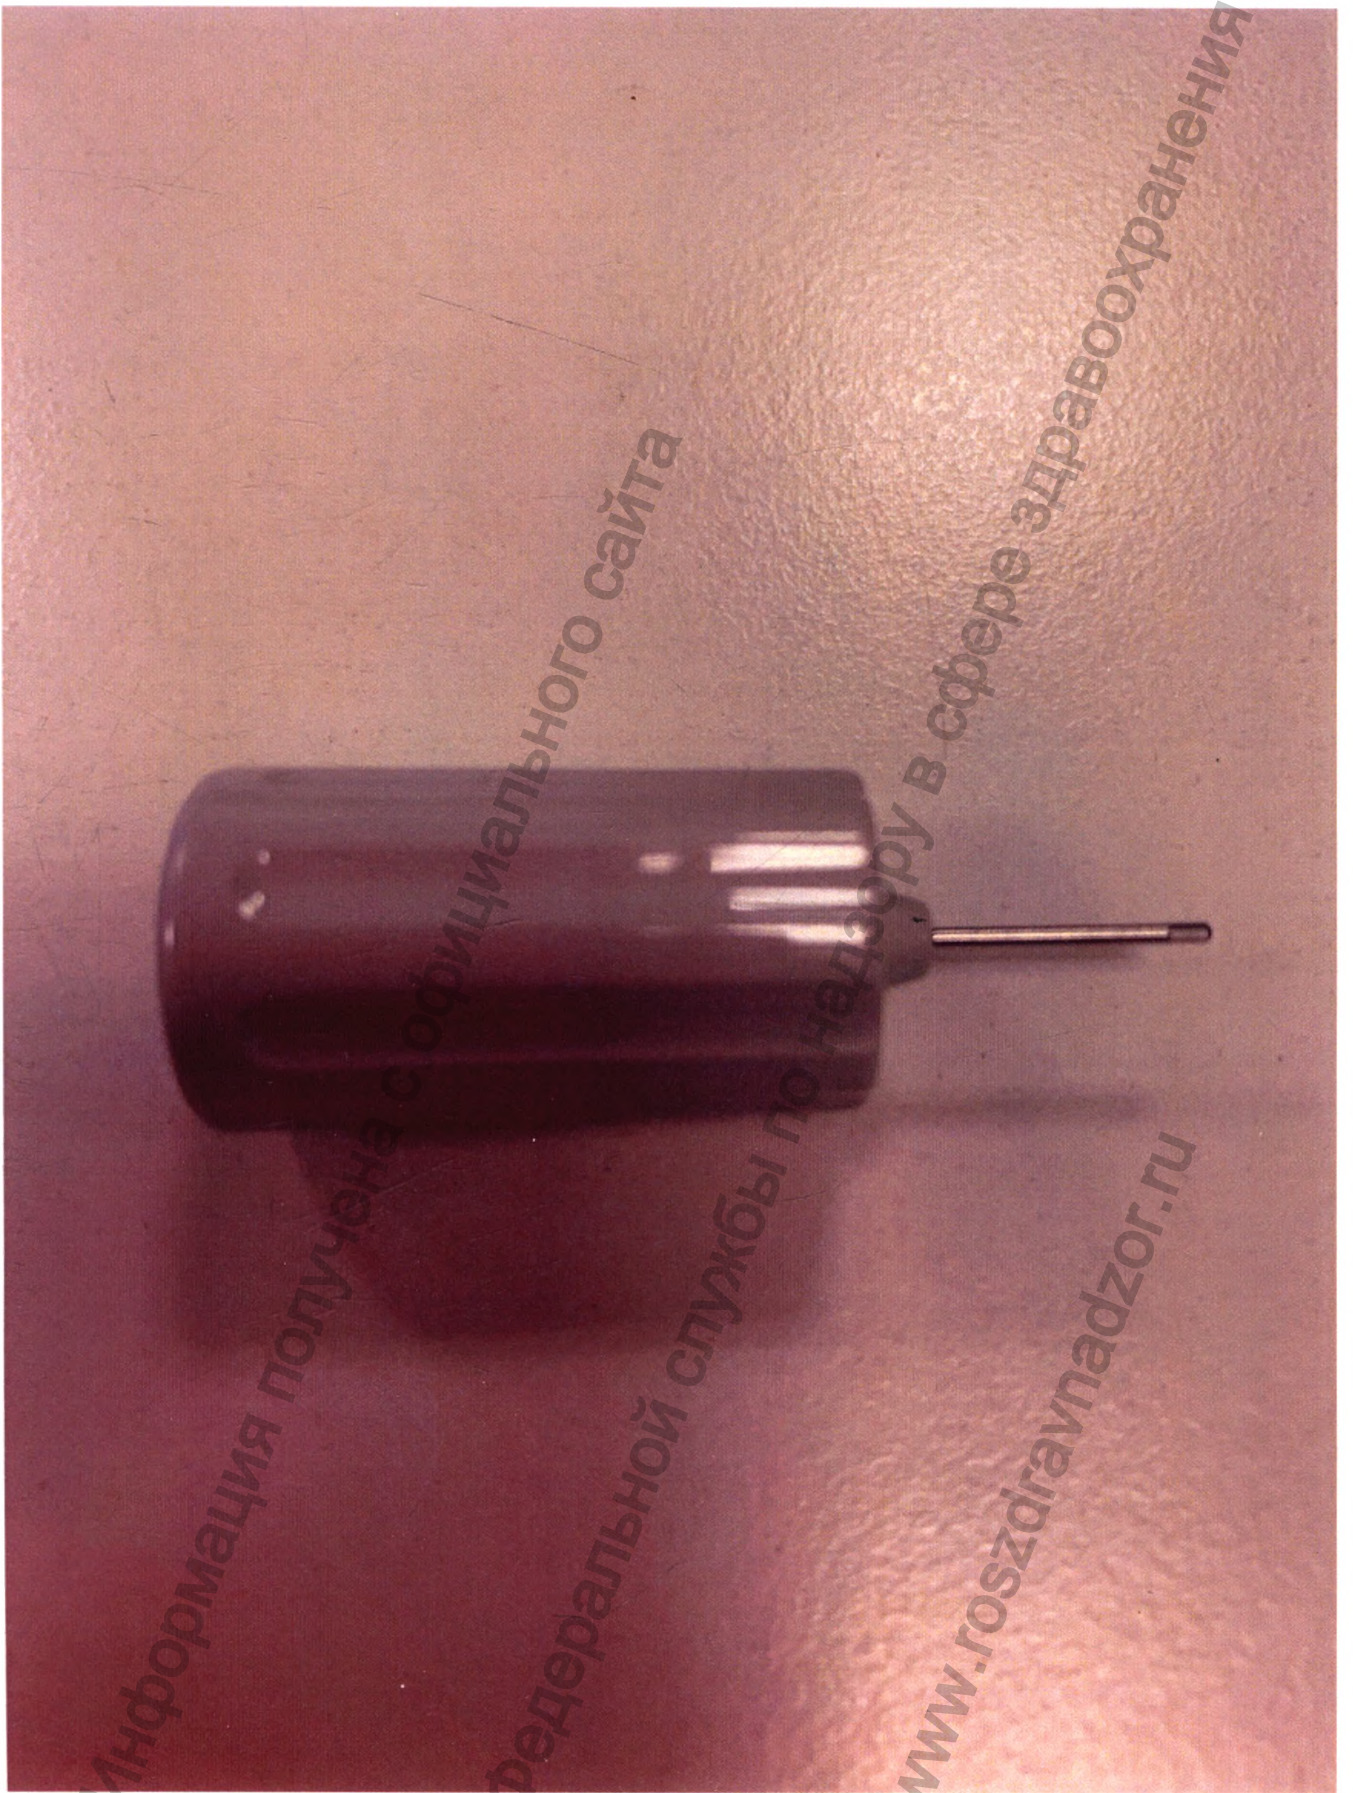


Рисунок 4. Тарированный ключ

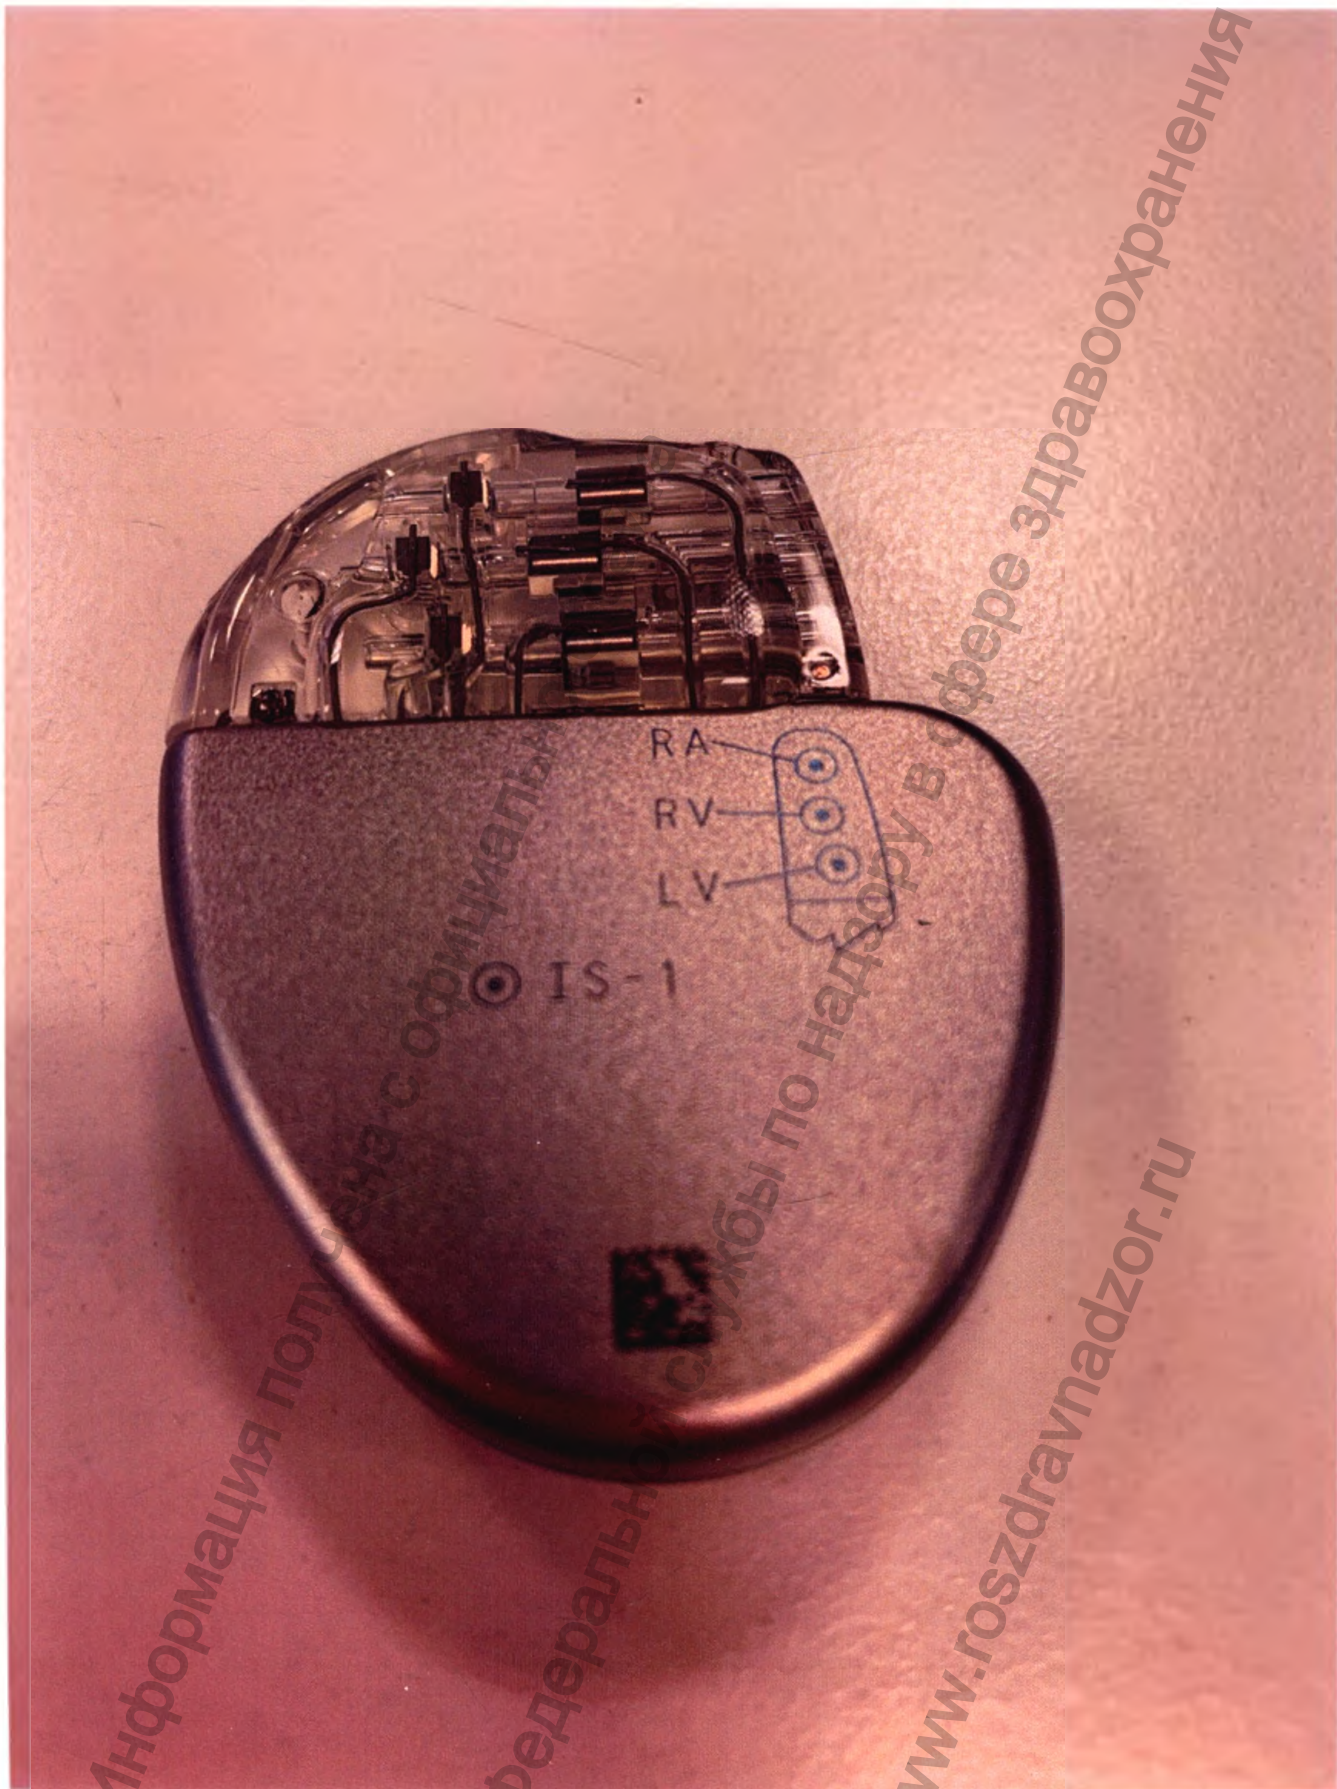


Рисунок 5. Электрокардиостимулятор имплантируемый (вид сзади)



Рисунок 6. Электрокардиостимулятор имплантируемый (вид спереди)

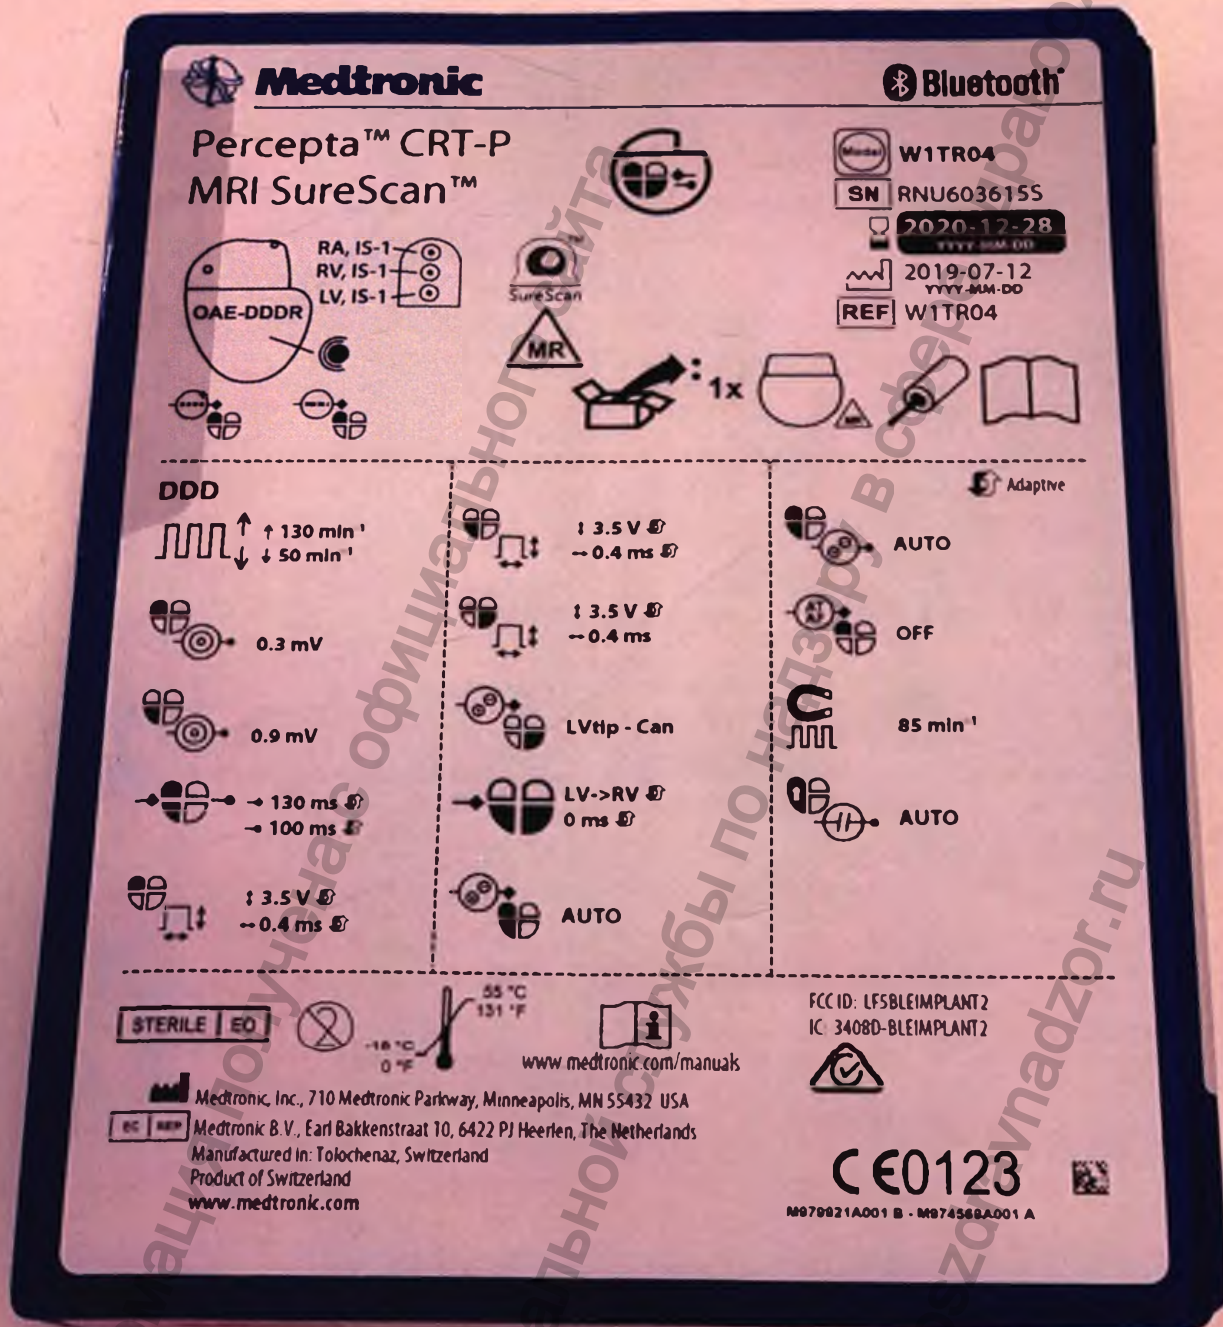


Рисунок 7. Потребительская упаковка Электрокардиостимулятора с сердечной ресинхронизирующей терапией Percepta CRT-P MRI SureScan, модель W1TR04



Рисунок 8. Электрокардиостимулятор с сердечной ресинхронизирующей терапией Serena Quad CRT-P MRI SureScan, модель W4TR05, в составе: Электрокардиостимулятор имплантируемый, Тарированный ключ, Документация по продукции



Рисунок 9. Тарированный ключ



Рисунок 10. Электрокардиостимулятор имплантируемый (вид спереди)



Рисунок 11. Электрокардиостимулятор имплантируемый (вид сзади)



Рисунок 12. Стерильная упаковка Электрокардиостимулятора с сердечной ресинхронизирующей терапией Serena Quad CRT-P MRI SureScan, модель W4TR05

Medtronic **Bluetooth**

Serena™ Quad CRT-P
MRI SureScan™

(Model) **W4TR05**
SN **RNX607455S**
2021-01-14
YYYY-MM-DD
2019-07-25
YYYY-MM-DD
REF **W4TR05**

RA, IS-1
RV, IS-1
LV, IS4 - LLLL
OAE-DDDR

DDD

 ↑ 130 min ⁻¹ ↓ 50 min ⁻¹	 ↓ 3.5 V ↔ 0.4 ms	Adaptive
 0.3 mV	 ↓ 3.5 V ↔ 0.4 ms	AUTO
 0.9 mV	LV1 - LV2	85 min ⁻¹
 → 130 ms → 100 ms	LV → RV 0 ms	AUTO
 ↓ 3.5 V ↔ 0.4 ms	AUTO	

FCC ID: LFSBLEIMPLANT2
IC: 3408D-BLEIMPLANT2

STERILE EO

-18 °C
0 °F

55 °C
131 °F

www.medtronic.com/manuals

Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432 USA
Medtronic B.V., Earl Bakkenstraat 10, 6422 PJ Heerlen, The Netherlands
Manufactured in: Tolochenaz, Switzerland
www.medtronic.com

CE0123

M079921A001 B - M074573A001 A

Рисунок 13. Маркировка Стерильной упаковки Электрoкардиостимулятора с сердечной ресинхронизирующей терапией Serena Quad CRT-P MRI SureScan, модель W4TR05

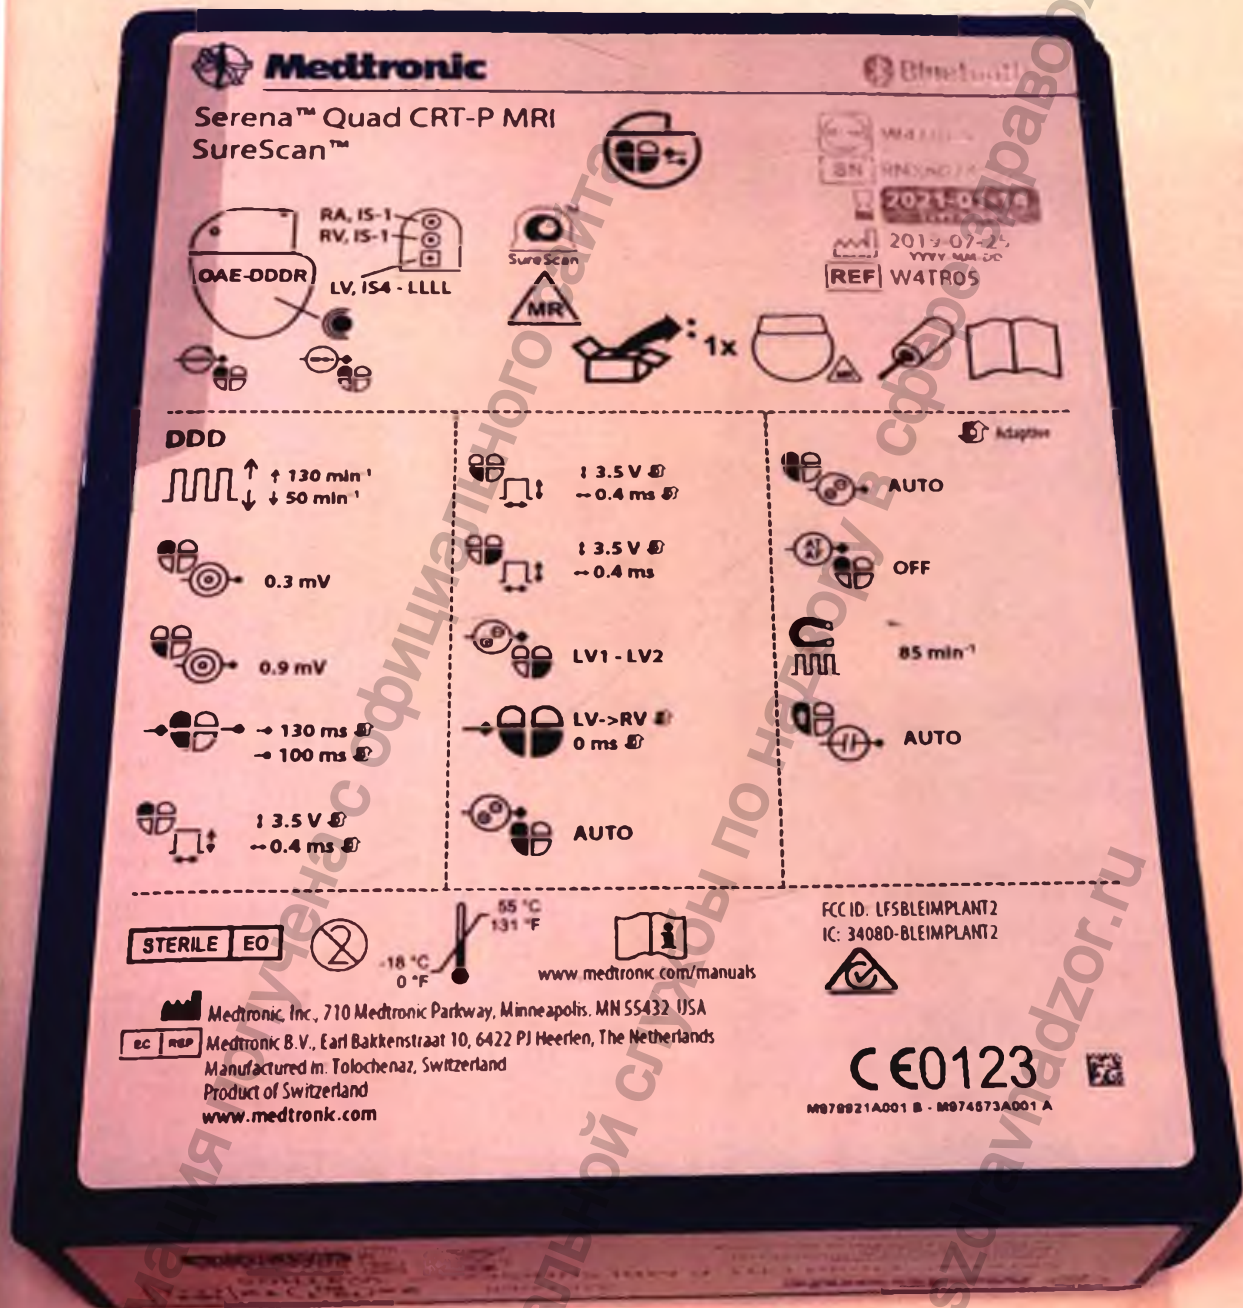


Рисунок 14. Потребительская упаковка Электрокардиостимулятора с сердечной ресинхронизирующей терапией Serena Quad CRT-P MRI SureScan, модель W4TR05



Рисунок 15. Электрокардиостимулятор с сердечной ресинхронизирующей терапией Solara Quad CRT-P MRI SureScan, модель W4TR06, в составе: Электрокардиостимулятор имплантируемый, Тарированный ключ, Документация по продукции



Рисунок 16. Стерильная упаковка Электрокардиостимулятора с сердечной ресинхронизирующей терапией Solara Quad CRT-P MRI SureScan, модель W4TR06

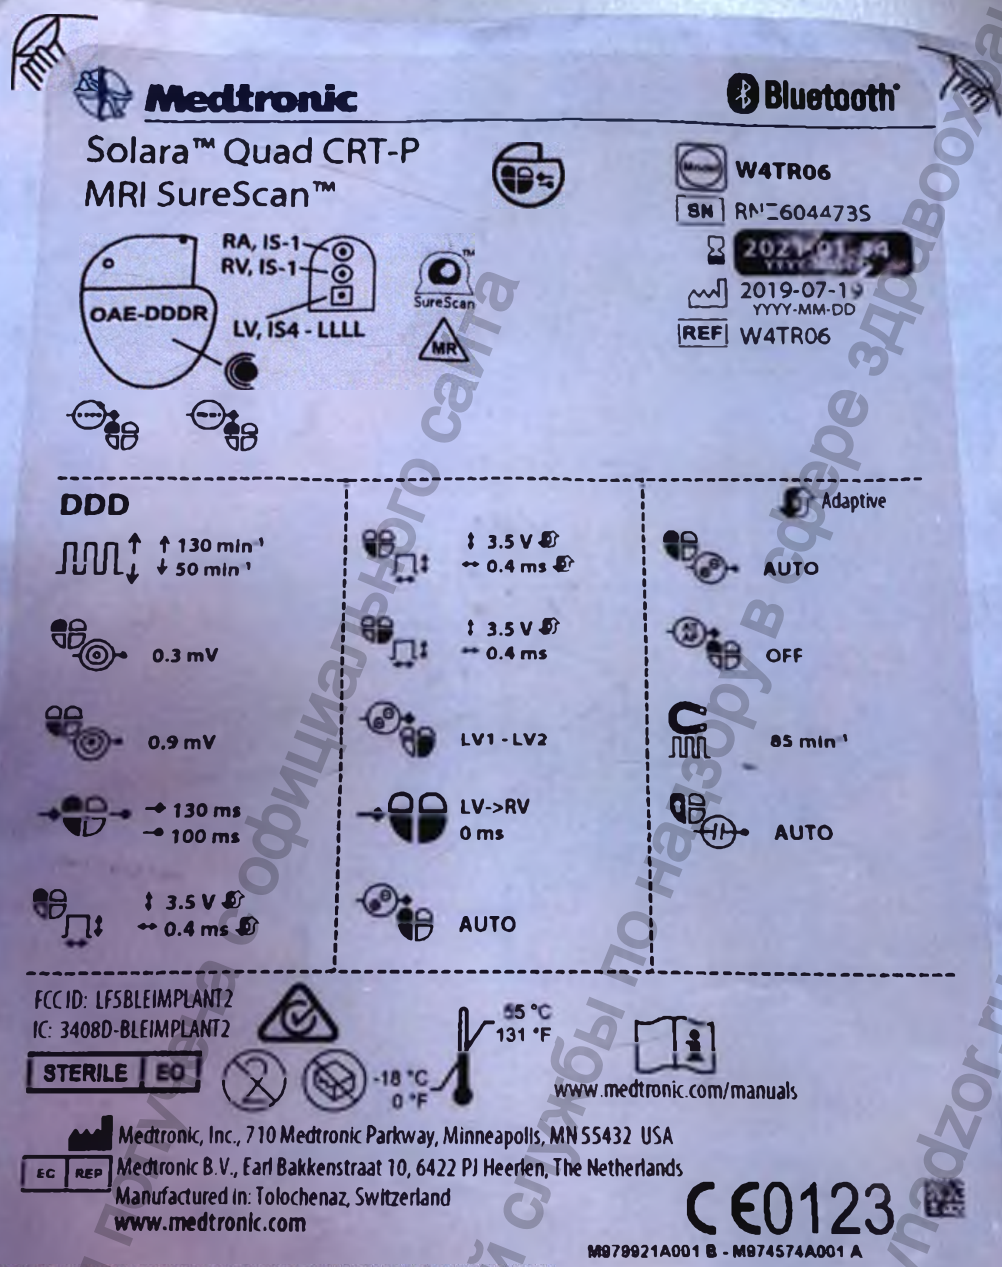


Рисунок 17. Маркировка стерильной упаковки Электродкардиостимулятора с сердечной ресинхронизирующей терапией Solara Quad CRT-P MRI SureScan, модель W4TR06



Рисунок 18. Гарированный ключ



Рисунок 19. Электрокардиостимулятор имплантируемый (вид сзади)



Рисунок 20. Электрокардиостимулятор имплантируемый (вид спереди)

Medtronic

Bluetooth

Solara™ Quad CRT-P MRI
SureScan™


Model **W4TR06**

SN **RNZ604473S**

2021-01-14
YYYY-MM-DD



2019-07-19
YYYY-MM-DD

REF **W4TR06**

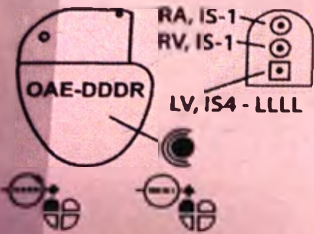


1x


DDD




0.3 mV




0.9 mV




→ 130 ms
→ 100 ms



↓ 3.5 V ⚡
→ 0.4 ms ⚡



↓ 3.5 V ⚡
→ 0.4 ms ⚡



↓ 3.5 V ⚡
→ 0.4 ms ⚡



LV1 - LV2



LV->RV
0 ms



AUTO


Adaptive



AUTO



OFF



85 min⁻¹



AUTO

STERILE EO



55 °C
131 °F
-18 °C
0 °F



www.medtronic.com/manuals

FCC ID: LFSBLEIMPLANT2
IC: 2400-BLEIMPLANT2


Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432 USA
EC REP Medtronic B.V., Earl Bakkenstraat 10, 6422 PJ Heerlen, The Netherlands
Manufactured In: Tolochenaz, Switzerland
Product of Switzerland
www.medtronic.com

CE 0323

W4TR06 1.001 Rev. 1716 1/11

Рисунок 21. Потребительская упаковка Электрокардиостимулятора с сердечной ресинхронизирующей терапией Solara Quad CRT-P MRI SureScan, модель W4TR06

Пример локального стикера

	Название медицинского изделия, модель	
	Производитель:	Код UPN
	Страна происхождения:	Код CFN
	Представитель производителя в Российской Федерации:	
	Регистрационное удостоверение № _____ дата _____	
	Дата производства / серия / срок годности: см. на упаковке	См. инструкцию См. символы на упаковке

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdramnadzor.ru

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.g0zdravnadzor.ru



Всего пронумеровано,
пронумеровано и скреплено
82 листа(ов)

