



«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «Био-Рад/Лаборатории»


Шестаков А.Я.  
«29» ноября 2021 г.

### Фотографические изображения

Прибор для считывания результатов тестов для определения  
инфекционных заболеваний в клинических образцах «Genius Reader» с  
принадлежностями производства "Био-Рад"/Bio-Rad, Франция

Прибор для считывания результатов тестов для определения инфекционных заболеваний в клинических образцах «Geenius Reader» с принадлежностями (общий вид)

Прибор «Geenius Reader»

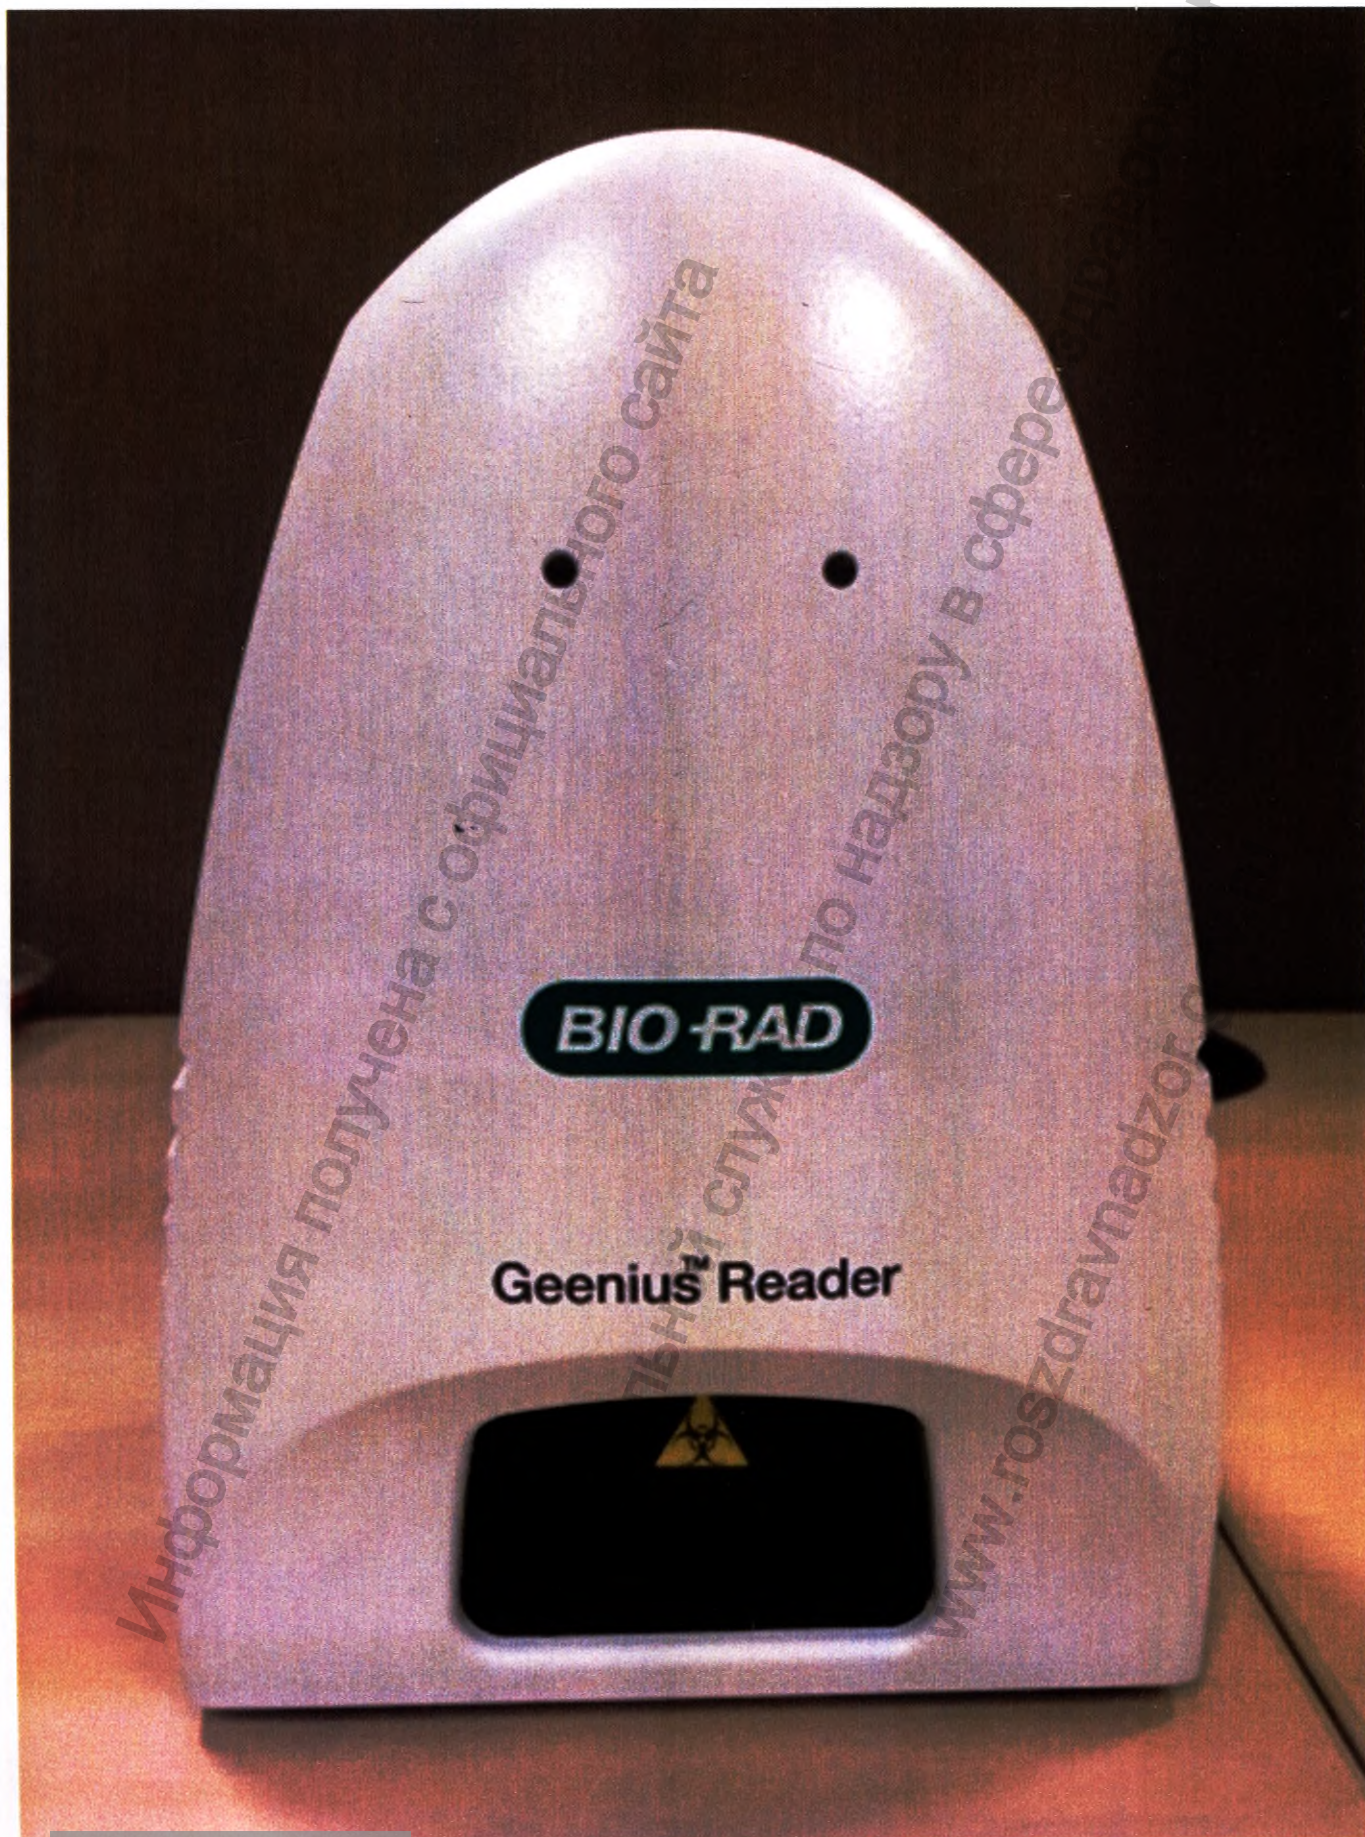

Программное обеспечение (Geenius Software) на USB носителе / USB Flash Drive  
with Geenius Software (при необходимости)

at #:   
P92461  
Geenius IHM(+APF+Manuel) OUS

lot #:   
TV1215122

at # + Lot #  
  
P92461!TV1215122


### Geenius™ Software

**REF** 92461  
**LOT** V1.2-1512-2  
2015/12




(01)03610520013885  
(17)151202  
(10)V1215122

**BIO-RAD**

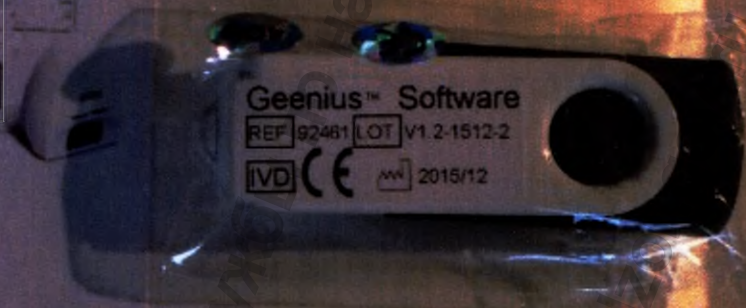

### Geenius™ Software


**REF** 92461 **LOT** V1.2-1512-2  
2015/12



USB — кабель



Комплект для технического обслуживания / Maintenance kit, в составе:  
- аппликатор;  
- рамка

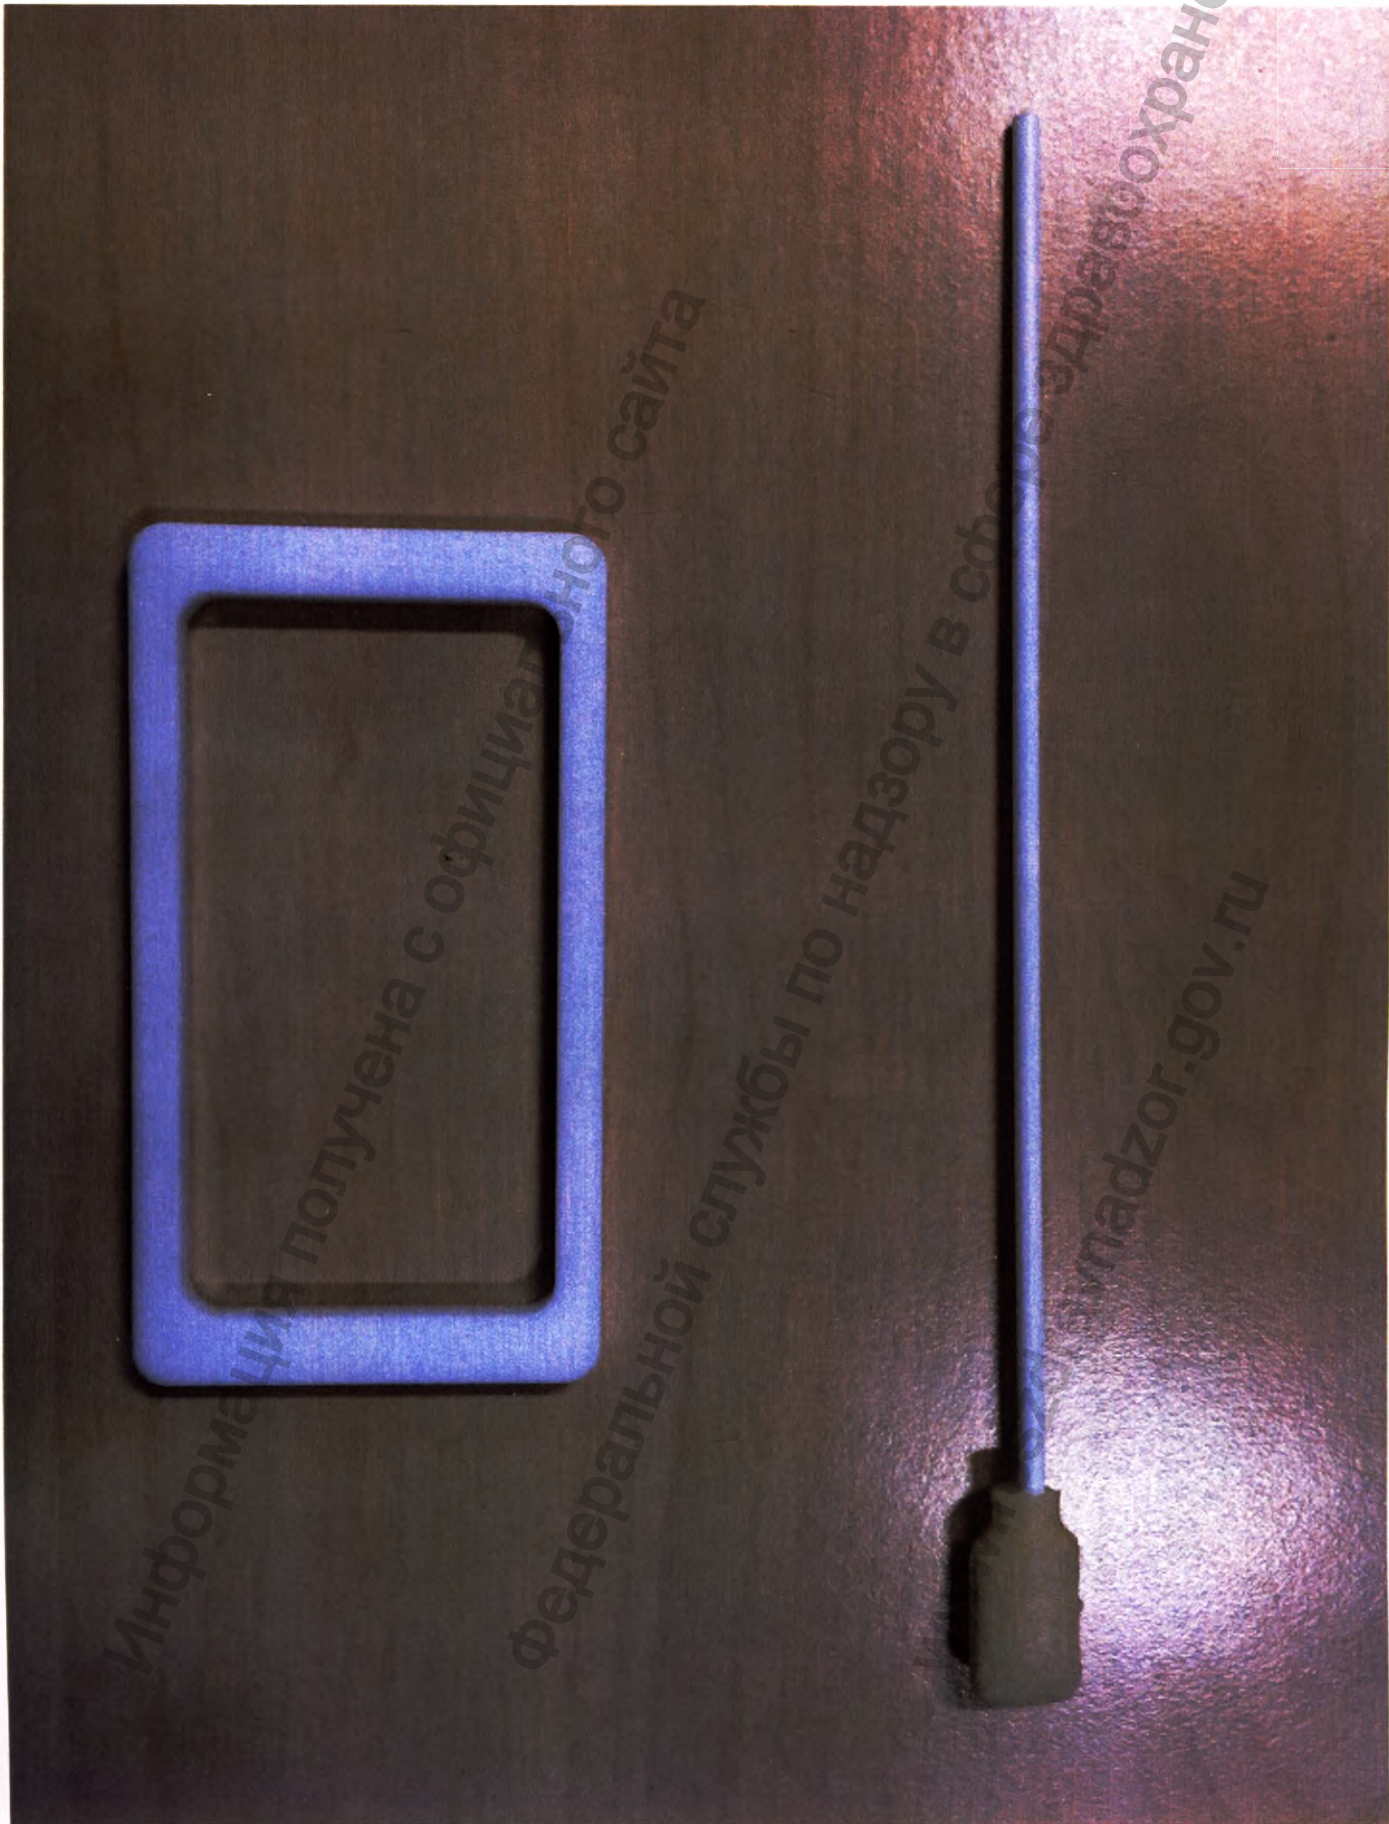


Компьютер (при необходимости)



Информация получена с официального сайта  
Федерального государственного учреждения  
«Росздравнадзор» в сфере здравоохранения  
www.goszdr.ru

Апликатор / Foam swabs 5шт.

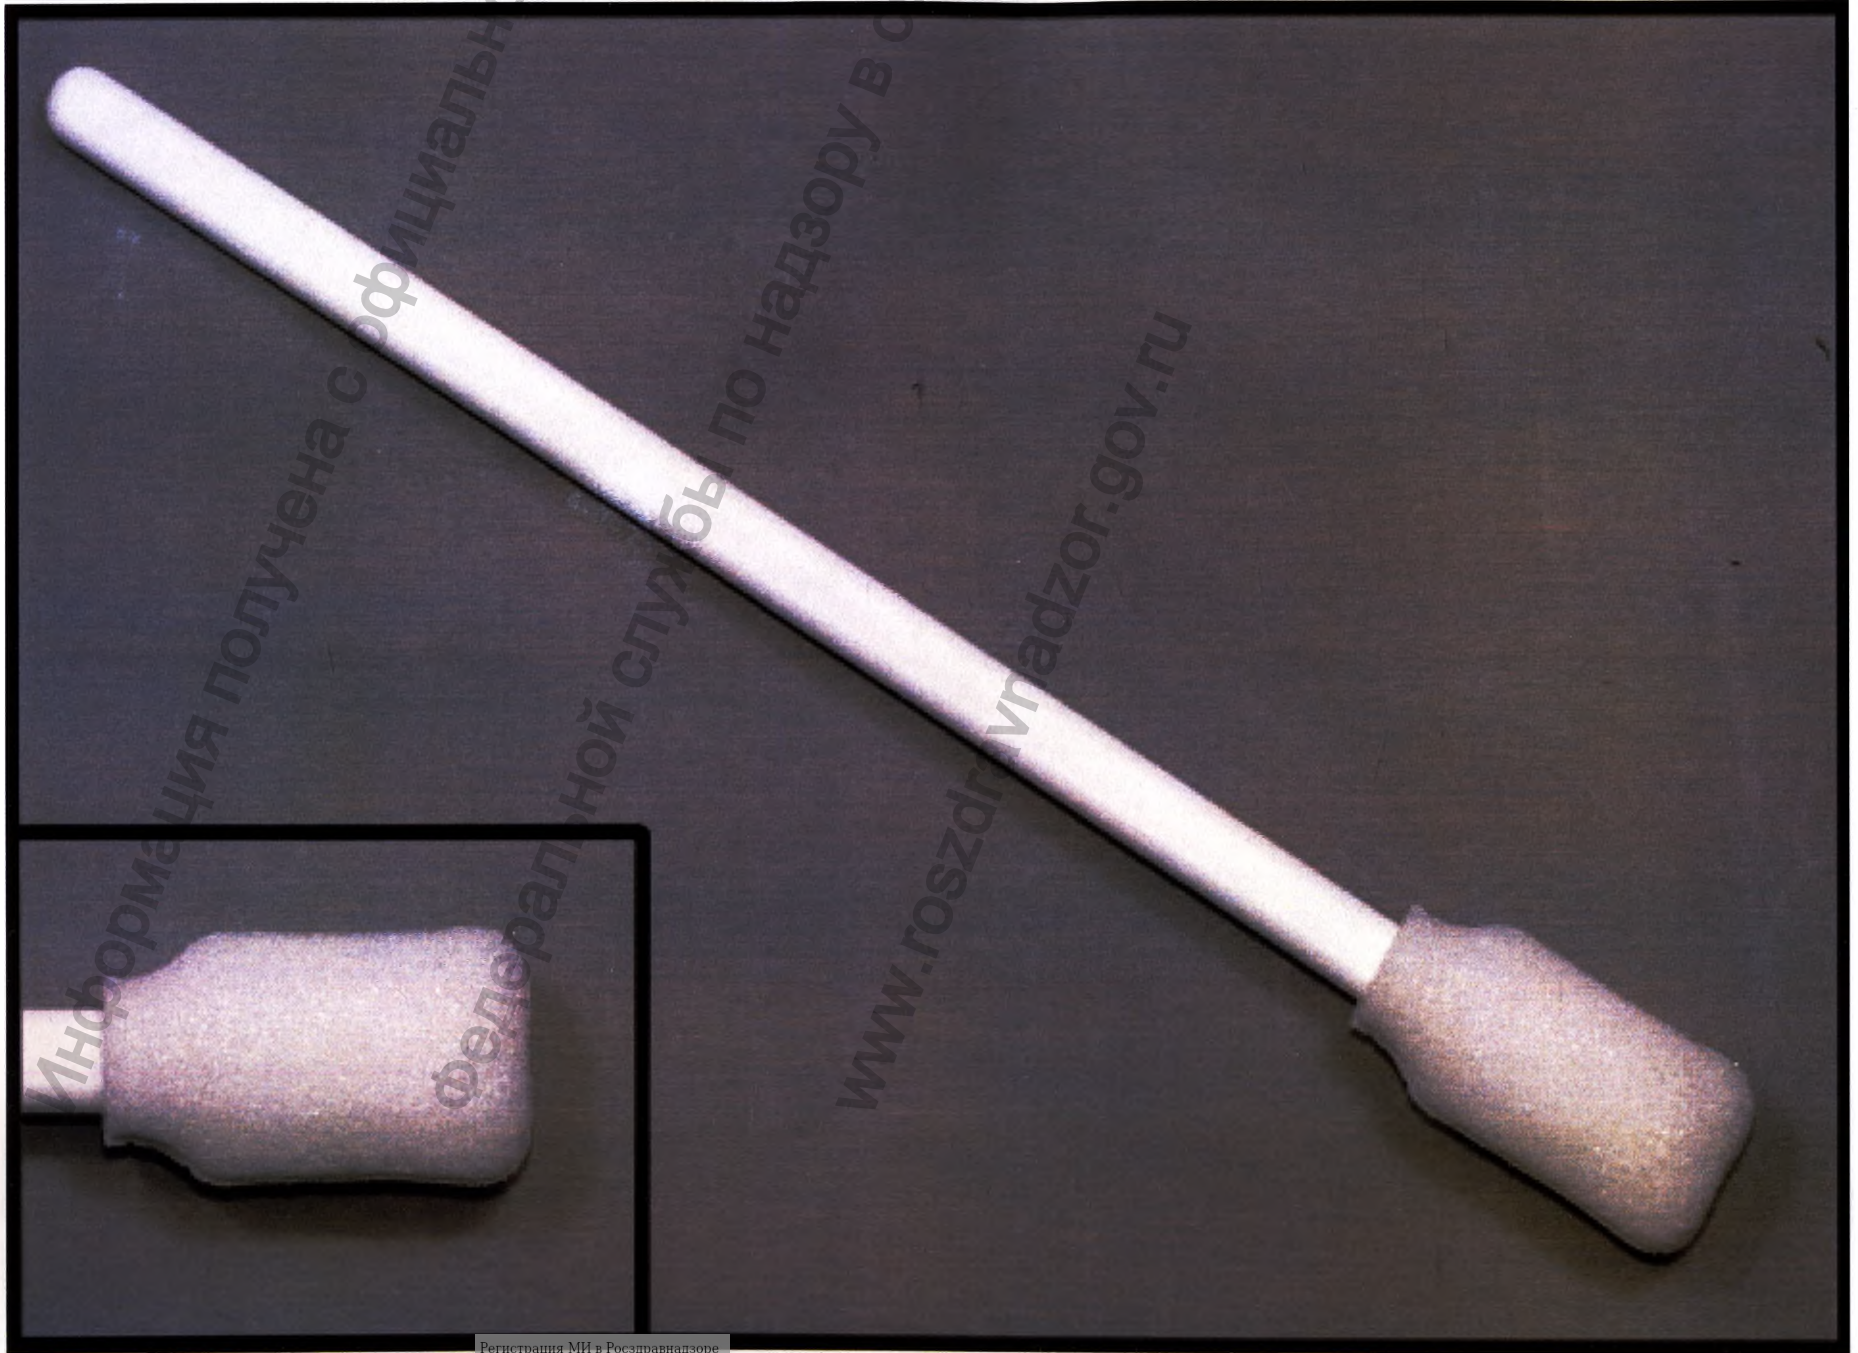

Кабель антикражный / Anti-theft System





Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

[www.gosdravnadzor.gov.ru](http://www.gosdravnadzor.gov.ru)

ено Прошито, пронумеровано и скреп  
печатью 2 листов.  
Генеральный директор  
ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Щестаков Е.А.

