

Общество с ограниченной ответственностью "Бард Рус"  
(ООО «Бард Рус»)

---

ИНН/КПП 7718775215/773101001

Юридический адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.204

Тел.: +7 (499) 372-5002, факс: +7 (499) 372-5003

**Фотографические изображения  
изделия медицинского назначения**

Комплект инфузионный для введения жидкостей и лекарственных препаратов, модели PowerLoc,  
PowerLoc Max

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

[www.roszdravnadzor.ru](http://www.roszdravnadzor.ru)




1. Комплект инфузионный безопасный PowerLoc:

1. Игла Губера с предохранительным устройством и трубкой с Y-образным узлом или без него, размер иглы (один из): 1,1 мм x 19 мм, 1,1 мм x 25 мм, 1,1 мм x 38 мм, 0,9 мм x 19 мм, 0,9 мм x 25 мм, 0,9 мм x 38 мм, 0,7 мм x 19 мм, 0,7 мм x 25 мм, 0,7 мм x 38 мм – 1 шт.


2. Вкладыш-инструкция – 1 шт.

3. Регистрация МИ в Росздравнадзоре – 1 шт.

[www.nevacert.ru](http://www.nevacert.ru) | [info@nevacert.ru](mailto:info@nevacert.ru)

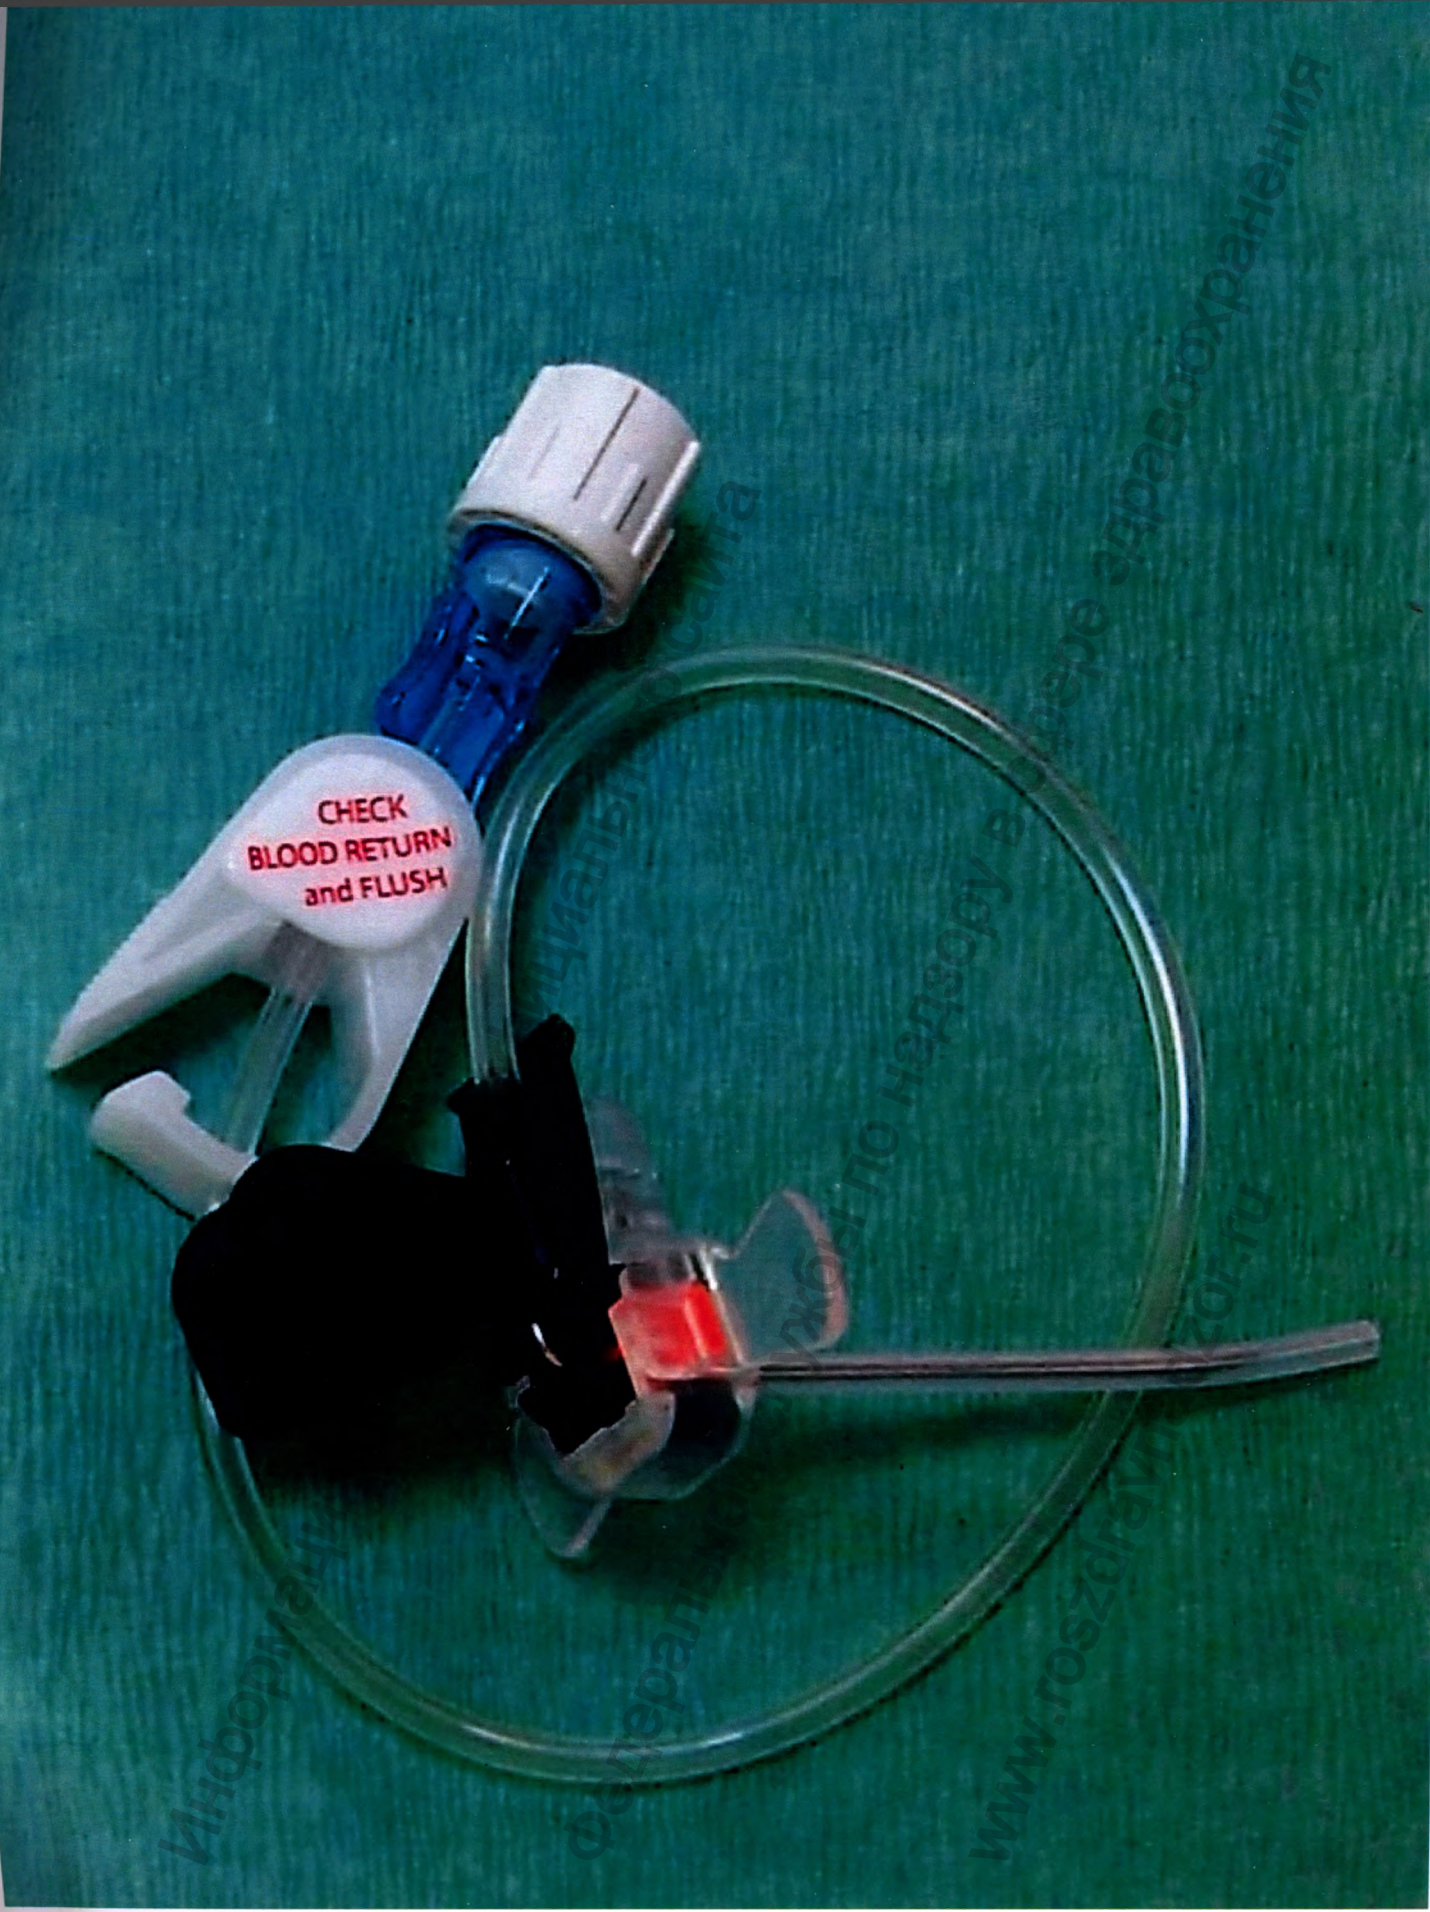

Игла Губера с предохранительным устройством и трубкой с Y-образным узлом или без него, размер иглы (один из): 0,7 мм x 19 мм, 0,7 мм x 25 мм, 0,7 мм x 38 мм из «Комплект инфузионный безопасный PowerLoc»

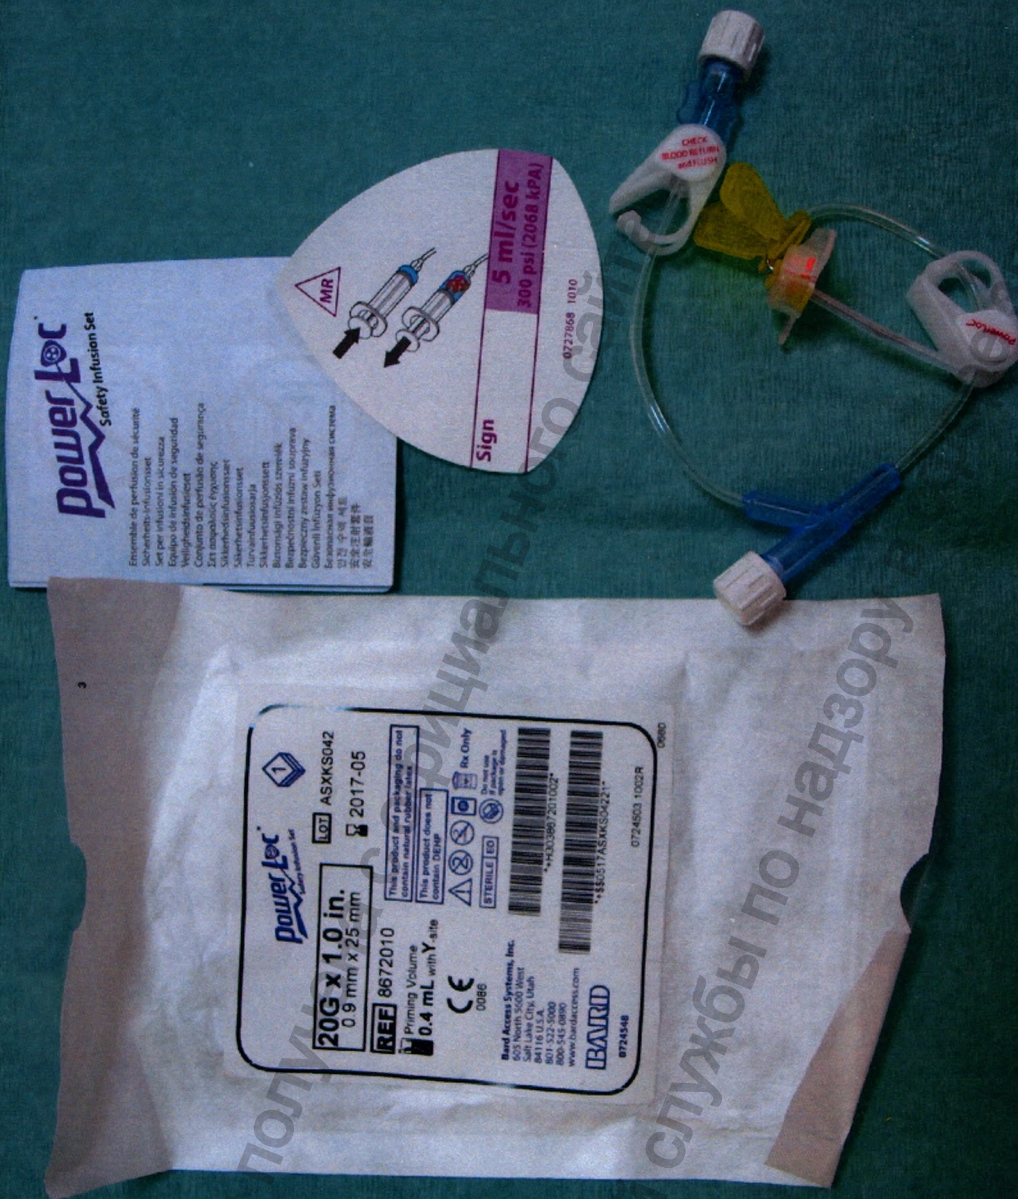


I. Комплект инфузионный безопасный PowerLoc:

1. Игла Губера с предохранительным устройством и трубкой с Y-образным узлом или без него, размер иглы (один из): 1,1 мм x 19 мм, 1,1 мм x 25 мм, 1,1 мм x 38 мм, 0,9 мм x 19 мм, 0,9 мм x 25 мм, 0,9 мм x 38 мм, 0,7 мм x 19 мм, 0,7 мм x 25 мм, 0,7 мм x 38 мм – 1 шт.

2. Вкладыш-инструкция – 1 шт.

3. Стиль Регистрация МИ в Росздравнадзоре  
[www.nevacert.ru](http://www.nevacert.ru) | [info@nevacert.ru](mailto:info@nevacert.ru)

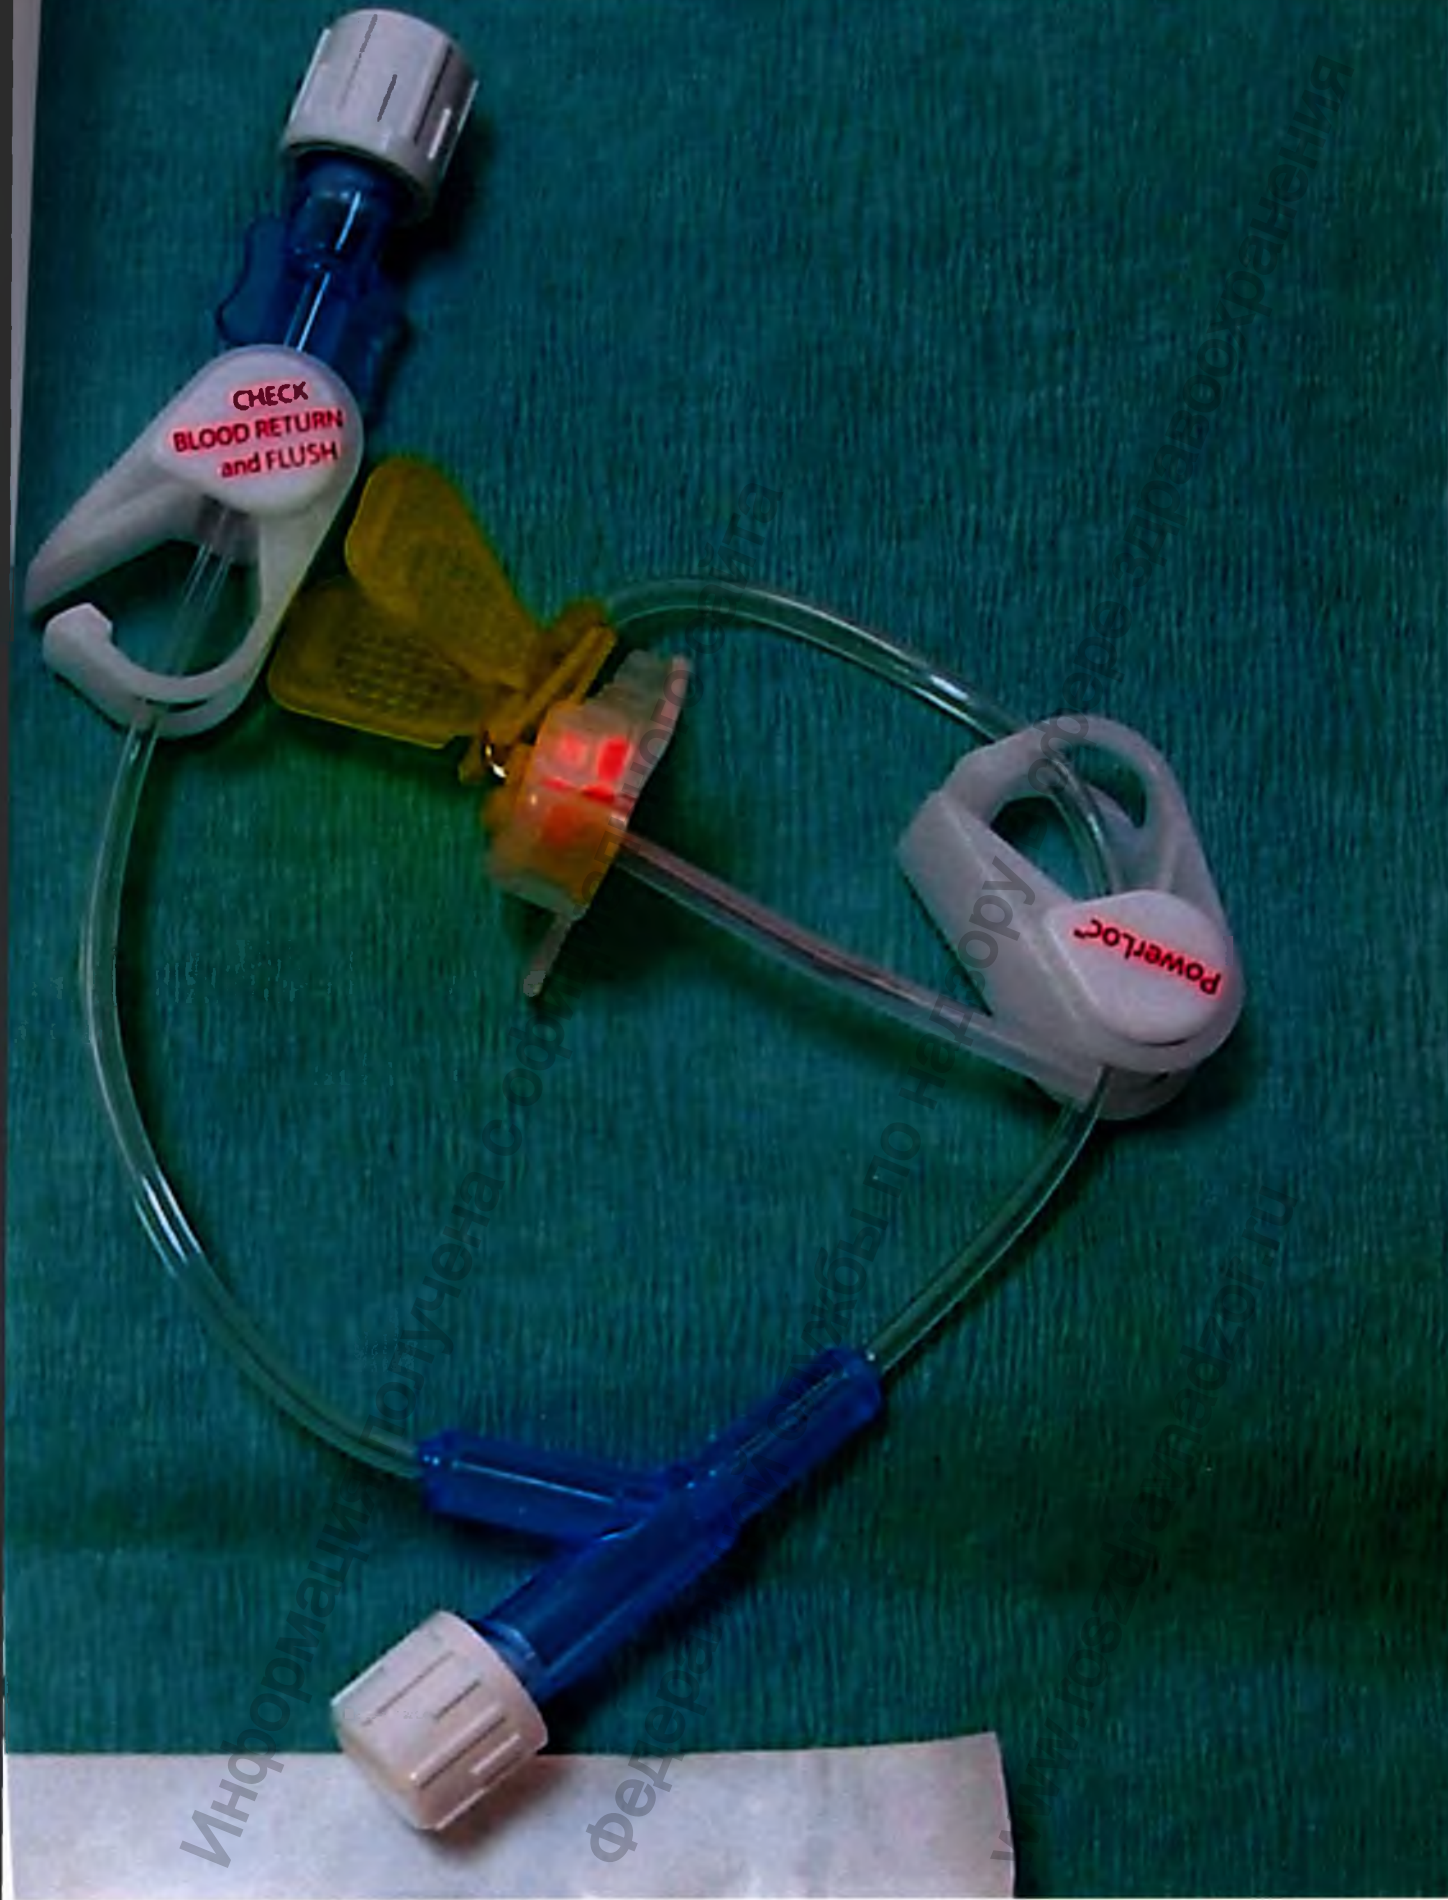

Игла Губера с предохранительным устройством и трубкой с Y-образным узлом или без него, размер иглы (один из): 0,9 мм x 19 мм, 0,9 мм x 25 мм, 0,9 мм x 38 мм из «Комплект инфузионный безопасный PowerLoc»




1. Комплект инфузионный безопасный PowerLoc:

1. Игла Губера с предохранительным устройством и трубкой с Y-образным узлом или без него, размер иглы (один из): 1,1 мм x 19 мм, 1,1 мм x 25 мм, 1,1 мм x 38 мм, 0,9 мм x 19 мм, 0,9 мм x 25 мм, 0,9 мм x 38 мм, 0,7 мм x 19 мм, 0,7 мм x 25 мм, 0,7 мм x 38 мм – 1 шт.

2. Вкл. Регистрация МИ в Росздравнадзоре

3. Стр. [www.nevacert.ru](http://www.nevacert.ru) | [info@nevacert.ru](mailto:info@nevacert.ru)

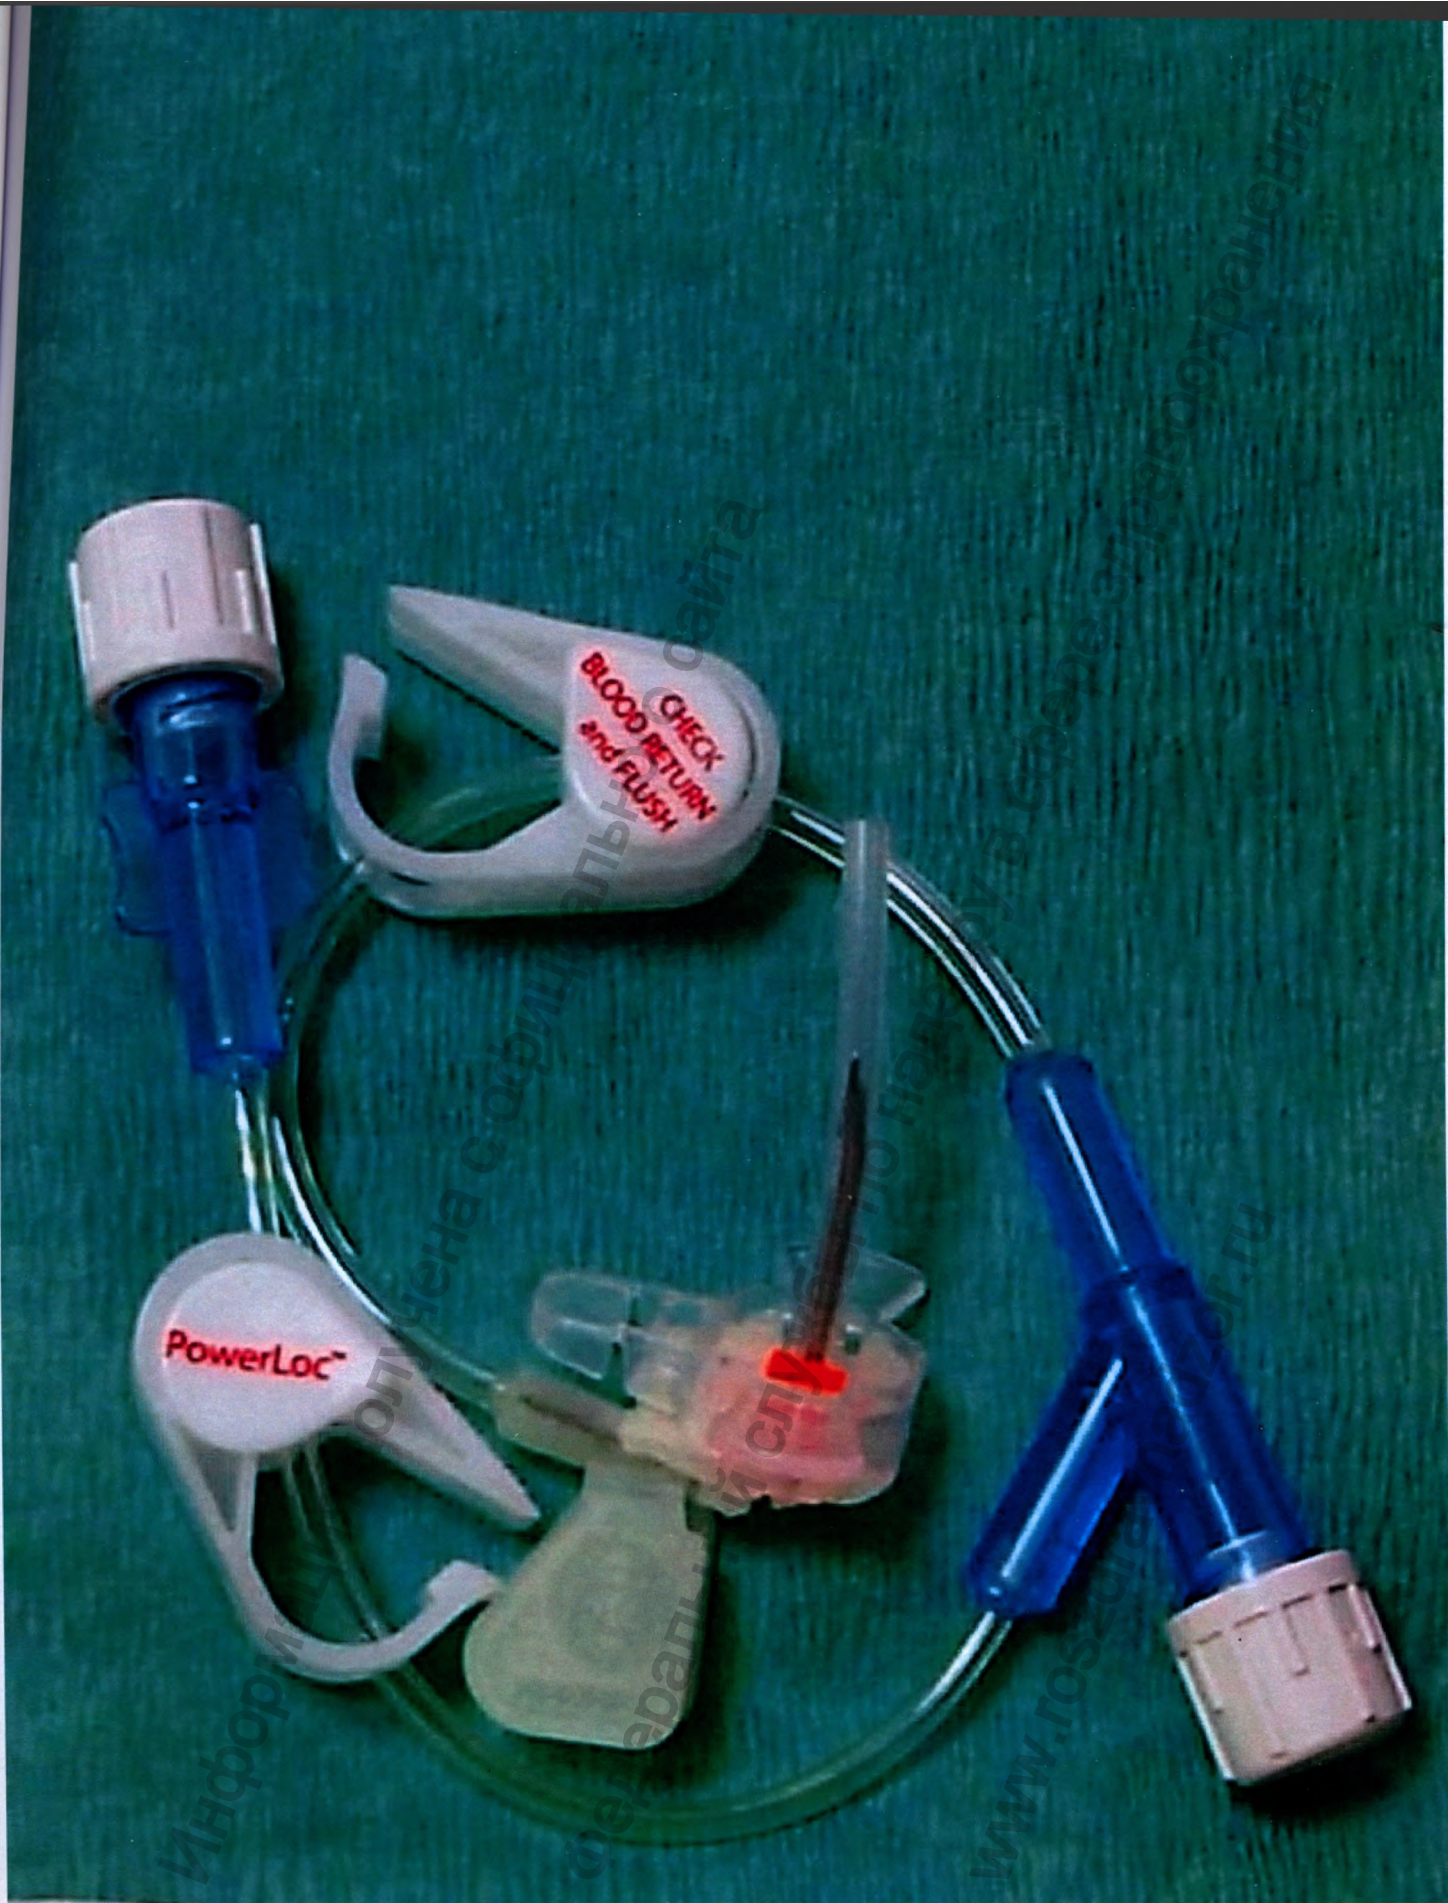


Игла Губера с предохранительным устройством и трубкой с Y-образным узлом или без него, размер иглы (один из): 1,1 мм x 19 мм, 1,1 мм x 25 мм, 1,1 мм x 38 мм из «Комплект инфузионный безопасный PowerLoc»



II. Комплект инфузионный для автоматических инъекций PowerLoc Max:


1. Игла Губера с предохранительным устройством и трубкой с Y-образным узлом или без него, размер иглы (один из): 1,1 мм x 19 мм, 1,1 мм x 25 мм, 1,1 мм x 38 мм, 0,9 мм x 19 мм, 0,9 мм x 25 мм, 0,9 мм x 38 мм, 0,7 мм x 19 мм, 0,7 мм x 25 мм, 0,7 мм x 38 мм – 1 шт.
2. Регистрация МИ в Росздравнадзоре [www.nevacert.ru](http://www.nevacert.ru) | [info@nevacert.ru](mailto:info@nevacert.ru)
3. Сайт: [www.nevacert.ru](http://www.nevacert.ru)



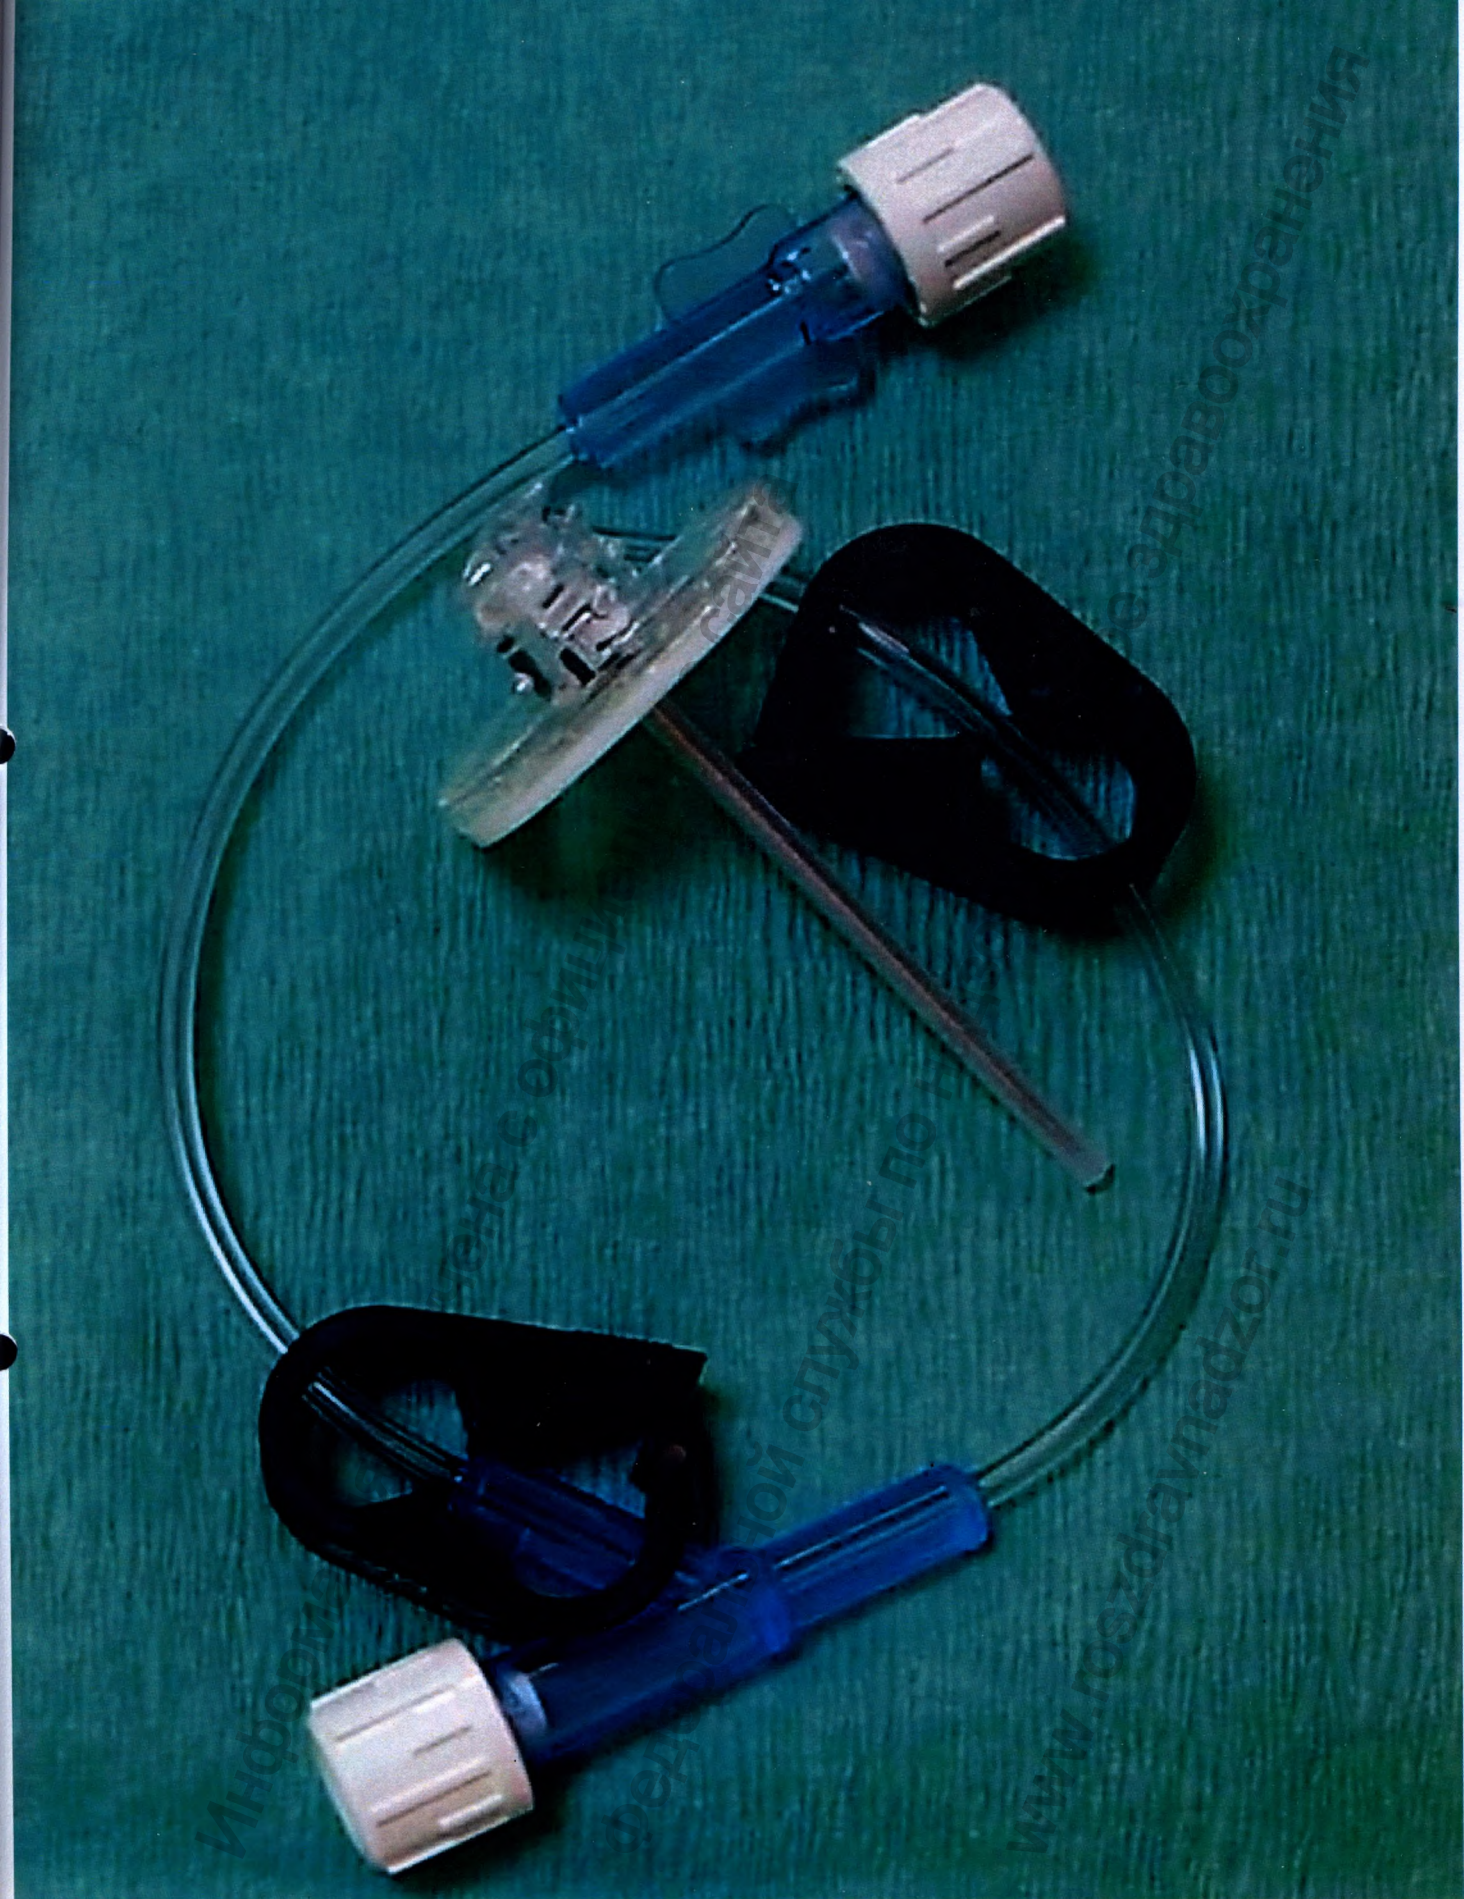

Игла Губера с предохранительным устройством и трубкой с Y-образным узлом или без него, размер иглы (один из): 0,7 мм x 19 мм, 0,7 мм x 25 мм, 0,7 мм x 38 мм из «Комплект инфузионный для автоматических инъекций PowerLoc Мах»



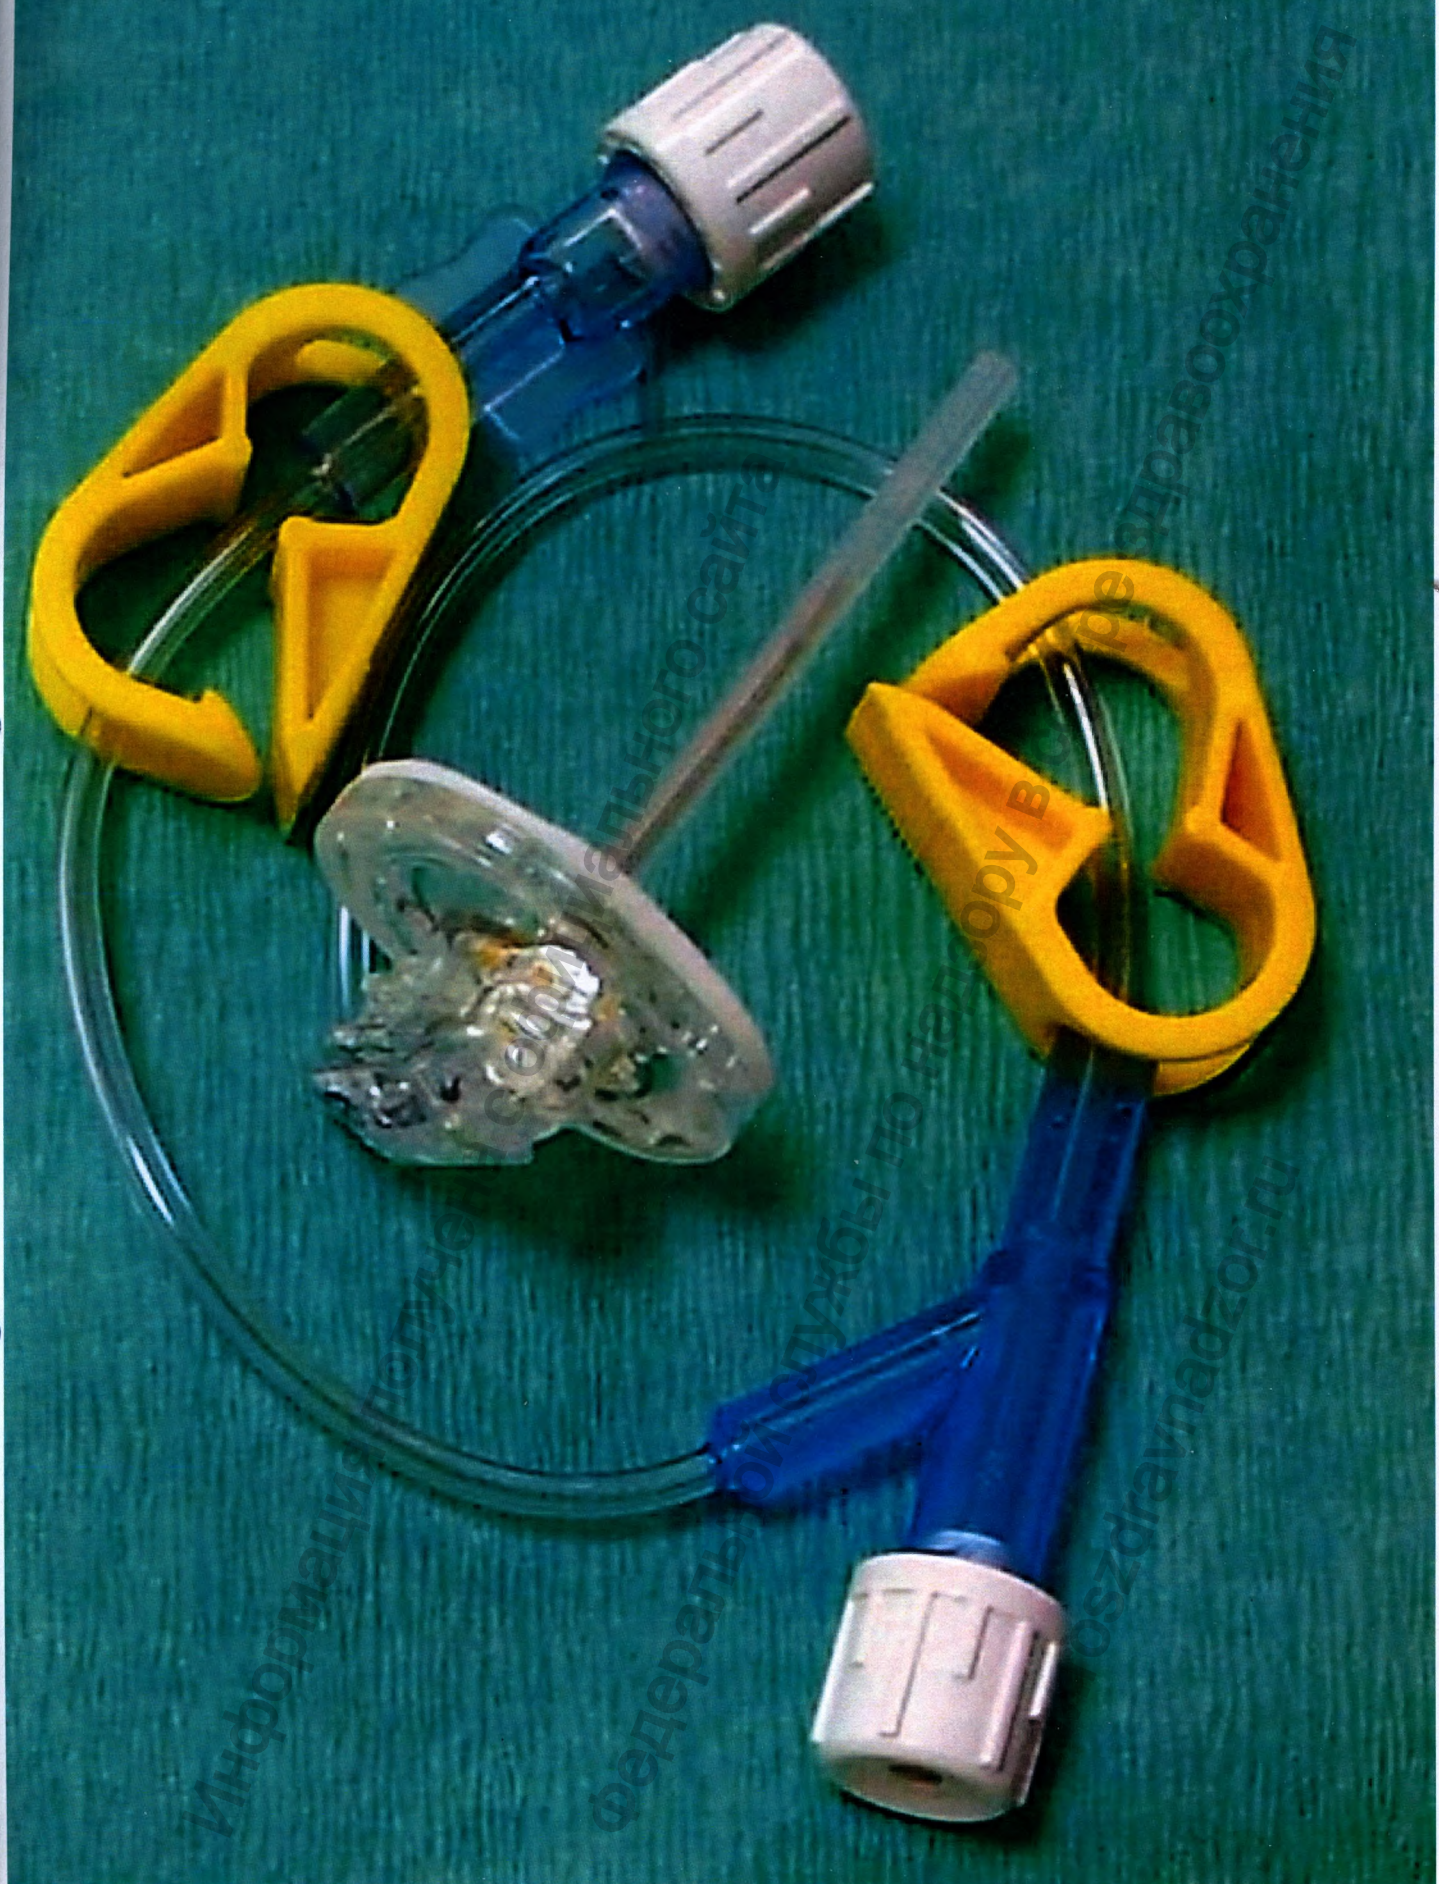

Игла Губера с предохранительным устройством и трубкой с Y-образным узлом или без него, размер иглы (один из): 0,9 мм x 19 мм, 0,9 мм x 25 мм, 0,9 мм x 38 мм из «Комплект инфузионный для автоматических инъекций PowerLoc Max»

