


3gopolve – smo kpaculo!


Фото медицинского изделия с упаковкой Молокоотсос ручной по ТУ 32.50.50-031-17707123-2017

Июль 2023

Monowootcoc chnacturobon pezepopon

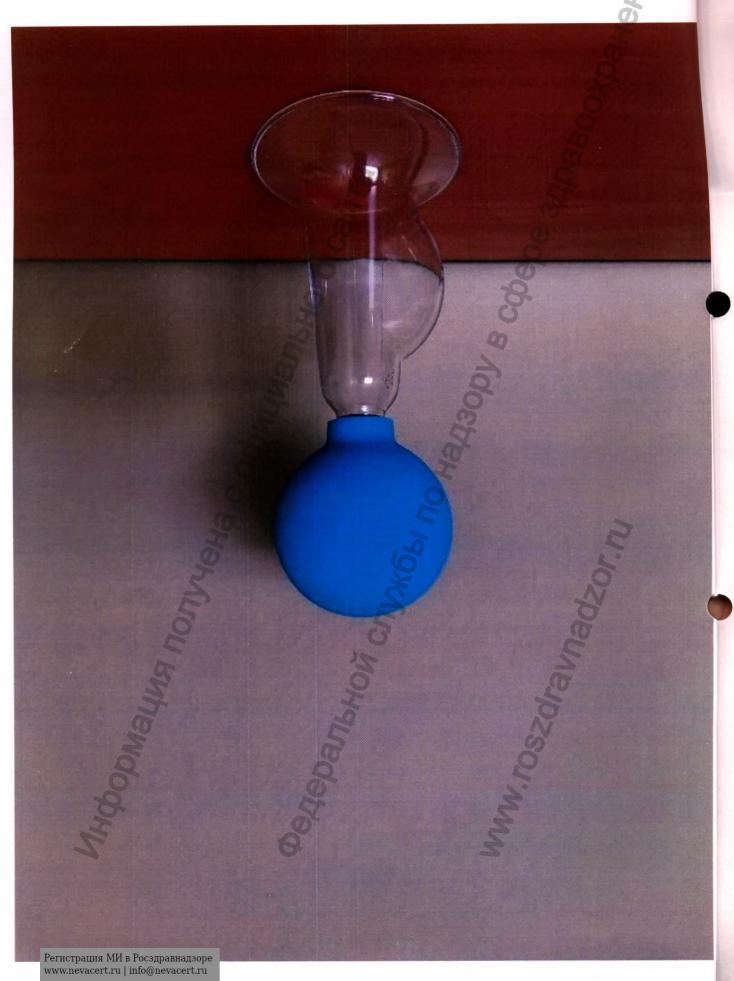

Mossororoce e nsacruroban pezepbyapon

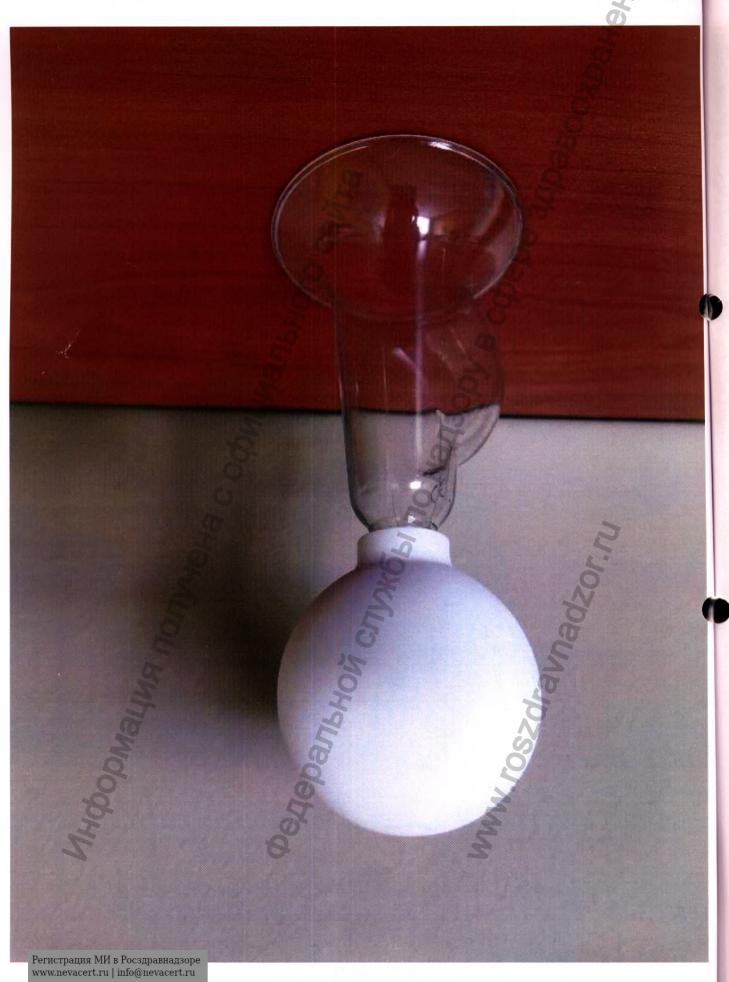

Monoroorcoc co erernanno perepopona












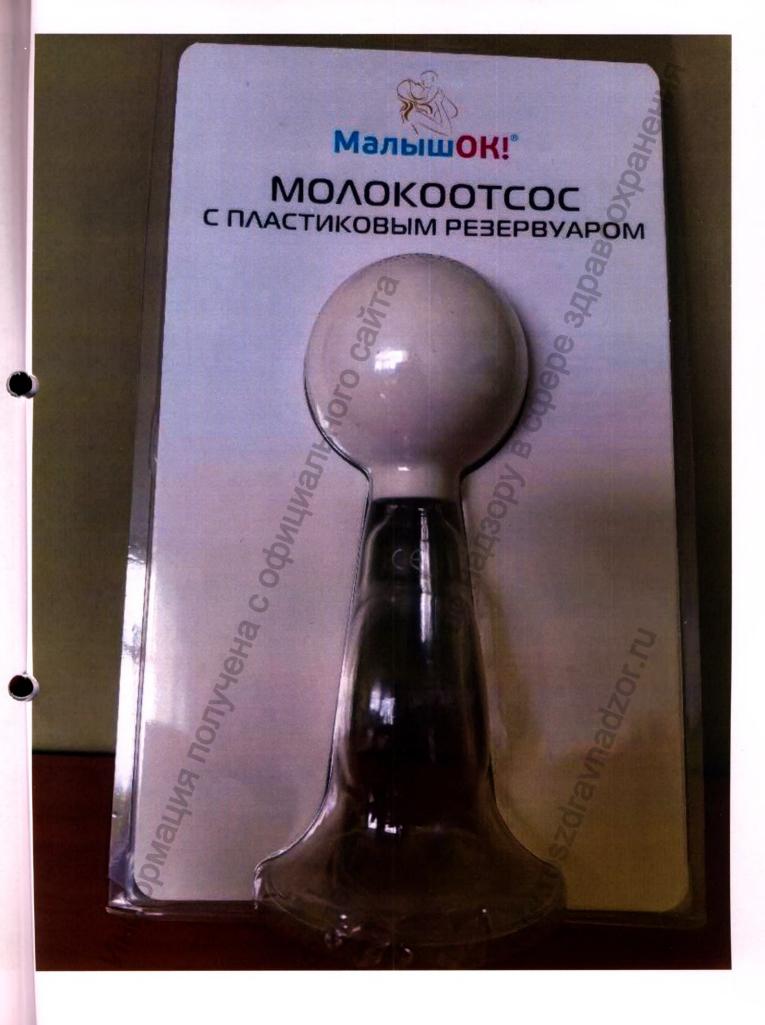







3gopoboe - smo kpacubo!

Макеты упаковки

Молокоотсос ручной по ТУ 32.50.50-031-17707123-2017

Июль 2023



Использование изделия: перед приченением становующих рожением (пред приченением самонно и резервую делением (пред становую пред становую под становую под становующих результороваться с специалистом (пред становую под становую под становую под становую под становующих результорований под становующих регизирающих рег

СДЕЛАНО В РОССИИ СДЕЛИТО С. МОЛОНОСТО РУЧНОЙ ПО ТУ 32 50.50-031-17707123-2017.
ОМИТИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

товерение N° РЗН 2018/7359 от 15.07.2020

Альпина

молокоотсос



для использова ния кормящими матерями и женщинами в послероденом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

МОЛОКООТСОС СО СТЕКЛЯННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ. Руководство по эксплуатации:

Материал резервуара

Условия хранения

Утилизация: при



молокоотсос



Молокоотгос

предназначен для использова ния нормящими матерями и послеродовом периоде в целя:

стимулировани лактации, сцеживания



CMYK



Использование изделия: пеоед применением
из отнучатироваться со специалистом (враном). Перед
из отнучатироваться со специалистом (враном). Перед
из отнечием баллом и резервура дезинфицируют
—чением в дистиплярованной воде в тенение 30:5
именув в дистиплярованной воде воду, затем
довестя воду до чибения. Оступет денемы дезинфекционной выдержим начимается и можета зачилания воды
имовымогос собрать, для чето овзервуры вставить в
отперстие баллом, перед использованием молекотуть геппой
водо. Сикть баллом, груды отключуть геппой
балдом. в результате создается стрицательное давление и
водолиять дамением ритмично, отключае баллом, до конца.
Мидеость поступет в резервуа до мучного объемы,
затем перевливателя в бутылочку или панет для сборе и
жранения грудного молома.
В завершение сцежнавния груды обтереть полотенцем,
моломосться разобрать и промить ве детали. Сцежнаваней не должное быть беланенным. Если во дени
измененнами с учествуется боль и она не проходит — скорее
сесте, высада неправливательных груды.
Сцежнава-чествуется боль и она не проходит — скорее
сесте, высадатьны. После грименения катсы моломостос
са нужно промить горичеть водой с использованием
импленого разобрать у приметьне масты моломостос
са нужно промить. После уграны потребительских свойств
желючносться подлежим учитыващия

Производитель: ООО - АЛЕ-ПИЧНА ППАСТЕ,
Россия, 141603, Московская обл. с има.

Производитель: ООО - АЛЕ-ПИЧНА ППАСТЕ,
Россия, 141603, Московская обл. с има.

Премитералосом и теря Вам м. «ЗА, стр. 1036.
Тел. - 7 (495) 787-93-66 а аргана@па-п-ракти.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Молокоотсос ручной по ТУ 32 50.50-031-17707123-2017. Регистрационное удостоверение N° РЗН 2018/7359 от Регистраци 15.07.2020

Не подлежит

ANDRUHA n n a c T

арантийный срок хранения - 5 лет с даты изгот



молокоотсос



для использова ния нормящими матерями и матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулир лактации сцеживания молока и

рофилактики

пактостаза.

МОЛОКООТСОС С ПЛАСТИКОВЫМ РЕЗЕРВУАРОМ, ководство по эксплуатации: токоотсос предназначен для использования

Побочные действия:

Эксплуатационные огра Меры предосторожно





молокоотсос




Молокоотсос

предназначен для использова ния кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулировани лактации. молока и профилакти

лактостаза.



PANTONE 634 C



ПЛАСТИК ЫДЫСЫ БАР СУТСОРГЫШ

молокоотсос С ПЛАСТИКОВЫМ **РЕЗЕРВУАРОМ**

DE3EPBYAPOM C LINACTNKOBLIM МОЛОКООТСОС

T 3 A A D

изготовлено:

етор в Республике Беларусь: 000 -БОЛЕАР Белмед ». Минек ул. М. Лонокова, 1275, каб. 4, 7ел.: +375 (17) 373-83-20.



молокоотсос

С ПЛАСТИКОВЫМ

РЕЗЕРВУАРОМ

APT. 2020021022

Регистрация МИ в Росздравнадзоре



ИЗГОТОВЛЕНО: ДЕЙЫНДЕЛГЕН:

PE3EPBYAPOM CO CTEKNAHHЫМ МОЛОКООТСОС

ШЫНЫ ЫДЫСЫ БАР СҮТСОРГЫШ

ето растаула житпийды.
мерзин — туткенушка зикан куркен бастал 2 жыл.
оверзин — даженуйска куркен бастал 5 жыл.
оту мерзин — ониксталмиятык.
изу мерзин — ониксталмиятык.
изу мерзин — ониксталмиятык.
оту мерзин — ониксталмиятык.

молокоотсос

СО СТЕКЛЯННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ



молокоотсос

со стеклянным РЕЗЕРВУАРОМ









APT. 2020011022



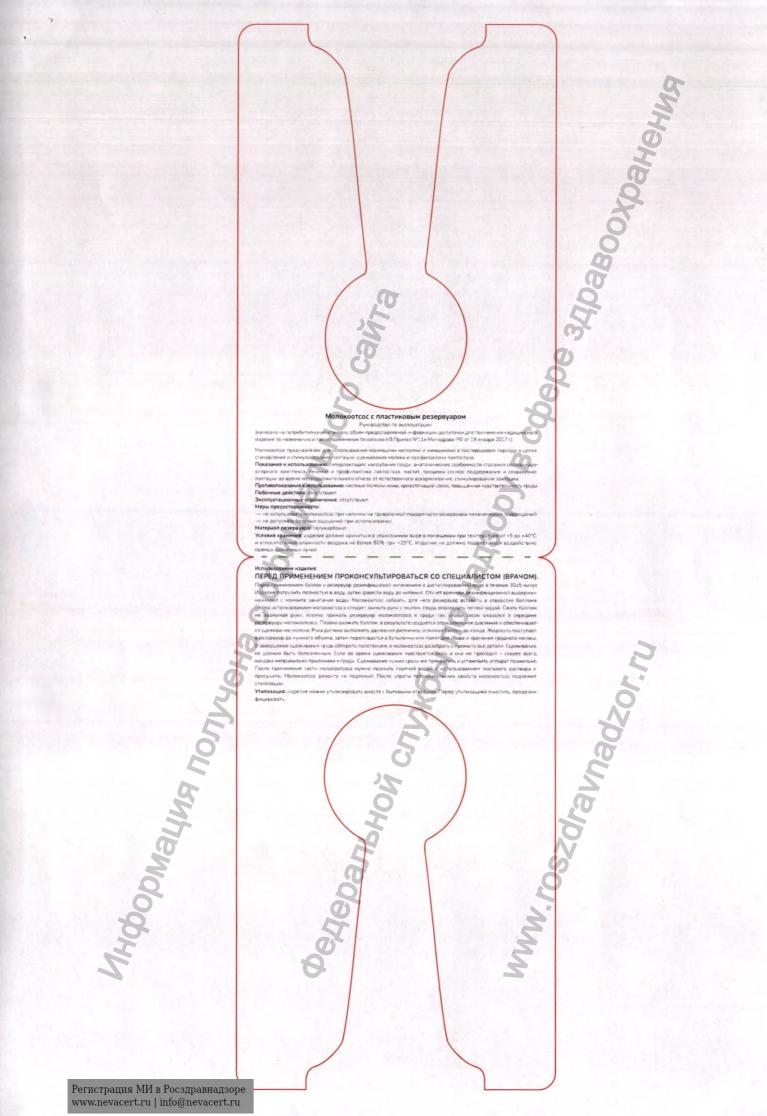



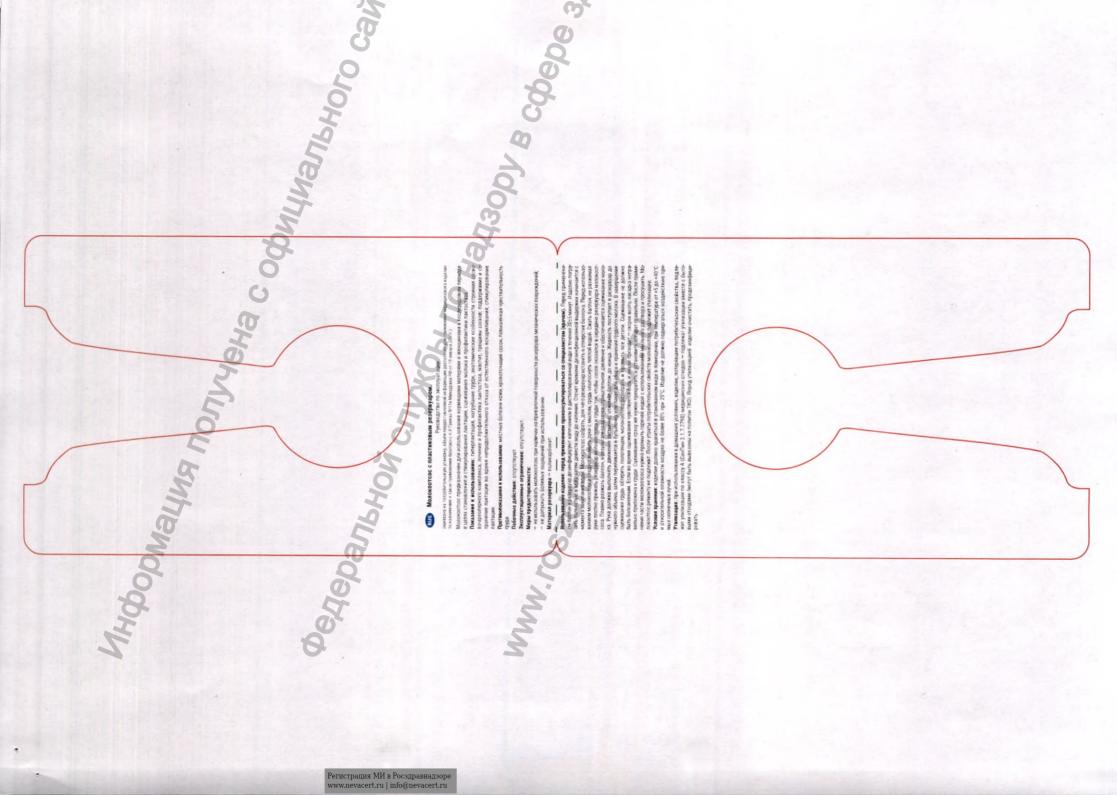



Использование изделия: перед примен проконсультироваться со специалистом (врачом). Перед применением баллон и резервуар дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. Изделие погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекцион ной выдержки начинается с момента закипания воды. Молокоотсос собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона. Перед использованием молокоотсоса следует вымыть руки с мылом, грудь ополоснуть теплой водой. Сжать баллон, не разжимая руки плотно прижать резервуар молокоотсоса к груди так, чтобы сосок оказался в середине резервуара молокоотсоса. Плавно разжать баллон, в результате создается отрицательное давление и обеспечивается сцеживание молока. Рука должна выполнять движения ритмично, отжимая баллон до конца Жидкость поступает в резервуар до нужного объема, затем переливается в бутылочку или пакет для сбора и хранения грудного молока.

В завершение сцеживания грудь обтереть полотенцем молокоотсос разобрать и промыть все детали. Сцеживание не должно быть болезненным. Если во время сцеживания чувствуется боль и она не проходит — скорее всего, насадка неправильно приложена к груди. Сцеживание сразу же нужно прекратить и установить

аппарат правильно. После применения части молокоотсоса нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора и просушить. Молокоотсос ремонту не

подлежит. После утраты потребительских свойств олокоотсос подлежит утилизаци Производитель: 000 «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г. Клин

Ленинградское ш., тер. 88 км, к.ЗА, стр. 103Б. Тел.: +7 (495) 787-93-66, alpina@alpina-plast.ru. www.alpina-plast.ru

Альпина СДЕЛАНО В РОССИИ Молокоотсос ручной по TY 32.50.50-031-17707123-2017.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7359 от 15.07.2020.

Не подлежит обязательному подтверждению соответ

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня получения потребителем

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовле-





Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики лактостаза.

молокоотсос с пластиковым РЕЗЕРВУАРОМ.

Руководство по эксплуатации:

Молокоотсос предназначен для исполь: кормящими матерями и женщинами в послеродо периоде в целях становления и стимулирования нами в послеродовом лактации, сцеживания молока и профилактики

Показания к использованию: гиперлактация, нагрубание груди, анатомические особенности строения сосково-ареолярного комплекса, лечение и профилактика лактостаза, мастит, трещины сосков; поддержание и сохранение лактации во время непродолжительного отказа от естественного вскармливания; стимулиров

Противопоказания к использованию: местные болезни кожи, кровоточащий сосок, повы вствительность груди.

Побочные действия: отсутствуют Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Меры предосторожности: вать молокоотсос при наличии на эй поверхности резервуара механических

привалочной п повреждений; не долускать болевых ощущений при испо-

Материал резервуара - поликарбонат. Условия хранения: изделие должно храниться в

анном виде в помещении, при температуре от +5 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C. Изделие не должно подвергаться действию прямых солнечных лучей

Утилизация: при использовании в домашних условиях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов - подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами (могут быть вывезены на полигон ТКО). Перед утилизацией изде





молокоотсос



Молокоотсос предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации. сцеживания молока и профилактики лактостаза.

Изготовлено:



PANTONE 634 C

PANTONE 311 C

CMYK



Использование изделия: перед применение проконсультироваться со специалистом (врачом). Перед применением баллон и резервуар дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. Изделие погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекцион ной выдержки начинается с момента закипания воды. Молокоотсос собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона. Перед использованием молокоотсоса следует вымыть руки с мылом, грудь ополоснуть теплой водой. Сжать баллон, не разжимая руки плотно прижать резервуар молокоотсоса к груди так, чтобы сосок оказался в середине резервуара молокоотсоса. Плавно разжать баллон, в результате создается отрицательное давление и обеспечивается сцеживание молока. Рука должна выполнять движения ритмично, отжимая баллон до конца. Жидкость поступает в резервуар до нужного объема. затем переливается в бутылочку или пакет для сбора и хранения грудного молока.

В завершение сцеживания грудь обтереть полотенцем, молокоотсос разобрать и промыть все детали. Сцеживание не должно быть болезненным. Если во время сцеживания чувствуется боль и она не проходит — скор всего, насадка неправильно приложена к груди. Сцеживание сразу же нужно прекратить и установит

аппарат правильно. После применения части молокоото са нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора и просушить. Молокоотсос ремонту не подлежит. После утраты потребительских свойств оотсос подлежит утилизации

Производитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г. Кли Ленинградское ш., тер. 88 км, к.ЗА, стр. 103Б. Тел.: +7 (495) 787-93-66. alpina@alpina-plast.ru.

СДЕЛАНО В РОССИИ Молокоотсос ручной по TY 32.50.50-031-17707123-2017.

О АЛЬПИНА В В АЛЬПИНА В ТОРОНИИ В ТОРОНИ

ное удостоверение № РЗН 2018/7359 от 15.07.2020 Не подлежит обязательному подтверждению соответ

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня

получения потребителем. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовле



молокоотсос

СО СТЕКЛЯННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ



Молокоотсос

предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики

лактостаза.

молокоотсос со стеклянным РЕЗЕРВУАРОМ.

Руководство по эксплуатации: Молокоотсос предназначен для испол

кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока и профилактики

Показания к использованию: гиперлактация нагрубание груди, анатомические особенности строения сосково-ареолярного комплекса, лечение и профилактика лактостаза, мастит, трещины сосков; поддержание и сохранение лактации во время непродолжительного отказа от естественного вскармливания; стимулирование

Противопоказания к использованию: местные болезни кожи, кровоточащий сосок, повышенная чувствительность груди.

Побочные действия: отсутствую Эксплуатационные ограничения: отсутствуют. Меры предосторожности:

не использовать молокоотсос при наличии на привалочной поверхности резервуара механических повреждений;

не допускать болевых ощущений при использовании Материал резервуара - стекло

Условия хранения: изделие должно храниться в улакованном виде в помещении, при температуре от +5 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C. Изделие не должно подвергаться действию прямых солнечных лучей.

Утилизация: при использовании в домашних условиях, зделие, потерявшее потребительские свойства. подлежит утилизации по классу А (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов - подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами (могут быть вывезены на полигон ТКО). Перед утилизацией изделие очистить, продезин-





молокоотсос

СО СТЕКЛЯННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ



Молокоотсос

предназначен для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом периоде в целях становления и стимулирования лактации.

сцеживания молока и профилактики лактостаза

Изготовлено:



PANTONE 634 C

PANTONE 311 C

CMYK



изготовлено:

PE3EPBYAPOM C LINACTNKOBЫM МОЛОКООТСОС

КАЗ ПЛАСТИК ЫДЫСЫ БАР СҮТСОРҒЫШ

Колмен басқарылатын сутсоргыш ТШ 32.50 50-031-17707123-2017 Сутсорғыш лактацияны, сутті сауып тастауға және лактостазды профилакти-калау максатында босанғания кейінгі кезеңде әйелдерге және бала емізетін аналарға пайдалануға арналған.

емлетин аналирга паидалануға арналған. Қолданылуы: гилерлактация, емшектің қатаюы, емізік-ареолы кешен құрылымының анатомиялық ерекшеліктері, лактостазды емдеу жане профилактиклалу жастиг, емшек ұшының жарылуы: Табиғи емізуден уақытша бас тартқанда пактацияны демеу және сақтау, лактацияны стимуляциялау. Колдануға болмайтын жағадалар: Терінің жергілікті ауруларында, емшек ушы қанап тұрғанда, емшектің жоғары сезімталдығында.

Пайдалануға шектеулер: жоқ.

Пайдалануға шектеулер: жоқ
Сақтық
— мдыстың жазық жанасатын беткейінде механикалық зақымданулар
болса, сут сорғышты пайдалануға болмайды;
— пайдалану кезінде әуыруды сезінуге жол бермеу керек.
Буйымды пайдалану Колданар алдында маманикен (дәрігермен) кеңесу керек.
Колданар алдында баллон мен ыдысты 30+5 минут бойы дистиплацияланған
суда қайиатумен дезинфекциялайды. Буйымды толлығымен суға батырып,
одан кейін суды қайнату керек. Дезинфекциелық үстау уақытын есептеу су
қайнаған саттен басталары. Сутсорғышты жинау керек, ол үшін ыдысты
баллонның тесігіне кіріктіру керек.
Сутсорғышты колданар алдында колды сабынмен жуып, кеуден жылы суман
шаю керек. Баллонды сығып, емшек үшы сутсорғыш ыдысының ортасында
болатындай етіп, қолды жазбастан сутсорғыш ыдысының басыны, а болатындай етіп, қолды жазбастан сутсорғыш ыдысының басыны, а баллонды біртіндеп босатыны, а натижесінде теріс қысым пайда болады және сүтті сауу қамтамасыз етіпеді. Қол баллонды соңына дейін қысып, қимылдарды ырғахты орналауы тікс.
Суйықтық ыдысқа қажетті көлемге дейін туседі, содан кейін емшек сутін

Суйықтық ыдысқа қажетті көлемге дейін туседі, содан кейін емшек сутін жинауға және сақтауға арналған бөтелкеге немесе пакетке құйылады. Сауып болағынан кейін кеудені сүлгімен сүртіңіз, сутсорғышты бөлшектеп және барлық бөпшектерін жуыңыз.

және барлық бөлшектерін жуыңыз. Сарып тастау кезінде Сарып тастау ауырсынуры туындатлауы керек Егер сауып тастау кезінде ауырсыну севілсе және ол басылмаса — онда қондырғы кеудеге дұрыс қонылмаған. Саууды дереу тоқтату және алпаратты дұрыс орнату керек. Сутсорғыш бөліктерін қолданғаннан кейін сабынды ерітіндіні пайдаланып ыстық сумен жуып және келтіру керек. Сутсорғыш жәнеуге келемейді. Сутсорғыштың тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін утилизациялау керек.

Ыдысының материалы - поликарбонат

Ыдысының материалы – поликарбонат. Утилизация үч жагайында пайдалану кезінде түтынушылық қасиеттерін жоғалтқан бұйым медициналық қалдықтарды А класы бойынша (СанЕмН 2 1.7.2790) утилизациялауа жатады (ҚТҚ полигонына шығарылуы мүмкін). Утилизациялауа жатады (ҚТҚ полигонына шығарылуы мүмкін). Утилизациялауа жалдында өнімді тазалау, дезинфекциялау керек. Сақтау шарттары: Бұйым қалталған күйінде бөлмеде, +5-тен +40°С-ге дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 25°С-де 80%-дан салатын жерде сақтау керек. Бұйым тікелей түсетін күн сәулесінің әсеріне ушырамауы тиіс.

ушырамауы тиіс. Өндіруші «Алыпна Пласт» ЖШК, Ресей, 141603, Маскеу обл., Клин қ., Ленинград тын, аум. 88 км. к. 38, 1035 құр. Тел.. + 7 (495) 787-93-66. аіріпа@аіріпа-рlast.ru Өндірушінің уамілетті өкілі: Қазақстан Республикасы ауматында түтынушыларда неңіншилалық бұйымның сапасы жөніндегі шатымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын және меріциналық бұйымның тіркеуден нейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауатты ұйым: «Болеар Қазмед» ЖШС, Алматы қаласы, Жептсу ауданы, Райымбек Даңғылы, 221/2 үй, пошта индексі 050016, телефон: +7 (727) 313-24-21, boleat 5@bk.ru

Ресейде жасалған

Ресеиде жасалған www.alpina-plast.ru Тіркеу куалігі № РЗН 2018/7359 15.07.2020. РФ-да сәйкестікті міндетті растауға жатпайды. Пайдаланудың кепілді мерзімі — Тұтынушы алған күнкен бастап 2 жыл. Сақтаудың кепілді мерзімі — дайындалған күнінен бастап 5 жыл. Жарамдылық/қызмет ету мерзімі — анықталмаған.

Беларусь Республикасындағы Дистрибьюторы: «Болеар Белмед» ЖШҚ, 220124, Минск қ., М. Лыньков к-сі, 123Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

МОЛОКООТСОС

С ПЛАСТИКОВЫМ РЕЗЕРВУАРОМ



RUS Молокоотсос с пластиковым резервуаром.

Руководство по эксплуатации требительскую утаковку, объей предеставляемой информации достаточен медицинского изделяя по изаяфлению и такое применение безопасно п.8 издрава РФ от 18 янарая 2017 из

для применения медуалиствого язделия по назлетенно и в неое применение сезопасно п.о. Прика NTI II Минадраза Ро от 19 жевара 217.1 Молокоотсос предназначем для использования кормящими матерями и женщинами в послеородовом периоде а целях становления и стимулирования лактации, сцеживания молока в профилактики даткостаза. Показания к использованию: гинеродизатици, нагрубание груди, анатомические сособенности строения соковов-пости строения соковов-пости строения соковов-пости строения соковов-пости строения соковов-пости с окилиеков, ачечение и профилактика пактостаза, мастит, трещины согоков, поддержание и сохранение лактации стимулирование лактации противоложазания к использованию: местные болезии кожи, кровоточащий сосок, повышенияя чувствительность груди.

Лебочные действия: отсутствуют.

Меры предосторожности:

не использовать молокоотсос при наличии на привалочной поверхности резервуара механических повреждений;

резервуара механических повреждений; - не допускать болевых ощущений при использовании.

резервуара механический попреждений;

— не допускать болевых окущений при использовании

Использование маделия; перед применением проконсультироваться со
специальстом (врачом). Перед применением баллон и резервуар
дезинфицируют кипачением в дистиплированной воде в течение 30.5
минут. Изделие посутить полностью в оду, затем довести зоду до
кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдерми менинается с
момента закрания едоры Молокоотосо собрать, починается с
момента закрания едоры. Молокоотосо собрать не превервуар
вставить в отверсите баллона. Перед использованием постово отосаспедует вымыте руки с мылом, грудь ополосчуть теплой водов Тосабаллон, не развиман руки плотно примать резервуар молокоотоса к груди
так, чтобы сосом оказался в середине резервуар молокоотоса к груди
так, чтобы сосом оказался в середине резервуар молокоотоса. Плавно
разжать баллой, в результате создается отрицательное давление и
ритмично, отжимая баллон до конца. Жидкость поступает в резервуар до
нужного, объема, затем переливается в бутыломух или пакет для сбора и
разнения утрудного молока. В завершение сцеживания грудь обтереть
полотенцеми молокоотоссь разобрать и промыть все детали. Сцеживание не
должно быть болеэненным. Если во время сцеживания чувствуется боль и
пакет для струдь обтереть объема об

укилизации. Материал резервуара — поликарбонат. Условия крамения: изделие должно храниться в улакованном виде в помещении, три температуре от +5 до +40°C и отпосительной влажности воздуха не более 80% при 25°C. Совменных лучей.

Молокоотсос ручной по ТУ 32.50.50-031-17707123-2017.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7359 от 15.07.2020. Не подложит обязательному подтверждению соотвествия в РФ. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня получения потреби Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления. Срок годности/службы — не установлен.

Дистрибьютор в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

СДЕЛАНО В РОССИИ www.alpina-plast.ru

МОЛОКООТСОС

С ПЛАСТИКОВЫМ PE3EPBYAPOM





APT. 2020021022



:НА ТГАДНІЙАД изготовлено:

DE3EPBYAPOM CO CTEKЛЯННЫМ **МОЛОКООТСОС**

КАЗ ШЫНЫ ЫДЫСЫ БАР СҮТСОРҒЫШ

Қолмен басқарылатын сүтсорғыш ТШ 32.50.50-031-17707123-2017

Қолмен басқарылатын сүтсоргыш ТШ 32.50.50.031-17707123-2017 Сутсоргыш лактацияны, сүтті сауыл тастауға және лактостазды профилакты-калау мақсатында босығаннан кейінгі кезенде айелдерге және бала-емізетін аналарга лайдалануға арналған. Қолданыруы: гиперлактация, емиектің қатаюы, емізік-ареолы кешен құрылымының анатомиялық ерекшеліктері, лактостазды емлеу және профилактиклалу, мастит; емшех ушының жарылуы; табиғи емізуден уақытша бас тартқанда пактацияны демеу және сақтау, лактацияны стимуляциялау. Қолдануға болмайтын жағдайлар: терінің жергілікті ауруларында, емшек ұшы қанат тұранда, емшектің жоғары сезімталдығында. Жағымсыз әсерлері: жоқ. Пайдалануға шектеулер: жоқ. Сақтық шаралары:

Пайдалануға шектеулер: жоқ.

Сақтық
— ыдыстың жазық жанасатын беткейінде механикалық зақымданулар
болса, сут сорғышты пайдалануға болмайды;
— пайдалану кезінде ауыруды сезінуге жол бермеу керек.

Бұйымды пайдалану колданар алдында замамимен (дарігермен) кеңесу керек.

Колданар алдында баллон мен ыдысты 30±5 минут бойы дистиплацияланған куда қайнатумен дезинфекциялайды. Бұйымды толығымен суға батырып, одан кейін суды қайната жерек. Дезинфекциялық устау уақытын есептеу су қайнатан келітен басталады. Сутсоргышты жинау керек, от үшін ыдысты баллонның тесігіне кіріктіру керек. Сутсоргышты қолданар алдында қолды сабынмен жуып, кеуден жылы сумен шао керек Баллонды сынып, емшек үші сутсорғыш ыдысының ортасында болатындай етіп, қолды жазбастан сутсорғыш ыдысын кеудеге тығыз басыныз. Баллонды біртіндеп босатынды, натижесінде теріс қысым алды болары жане сүтті сауу қамтамасыз етіпеді (қо баллонды соқына дейін қысып, қимылдарды ырғақты орындауы тию.

Суйықтық ыдысқа қажетті көлемге дейін туседі, соран кейін емшек сүтін көлекте діні туседі, соран кейін емшек сүтін көлекте діні туседі, соран кейін емшек сүтін күлықты көлекте діні туседі, соран кейін емшек сүті күлықты баран кейін емшек сүтін көлекте діні туседі, соран кейін емшек сүтін көлекте дінін туседі, соран кейін емшек сүтін сүрін кейін емшек сүтін кемекте дінін туседі, соран кейін емшек сүтін сүрін кейін емшек сүтін сүрін соран кейін емшек сүтін сурын соран кейін емшекте сүрін сүрін соран кейін емшекте сүрін сүрін соран сейін емшекте сүрін сүрін емшекте сүрін емшекте сүрін емшекте сүрін емшекте сүрін емшектерін емшекте сүрін емшекте сүрін емшекте сүрін емшекте сүрін емш

соңолга делит қылысқа қажетті көлемге дейін туседі, содан кейін емшек сутін жинауға және сақтауға арналған бөтелкеге немесе пакетке күйіндеды. Сауыл болғаннан кейін кеудені сүртімен сүртінді, сүтсорғышты бөлшектеп және барлық бөлшектерін жүыңды. Сауыл тастау ауырсынуды туындатлауы керек Егер сауыл тастау кезінде ауырсыну сезілсе және ол басылмаса — онда қоңдырғы кеудеге дүрыс қойылмаған. Сауды дереу тоқтату және аппаратты дүрыс орнату керек сутсорғыш бөлигетін көрінде ақын аппаратты дүрыс орнату керек сутсорғыш бөлигетін көлалығаның кейін сабылына орнату керек сутсорғыш бөлигетін көлалығаның кейін сабылына орттуның отаралығына қауды дерез орнату керек

Сутсорғыш бөліктерін қолданғаннан кейін сабынды ерітіндіні пайдаланып ыстық сумен жуыл және кептіру керек. Сутсорғыш жөндеуге келемейді. Сутсорғыштың тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін утилизациялау керек.

сутсоргыш жөндеуге келменді. Сутсоргыштың тұтынушылық қасиеттері жоғалағанық кейін ұтилызациялау керек. Ыдысының материалы – шыны. Сақтау шарттары: Бұйым қапталған күйінде бөлмеде, +5-тен +40°С-ге дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдынығы 25°С-де 80%-дан аспайтын жерде сақтау керек. Бұйым тікелей түтетін күн саулесінің әсеріне ушырамауы тике. Утилизация үй жайдында пайдалану кеаінде тұтынушылық қасиеттері мұлымазация үй жайдында пайдалану кеаінде тұтынушылық қасиеттері мұлымазация (санын 2.17,790) утилизациялауға жатады (КТК полигоның шығарылуы мүмкін). Утилизациялау алдында өнінді тазалау, деэнифекциялау керек. Ондіруш «Альлина Пласт» ЖШК, Ресей, 141603, Маскеу обл. Клин қ. Ленияград тулы, аум. 88 км. к. 3А, 1056 құр. Тел. +7 (495) 787-93-66. аlріпа@аlріпа-ріакт ги Ондірушиналық бұйымының саласы жөнійдей шағымдарды (қыныстарды) қабылдайтын және медициналық бұйыминың тіркеуден кейінгі қараларды жарымың саласы құйыминың түркеуден кейінгі қараларды қалысы, райым бек даңғылы, 221/2 үй, пошта индексі 050016, телефок: +7 (727) 313-24-21, boleats@bk.ru

Ресейде жасалған www.alpina-plast.ru Тіркеу куалігі № РЗН 2018/7359 15.07.2020. РФ-да сайкестікті міндетті растауға жатпайды. Пайдаланудың кепіліл мерзімі — тұтынушы алған күннен бастап 2 жыл. Сақтаудың кепілід мерзімі — дайындалған күнінек бастап 5 жыл. Жарамдылық/қызмает ету мерзімі — анықталмаған. Болалуыс, Республиуасыналы Шетстийкоторы: «Боларап Бөлмел» ЖШК. 220

Беларусь Республикасындағы Дистрибьюторы: «Болеар Белмед» ЖШҚ, 220124, Минск қ., М. Лыньков к-сі, 123Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

МОЛОКООТСОС

СО СТЕКЛЯННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ



AVPUNHA U V V C T

RUS Молокоотсос со стеклянным резервуаром.

Руководство по эксплуатации отребительскую утаковку, объек предоставляемой в медицинского изделия по назмачению и такое п инздрава РФ от 19 января 2017г

Приеза № 11 м Минадрава РФ от 19 инварх 2017; Молокоотосо предназначем для использования кормящими матерями и женщинами в послеродовом перибде а целях становления и стимунирова-ния лактации, сцеживания молока в профилактики лактостаза. Показания к использованию: гиперлакт цин, нагрубане груди, анатомические сосфенности строения сосково-ареогарного комплекса, лечение и профилактика лактостаза, ластит, трещины сосков поддержание и сохранение лактации во время непродолжительного стказа от естественного вскармливания; тимулирование лактации.

особенности строения сосково-аресларного комплекса, лечение и профилантика лактостаза, мастит, трещины согояв; поддержание и сохранение лактации в овремя непродолжительного отказа от етсетсвенного вкаралинавания; стимулирование лактации. Противоложазния к использованию: местные болезни кожи, кровоточащий сосок, повышенная чувствительность груди. Побочные действия: отсутствуют. Зксляуатационные ограничения: отсутствуют. Зксляуатационные ограничения: отсутствуют. Меры предострожность:

— не использовать молюкоотсос при наличии на привалочной поверхности резервуара механический повреждений;

— не использовать молокоотсос при наличии на привалочной поверхности резервуара механический повреждений;

— не допускать болевых оцущений при использовании. Использование изделия: перед применением проконсультироваться со пециалистом (врачом). Перед применением баллон и резервуар дезинфицируют кипачения в ристиллированной воде в течение 3015 минут. Изделие, погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинается с момента закилания воды Молокогосс собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона. Перед использованием молокогосоа трау в отверстие баллона. Перед использованием молокогосоа грау в мамилания воды Молокогосс собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона. Перед использованием молокогосоа (такать трау и применты в применный в применный применный выделжения рука отверства с технавание молоко трое отверствующей в разминаю применный прим

Материал резервуара - стекло.

Условия хранения: изделие должно храниться в упакованном виде в помещении, при температуре от 45 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80°s при 25°C. Изделие не должно подвергаться воздействию примых солнечных лучей.

соянечных лучей.

Утипизация: при использовании в домашних условиях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов — подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами (могу быть вывезены на полигон ТКО). Перед утилизацией изделие очистить, продезинфицировать. Производитель: 000 «Альпина Пласт». Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, к.За, стр. 1036. Тел. +7 (495) 787-93-66. аlpma⊚alpma-plast.ru

Молокоотсос ручной по ТУ 32.50.50-031-17707123-2017. Регистрационное удостоверение № РЭН 2018/7359 от 15.07.2020. Не подлежит обязательному подтверждению соотвествия в РФС Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня получения потреб Гарантийный срок зранения — 5 лет с даты изготовления. Срок годносты/службы — не установления.

Дистрибьютор в Республике Беларусь: 000 «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

www.alpina-plast.ru

молокоотсос


СО СТЕКЛЯННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ







APT. 2020011022



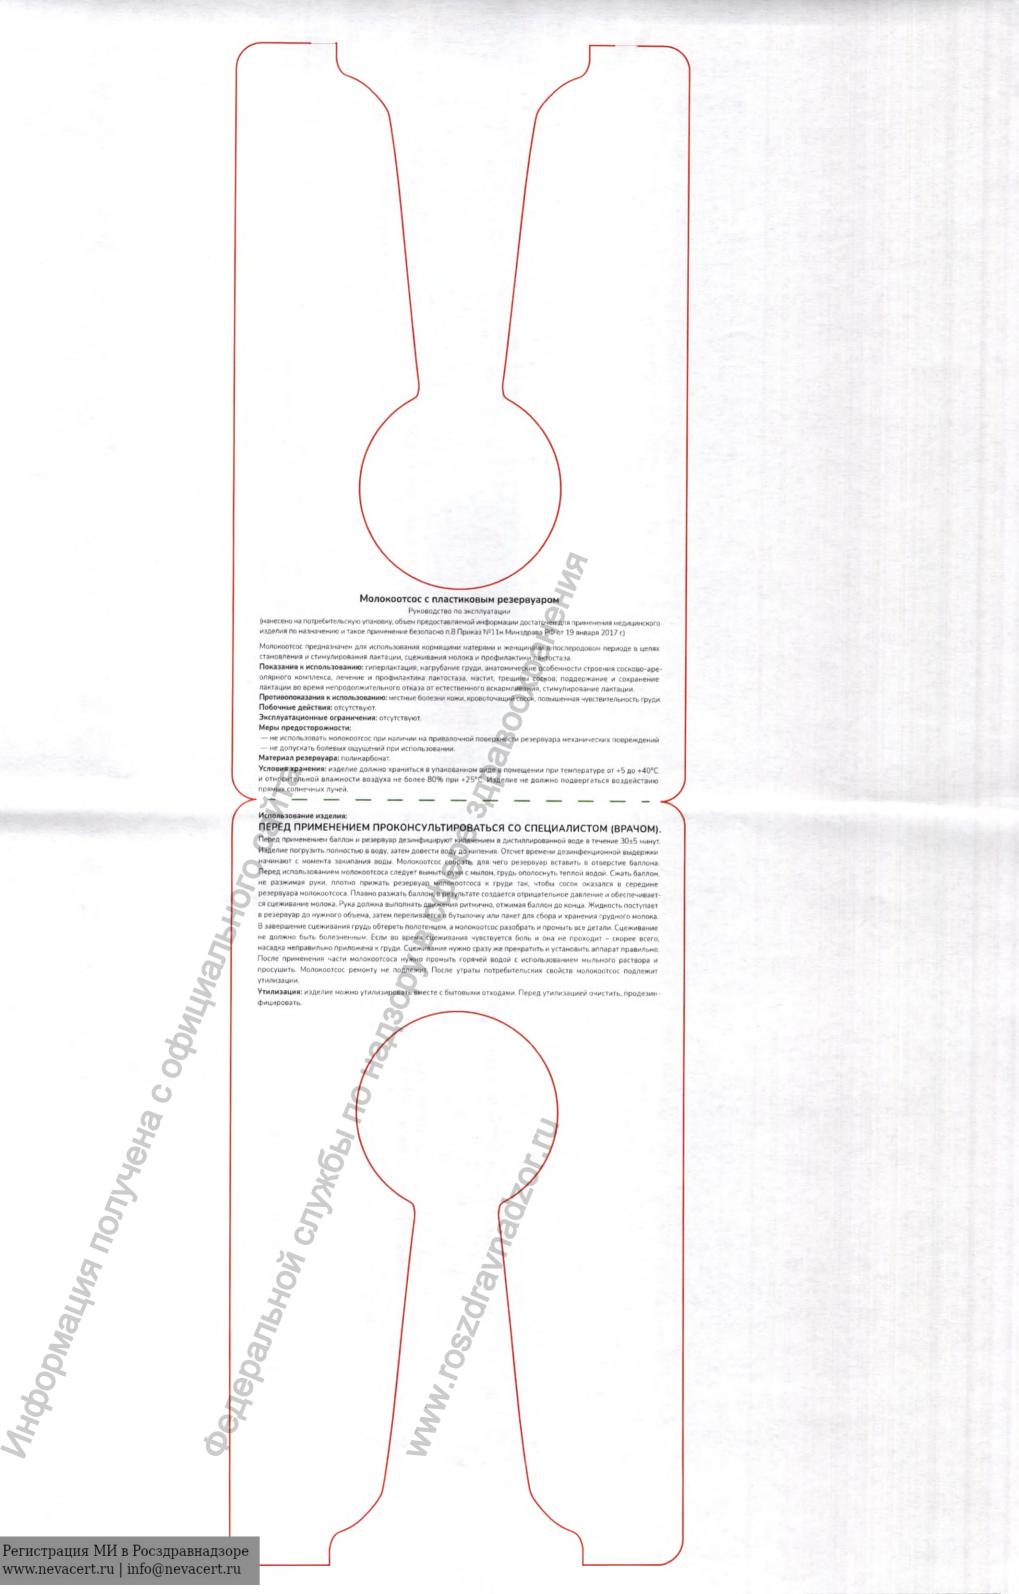

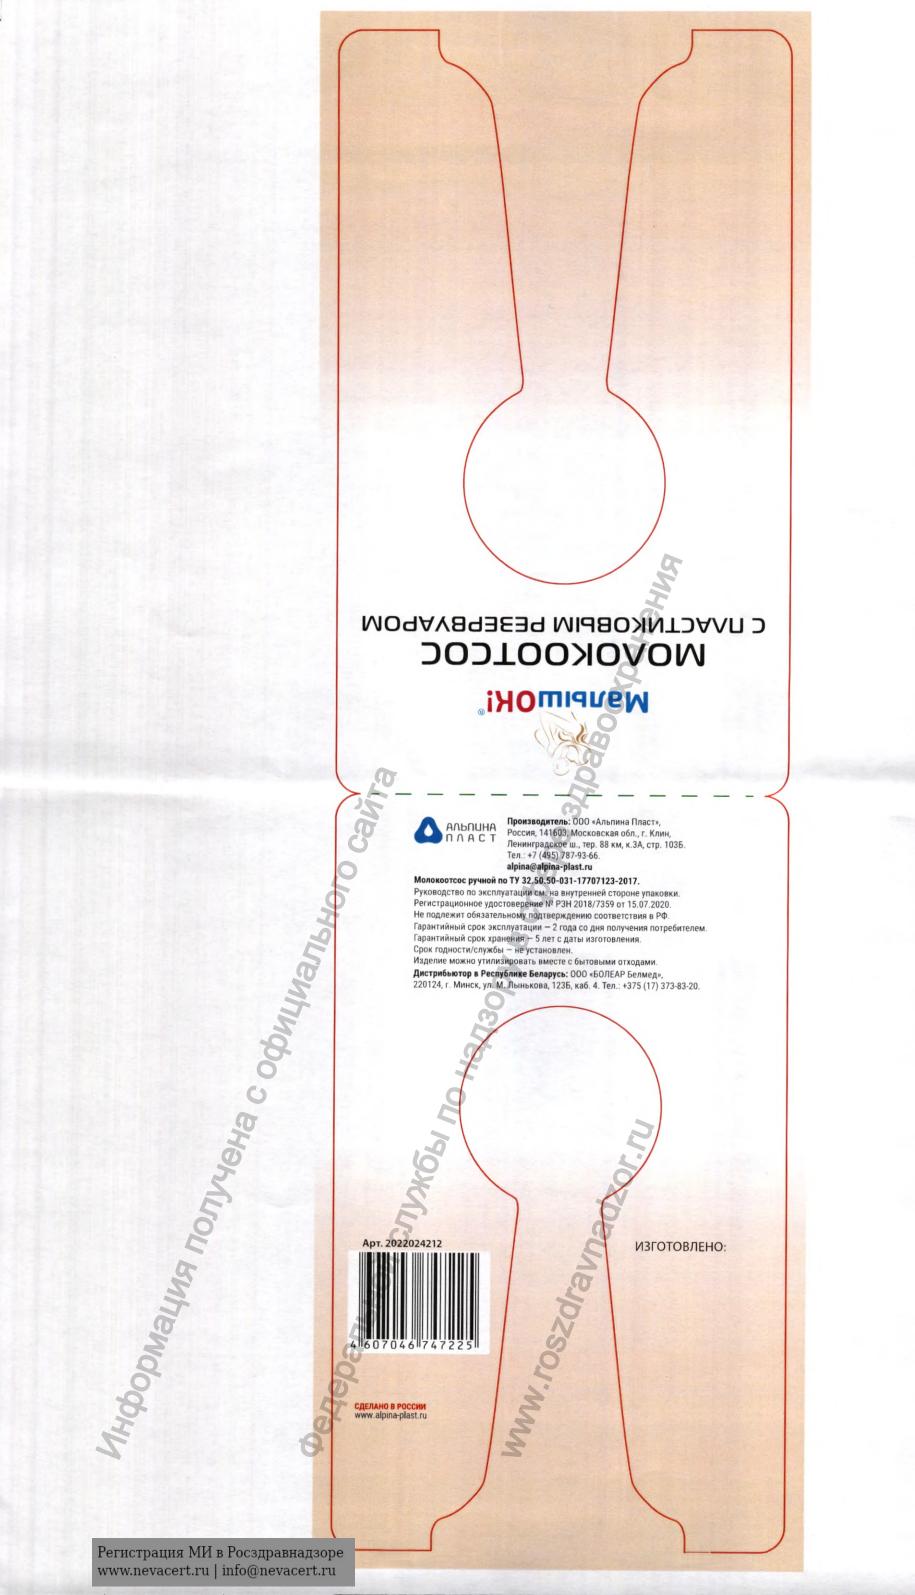

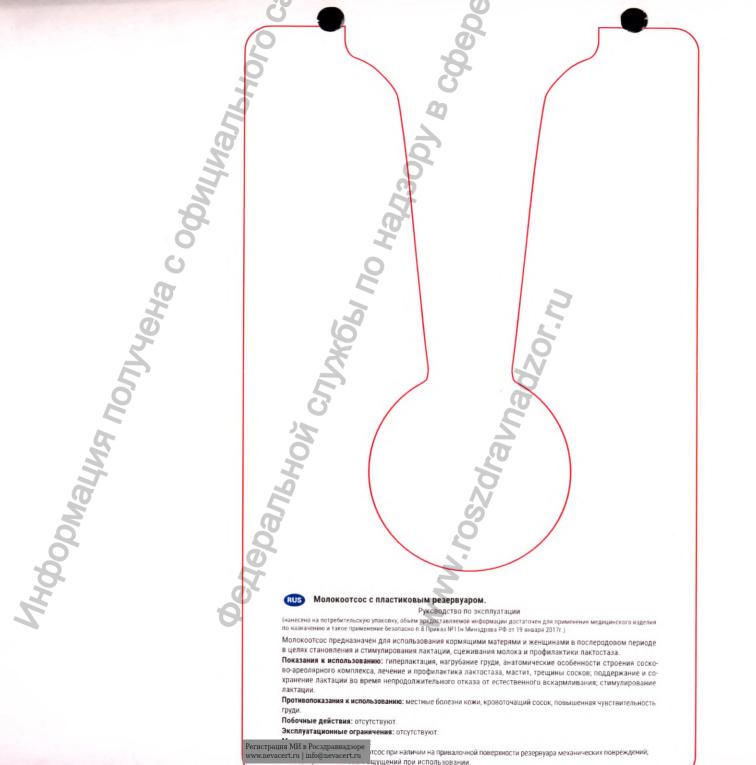

использование изделия: перед применением проконсультироваться со специалистом (врачом). Перед применением баллон и резервуар дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. Изделие погрузить полностью в воду, затем довести воду до кипения. Отсчет времени дезинфекционной выдержки начинается с момента закипания воды. Молокоотсос собрать, для чего резервуар вставить в отверстие баллона. Перед использованием молокоотсоса следует вымыть руки с мылом, грудь ополоснуть теплой водой. Сжать баллон, не разжимая руки плотно прижать резервуар молокоотсоса к груди так, чтобы сосок оказался в середине резервуара молокоотсоса. Плавно разжать баллон, в результате создается отрицательное давление и обеспечивается сцеживание молока. Рука должна выполнять движения ритмично, отжимая баллон до конца. Жидкость поступает в резервуар до нужного объема, затем переливается в бутылочку или лакет для сбора и хранения грудного молока. В завершение сцеживания грудь обтереть полотенцем, молокоотсос разобрать и промыть все детали. Сцеживание не должно быть болезненным. Если во время сцеживания чувствуется боль и она не проходит — скорее всего, насадка неправильно приложена к груди. Сцеживание сразу же нужно прекратить и установить аппарат правильно. После применения части молокоотсоса нужно промыть горячей водой с использованием мыльного раствора и просушить. Молокоотсос ремонту не подлежит. После утраты потребительских свойств молокоотсос подлежит утилизации. Условия хранения: изделие должно храниться в упакованном виде в помещении, при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Утилизация: при использовании в домашних условиях, изделие, потерявшее потребительские свойства, подлежит утилизации по классу А (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов — подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами (могут быть вывезены на полигон ТКО). Перед утилизацией изделие очистить, продезинфици-Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

