

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)


Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Вариант 1. Комплектация 1



Внешний вид (комплектаций по ГД-1344/03211) набора реактивов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 2

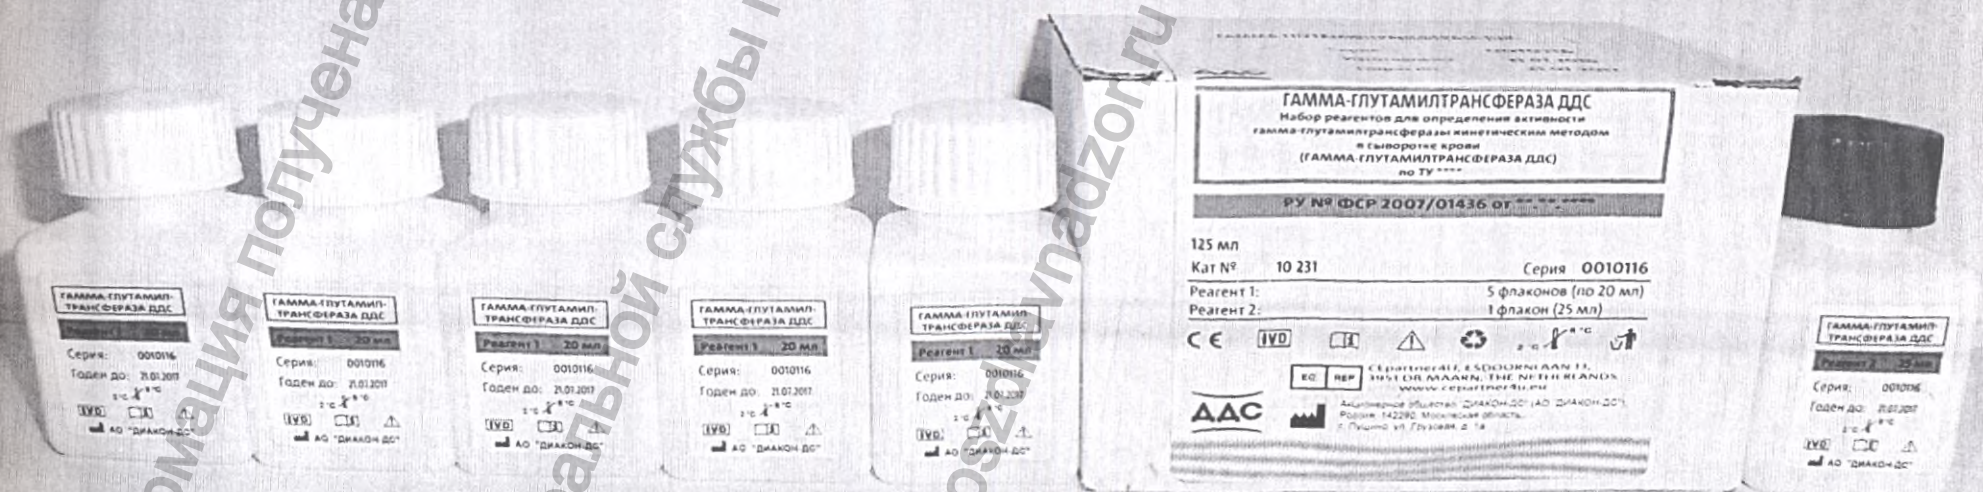

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
[www.gosnadzorg.ru](http://www.gosnadzorg.ru)

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 3



Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)


набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

лекция 4




Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)  
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 5

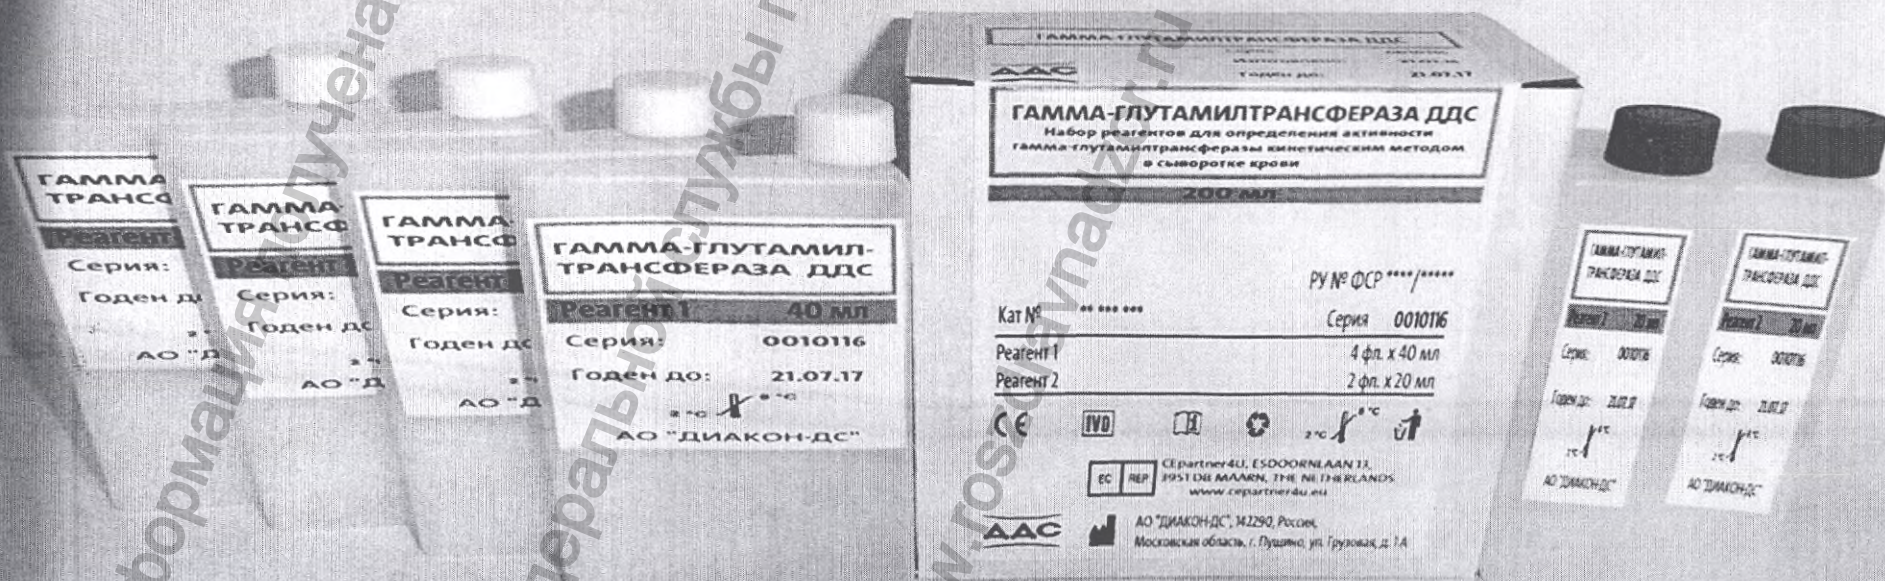

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)  
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 6

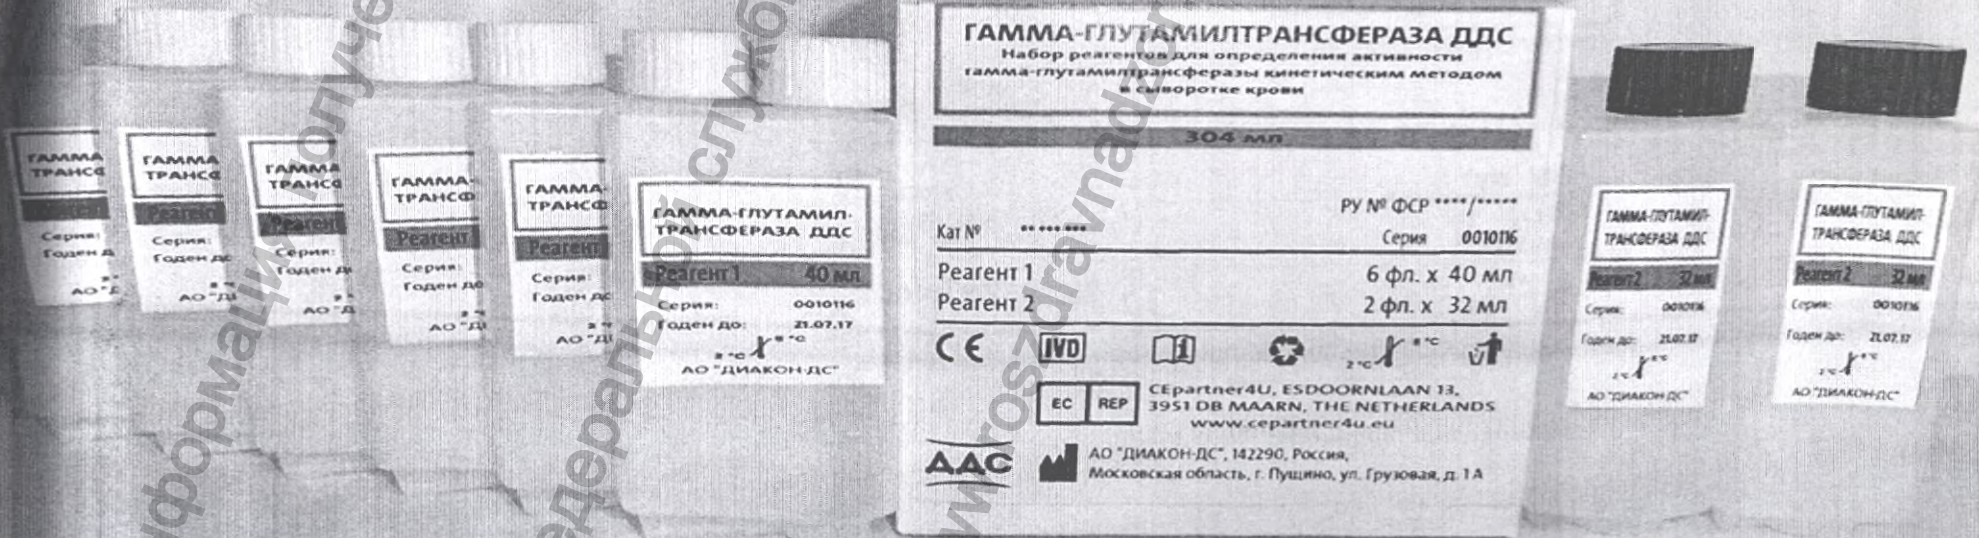

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 7

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС

Реагент 1 68 мл

Серия: 0010116

Годен до: 21.07.17

2°C 8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС

Реагент 1 68 мл

Серия: 0010116

Годен до: 21.07.17

2°C 8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС

Набор реагентов для определения активности  
гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом  
в сыворотке крови

170 мл

РУ № ФСР \*\*\*\*/\*\*\*\*\*

Кат № \*\*\*\*\*

Серия 0010116

Реагент 1 2 фл. x 68 мл

Реагент 2 2 фл. x 17 мл

CE IVD I E 2°C 8°C

ЕС REP СЕpartner4U, ES000RNLAAN 13,  
3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS  
www.сеpartner4u.eu

ДАС

АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,  
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА

Серия: 001

Годен до: 21.07.17

2°C 8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА

Серия: 001

Годен до: 21.07.17

2°C 8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)  
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 8





Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)  
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 9

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС

Реагент 1 64 мл

Серия: 0010116

Годен до: 21.07.17

2 °C

АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС

Реагент 1 64 мл

Серия: 0010116

Годен до: 21.07.17

2 °C

АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС

Набор реагентов для определения активности  
гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом  
в сыворотке крови

1000 ml

РУ № ОСР \*\*\*\*/\*\*\*\*\*

Кат № \*\* \*\* \*

Серия 0010116

Реагент 1 2 фл. х 64 мл

Реагент 2 2 фл. х 20 мл

CE IVD

EC REP

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,  
3951 DB MAAKRE, THE NETHERLANDS  
www.cepartner4u.eu

ДАС

АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,  
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовик, д. 1А

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС

Реагент 2 20 мл

Серия: 0010116

Годен до: 21.07.17

2 °C

АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)  
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 10



ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС  
Реагент 1 64 мл  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2°C X 8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС  
Набор реагентов для определения активности  
гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом  
в сыворотке крови  
Кат № \*\*\*\*\*  
Серия 0010116  
Реагент 1 6 фл. х 64 мл  
Реагент 2 6 фл. х 20 мл  
CE IVD ISO 13485  
www.scraptlab.ru  
АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,  
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2°C X 8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"  
ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2°C X 8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"  
ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2°C X 8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"  
ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2°C X 8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"  
ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2°C X 8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"

Информация

получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

www.gostprav.ru

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)  
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 11

**ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
Реагент 1 65 мл  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2 °C  
АО "ДИАКОН-ДС"

**ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
Реагент 2 65 мл  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2 °C  
АО "ДИАКОН-ДС"

**ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
Кат № ...  
Серия 0010116  
Реагент 1 2 фл. х 65 мл  
Реагент 2 2 фл. х 20 мл  
CE IVD  
CE partner4U, ES DOORNLAAN 11, 1951 DH MAAK, THE NETHERLANDS  
www.cepartner4u.eu  
АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская область, с. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

**ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
Реагент 1 20 мл  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2 °C  
АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)


Комплектация 12



Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 13

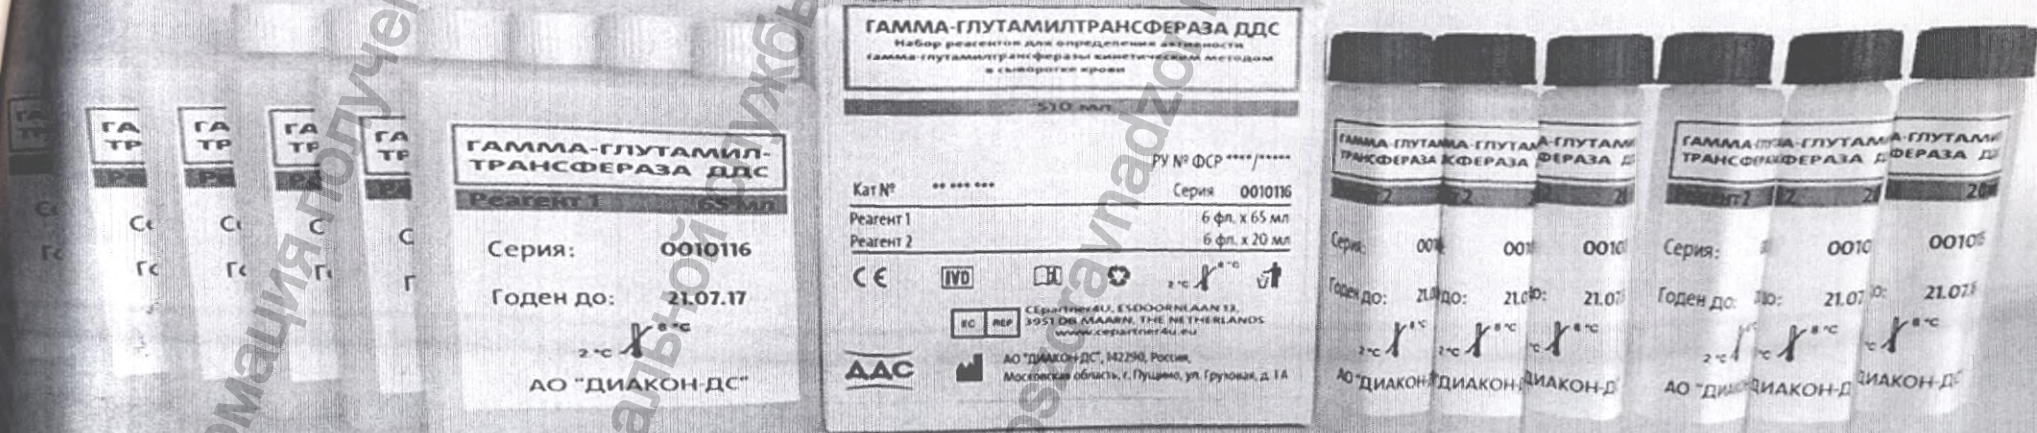

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 14



Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 15



Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере  
www.goszdrnadzor.ru

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 16



Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере  
www.goszdraznadzor.ru



Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)  
 Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
 (ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 17



**ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
 Набор реагентов для определения активности  
 гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом  
 в сыворотке крови

120 мл

РУ № ФСР \*\*\*\*/\*\*\*\*\*

Кат № \*\* \*\*\* \*\* Серия 0010116

Реагент 1 6 фл. x 16 мл  
 Реагент 2 6 фл. x 4,0 мл

CE IVD IA 2°C 37°C

EC REP CE partner A1, ES-DOORNLAAN 1E,  
 3951 DR MAARN, THE NETHERLANDS  
 www.cerattier.nl

**ДАС** АО "ДИАКОН ДС", 143290, Россия,  
 Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС  
 16 мл РЕАГЕНТ 1  
 0010116 Серия:  
 21.07.17 Годен до:

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС  
 16 мл РЕАГЕНТ 2  
 0010116 Серия:  
 21.07.17 Годен до:

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС  
 16 мл РЕАГЕНТ 1  
 0010116 Серия:  
 21.07.17 Годен до:

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС  
 16 мл РЕАГЕНТ 2  
 0010116 Серия:  
 21.07.17 Годен до:

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС  
 16 мл РЕАГЕНТ 1  
 0010116 Серия:  
 21.07.17 Годен до:

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС  
 16 мл РЕАГЕНТ 2  
 0010116 Серия:  
 21.07.17 Годен до:

Информация получена с официального сайта  
 Федеральной службы по надзору в сфере  
 www.gosz.ru

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 18

ГАМ ТРА	ГАМ ТРА	ГАМ ТРА	ГАММА-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реаг	Реаг	Реаг	Реагент 1 62 мл
Сер	Сер	Сер	Серия: 0010116
Год	Год	Год	Годен до: 21.07.17
A	AC	AC	2°C 8°C АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС  
Набор реагентов для определения активности  
гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом  
в сыворотке крови

320 мл

ПУ № ФСР \*\*\*\*/\*\*\*\*\*  
Серия 0010116

Кат № \*\* \*\*\*\*

Реагент 1 4 фл. х 62 мл  
Реагент 2 4 фл. х 18 мл

CE IVD

EC REP CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,  
3951 DB MAAKN, THE NETHERLANDS  
www.cepartner4u.eu

ААС АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,  
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

ГАММА-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА ДДС	ГАММА-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА ДДС	ГАММА-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА ДДС	ГАММА-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реагент 2 18 мл	Реагент 2 18 мл	Реагент 2 18 мл	Реагент 2 18 мл
Серия: 0010116	Серия: 0010116	Серия: 0010116	Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17	Годен до: 21.07.17	Годен до: 21.07.17	Годен до: 21.07.17
2°C 8°C АО "ДИАКОН-ДС"	2°C 8°C АО "ДИАКОН-ДС"	2°C 8°C АО "ДИАКОН-ДС"	2°C 8°C АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)



Комплектация 19



Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)


Комплектация 20

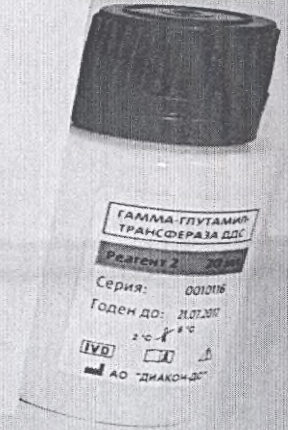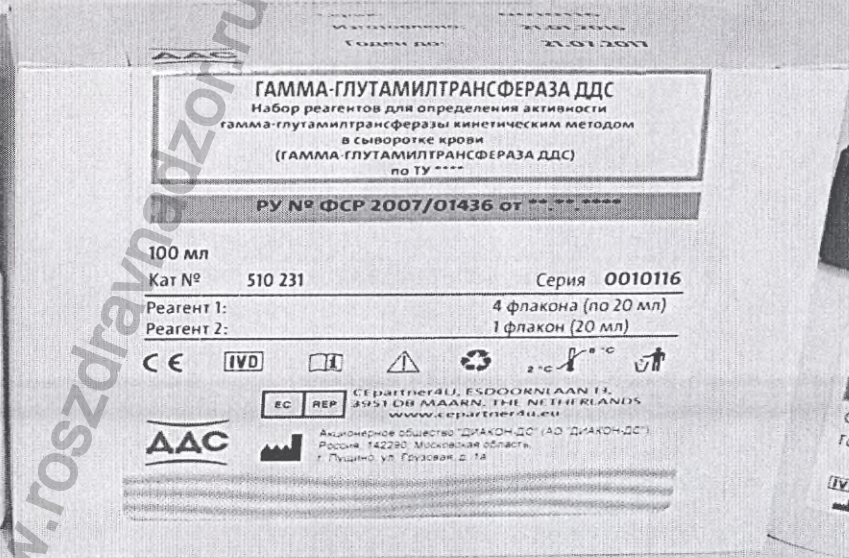

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 21

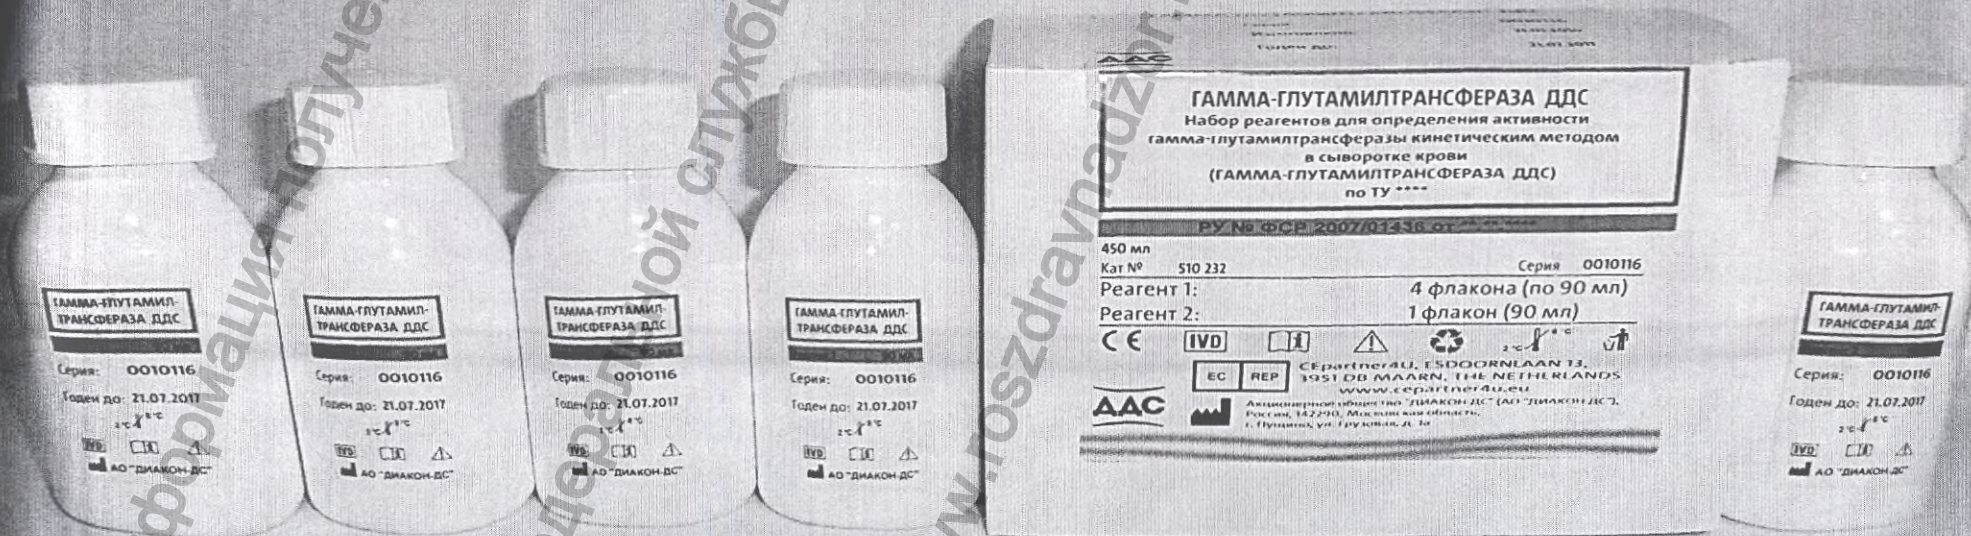

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 22



Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)




Комплектация 23



Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 24

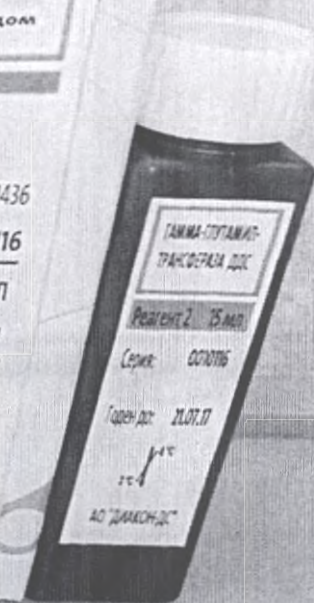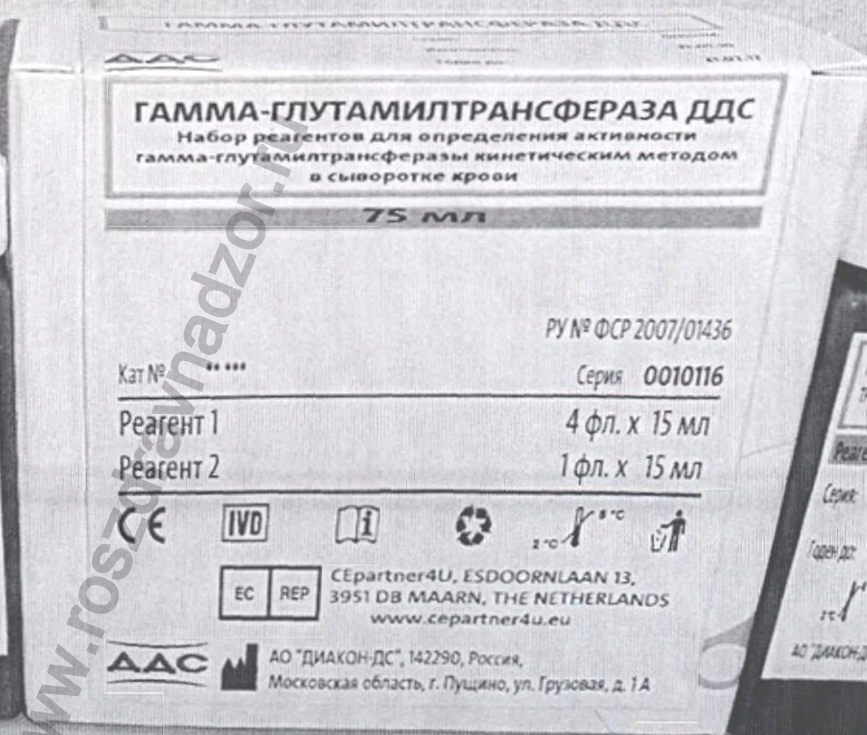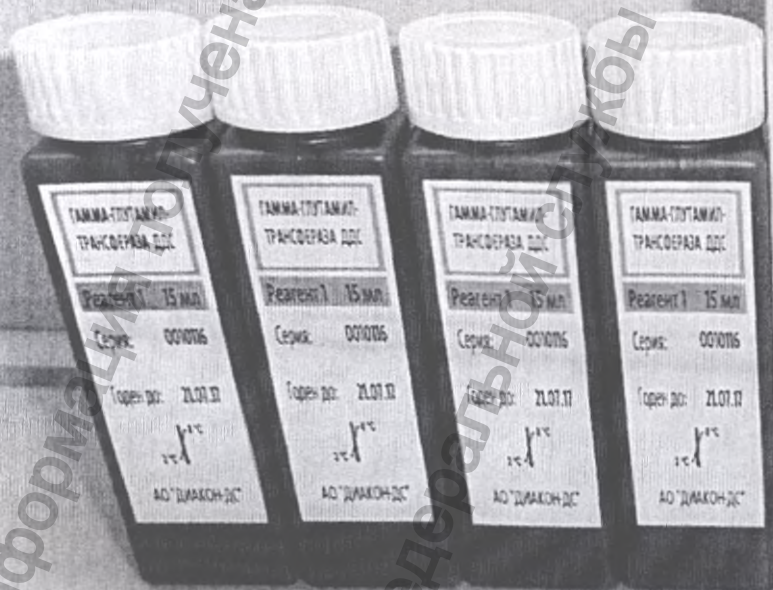



Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

ия 25

**ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
10000 мл  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2°C  $\rightarrow$  8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"


**ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
Серия: 0010116  
Классификация: Л.Р.В  
ААС  
Годен до: 21.07.17  
**ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
Индикатор активности для кинетического определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом  
В лабораторной практике  
RU № 0217  
Классификация: Л.Р.В  
Реагент 1: 1 л 10000 мл  
Реагент 2: 1 л 2500 мл  
CE, ISO 9001, ISO 13485  
АО "ДИАКОН-ДС" КОММУНАЛЬНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СИСТЕМ  
АО "ДИАКОН-ДС" ИСТОЧНИК  
Иркутская область, г. Улан-Удэ, ул. Сурганова, д. 71Б

**ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 25

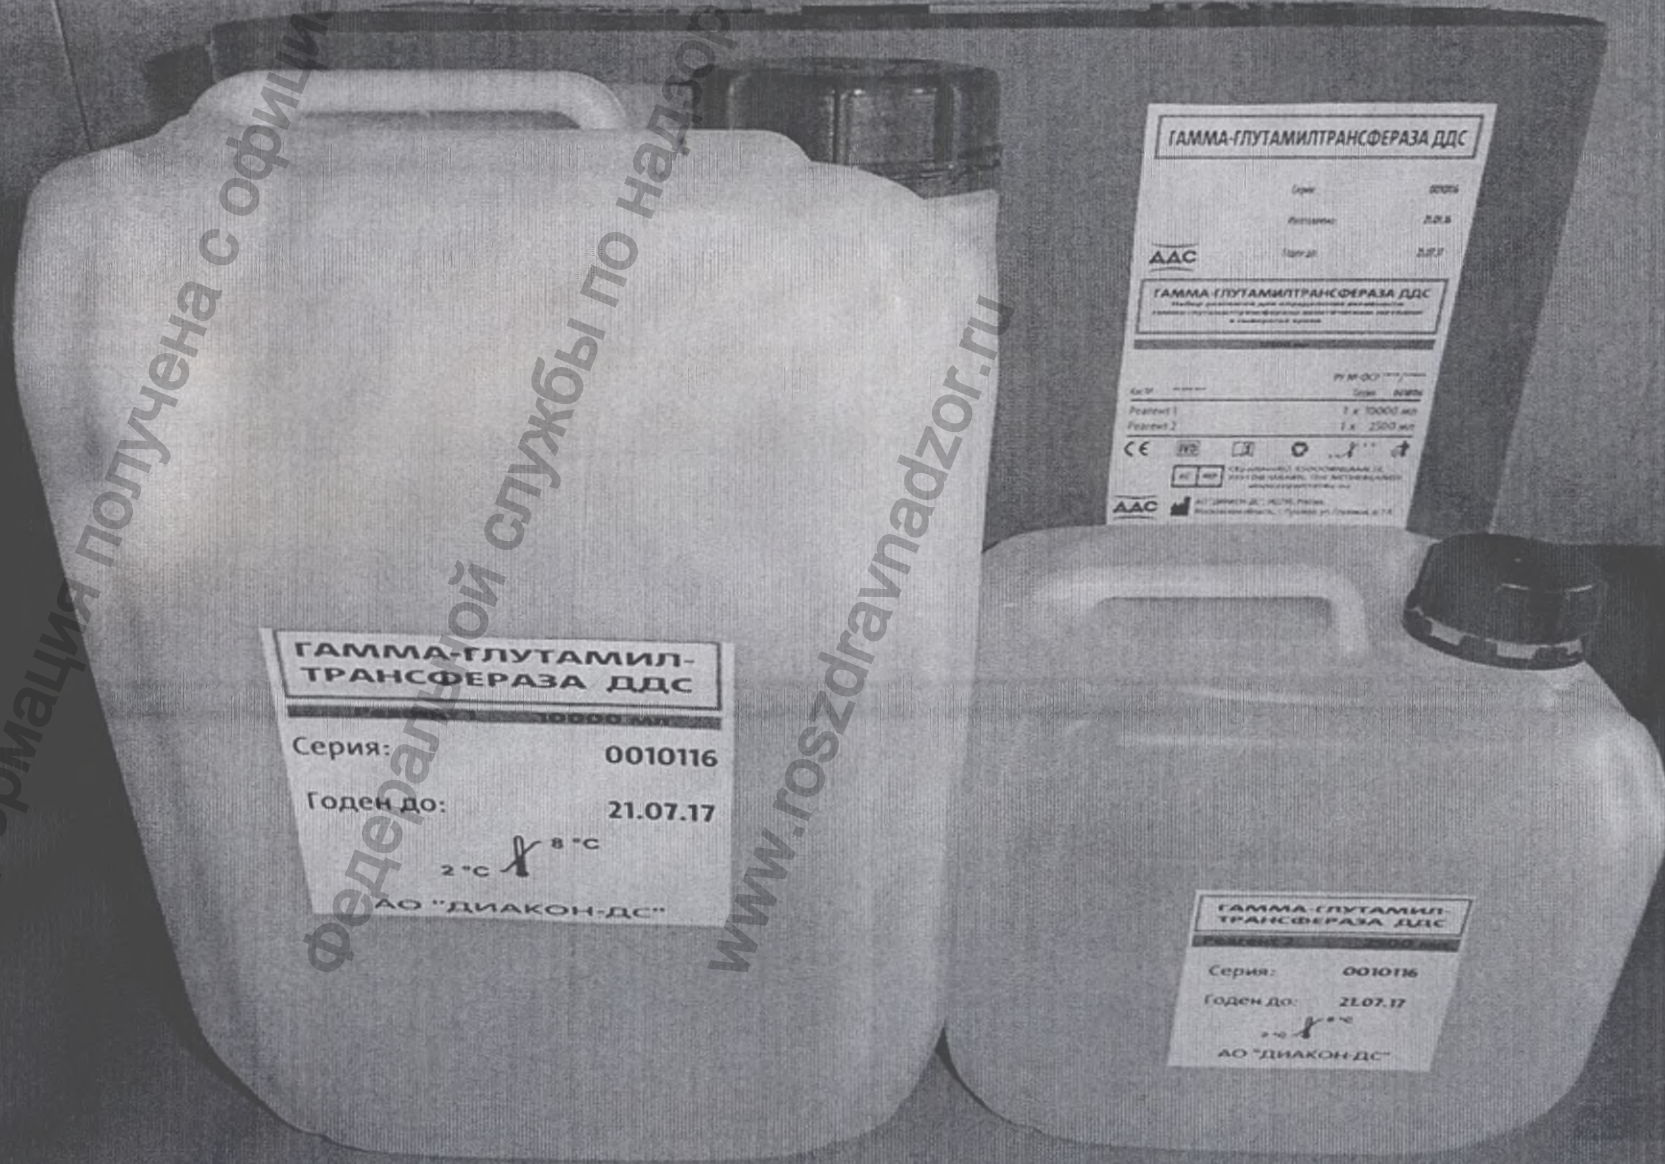

**ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2-8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"

**ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
Серия: 0010116  
Вместимость: 2,0 л  
Объем: 2,0 л  
**ААС**  
**ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
Метод определения активности фермента  
Гамма-глутамилтрансфераза (код фермента по ИЮПАК: 2.3.1.10)  
в сыворотке крови  
РД-15444/85241  
Кат. №: 0010116  
Объем: 2,0 л  
Реагент 1: 1 x 10000 мл  
Реагент 2: 1 x 2500 мл  
CE, ISO, GOST, GOST R, GOST ISO, GOST ISO 9001, GOST ISO 14001, GOST ISO 45001  
АО "ДИАКОН-ДС", 125190, Москва, Россия  
www.diacon-ds.ru

**ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2-8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"

Информация получена с официальной службы по надзору в сфере  
Федеральной службы по надзору в сфере  
www.goszdravnadzor.ru

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере  
[www.roszdravnadzor.ru](http://www.roszdravnadzor.ru)

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 25




Генеральный директор  
АО «ДИАКОН-ДС»



 Т.Ю. Корзун


Внешний вид  
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 26

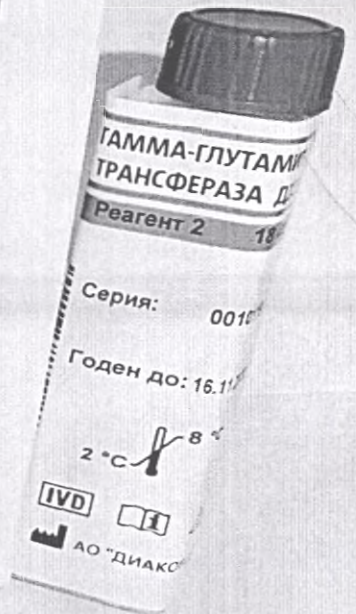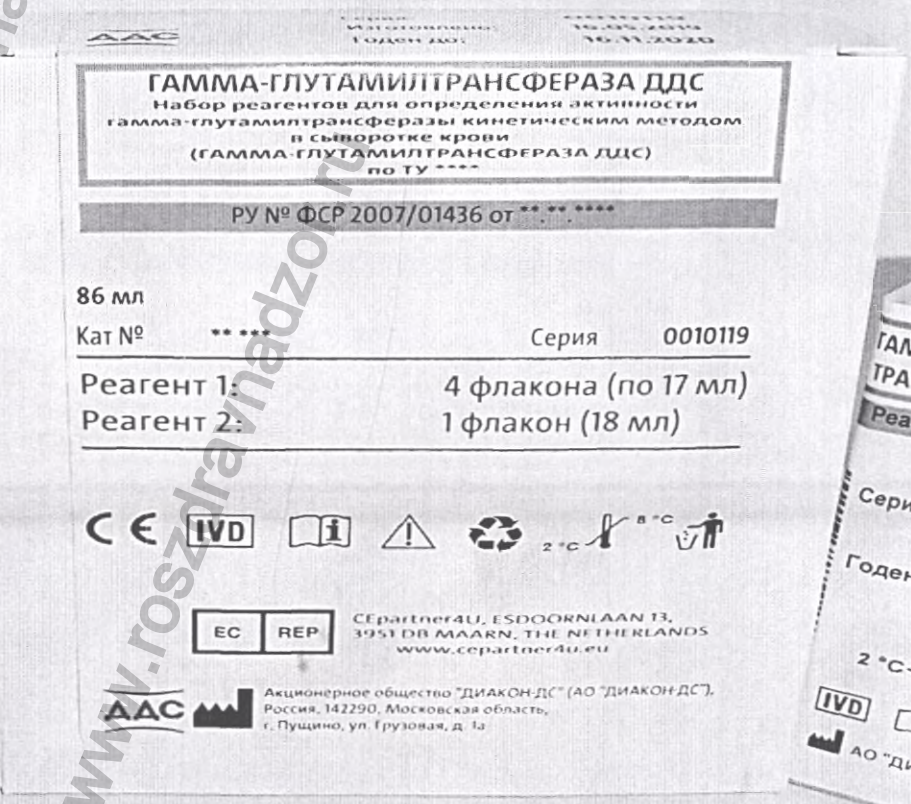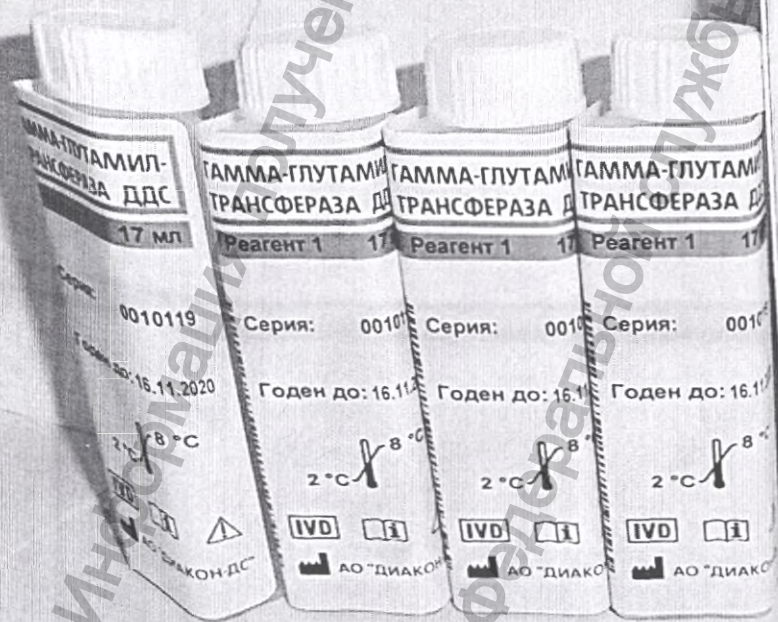


Внешний вид  
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 27

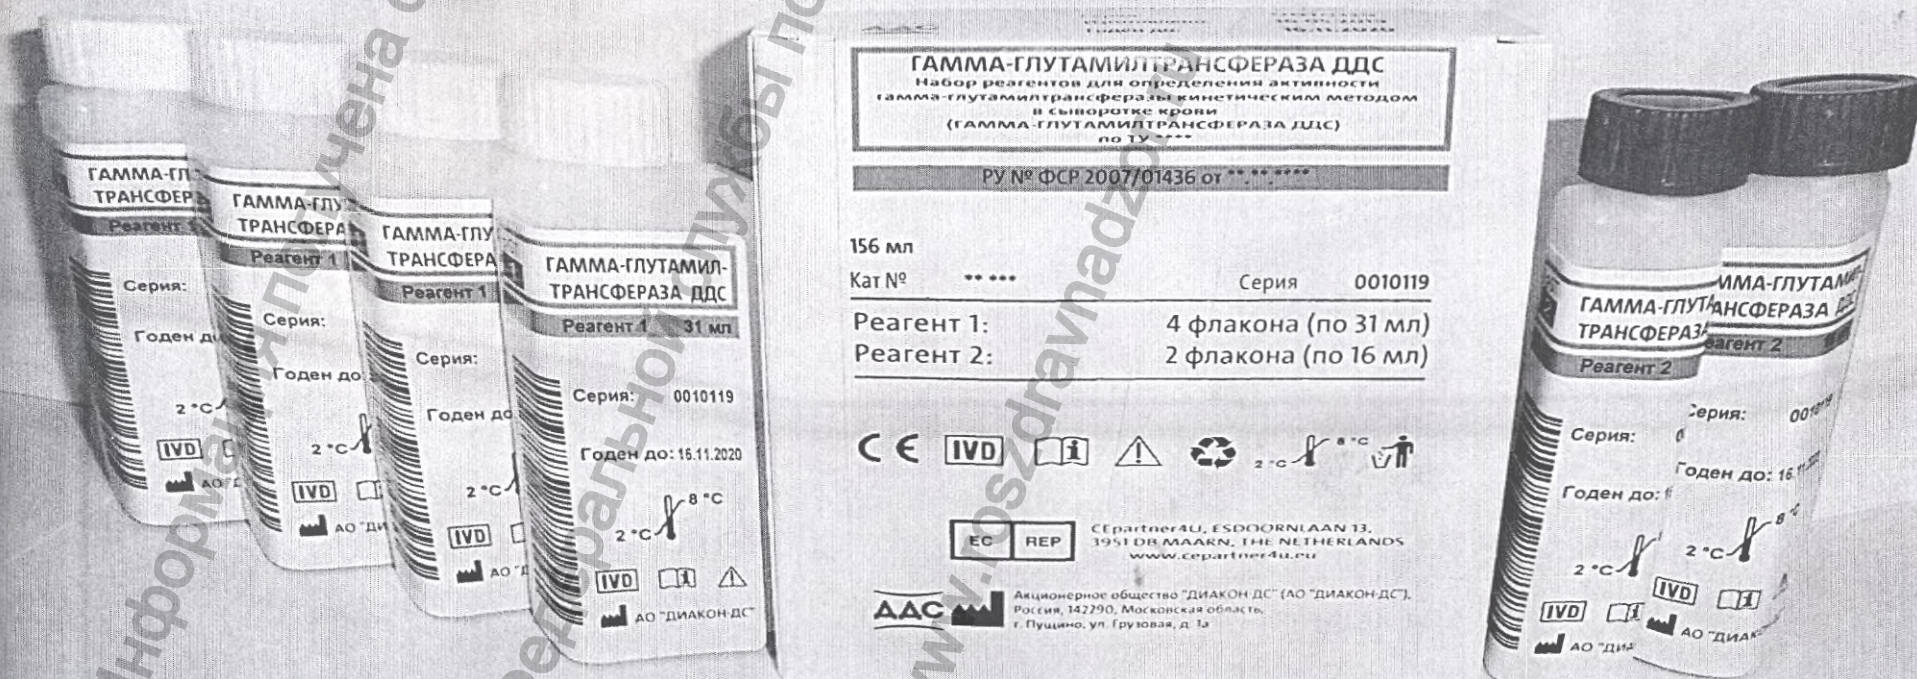

Внешний вид  
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)  
Комплектация 1

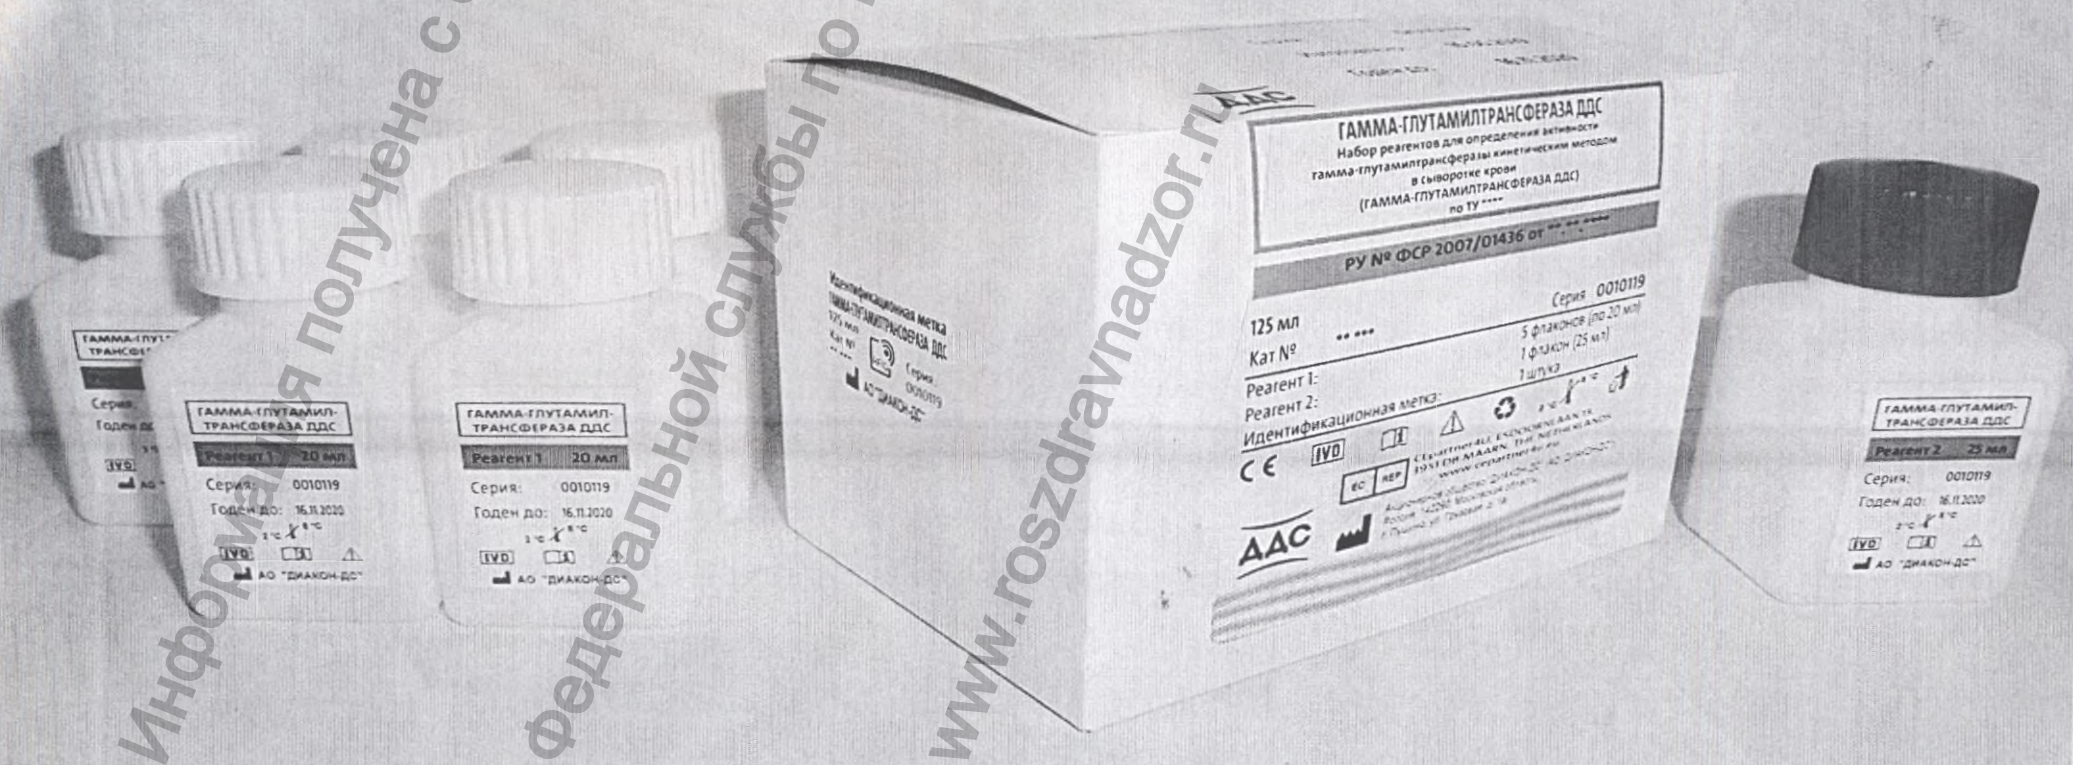


Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере

www.goszdravnadzor.ru

Внешний вид  
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

2, Комплектация 2

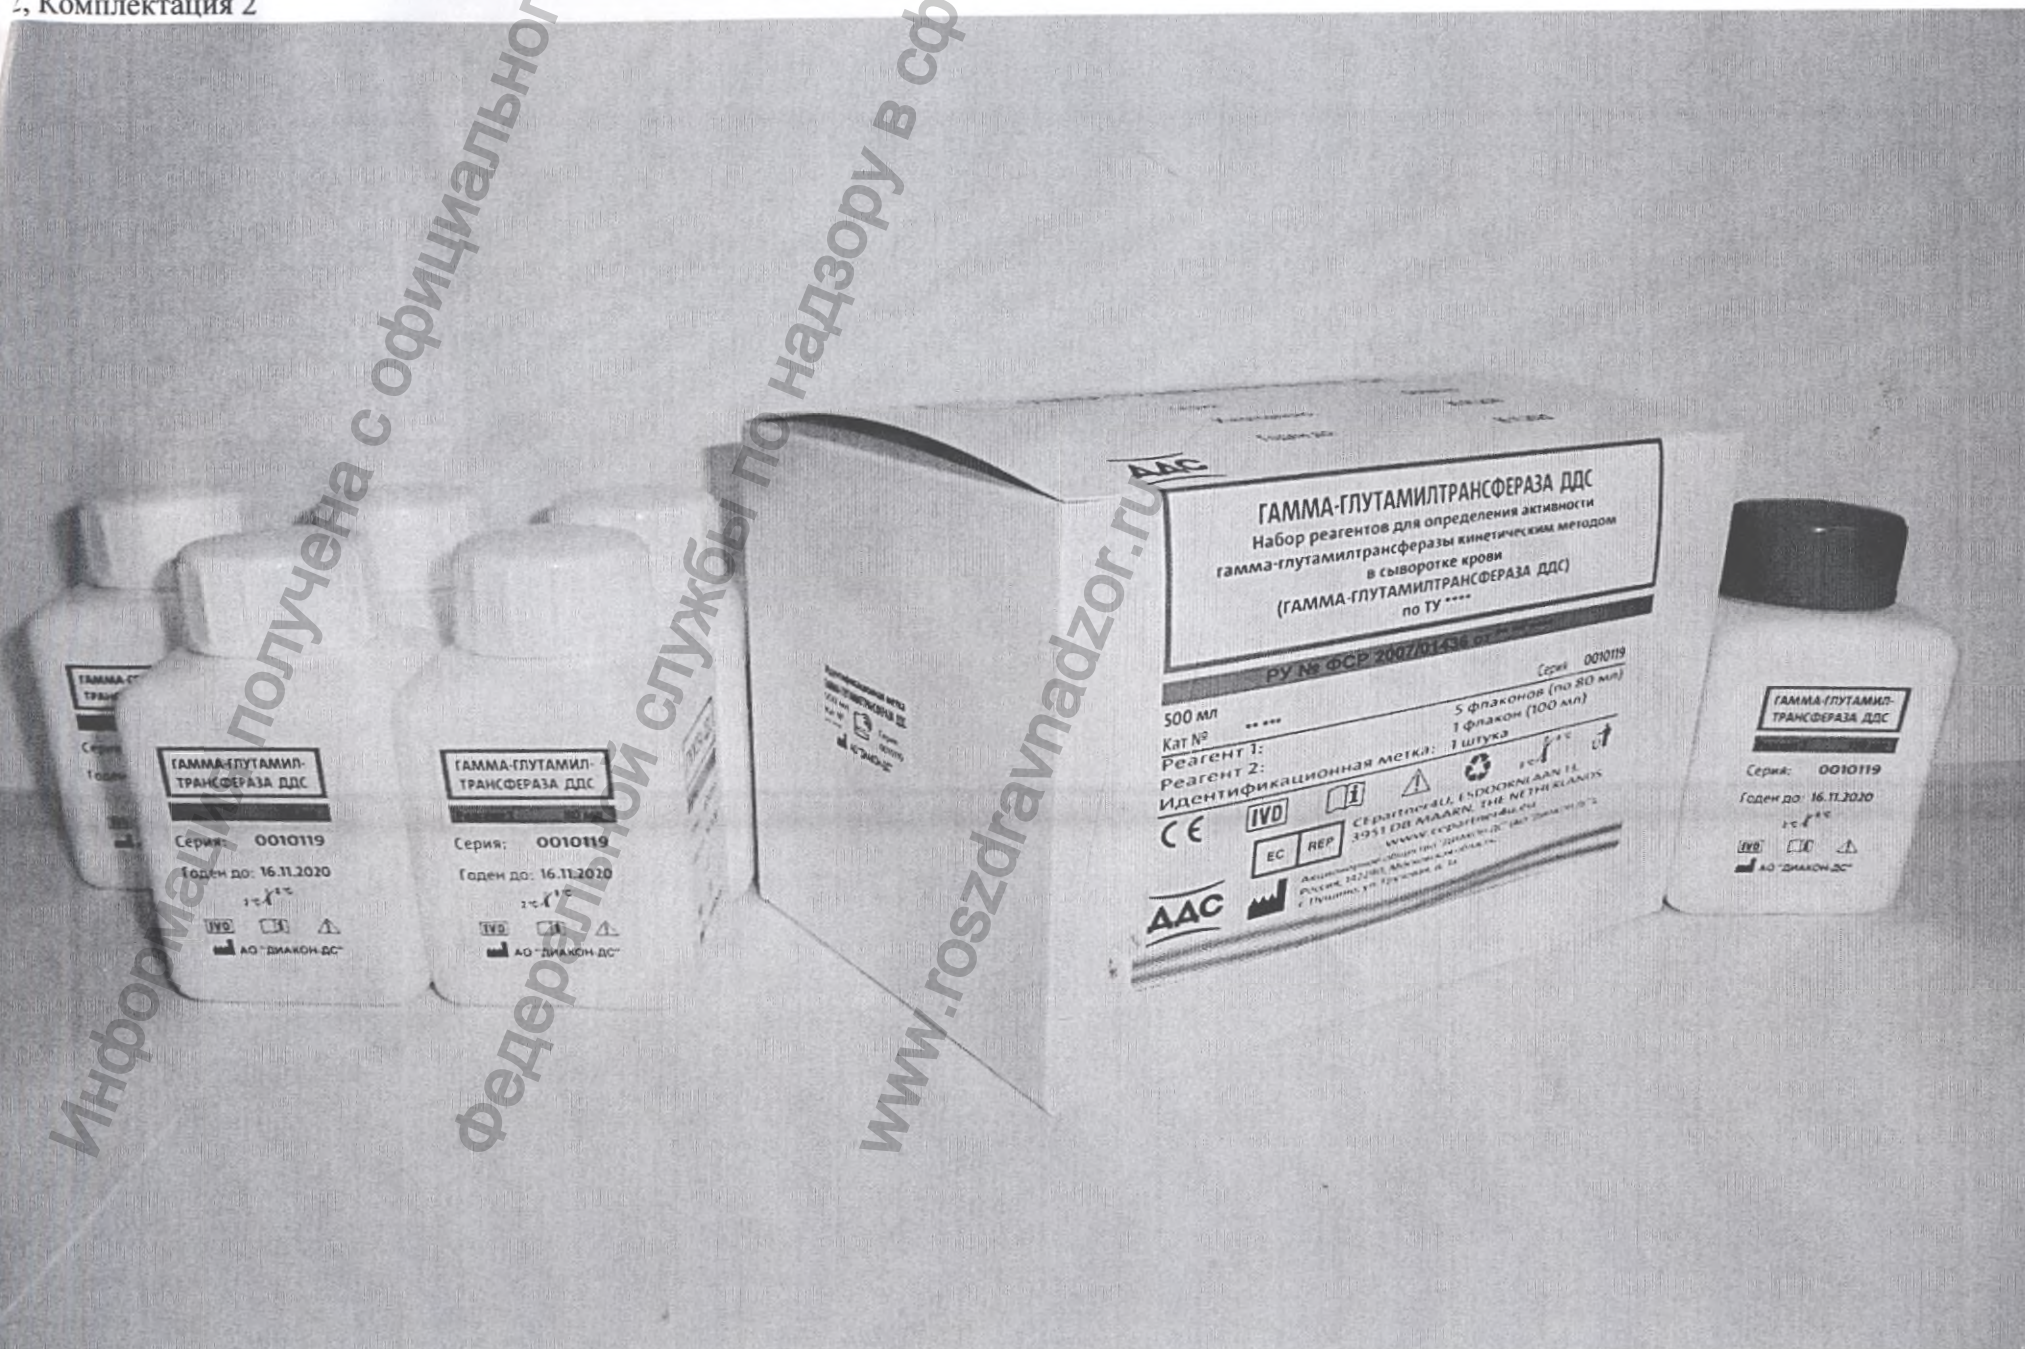

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере

www.goszdramnadzor.ru

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере  
[www.roszdravnadzor.ru](http://www.roszdravnadzor.ru)

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 4

Генеральный директор  
АО «ДИАКОН-ДС»



  
Т.Ю. Корзун