



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ З
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DE
CONTROL

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
REGISTRATION CERTIFICATE**

№ ФСЗ 2007/00210

от 17 августа 2007 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано
ЗАО "АМТЕО М", Россия,
111539, Москва, ул. Вешняковская, д. 23, корп. 4, пом. 1
и подтверждает, что изделие медицинского назначения
Реагенты для иммуногистохимических исследований
(см. Приложение на 9 листах)
производства
"Дако Денмарк А/С", Дания,
Dako Denmark A/S, Produktionsvej 42, DK-2600 Glostrup, Denmark

класс потенциального риска 1

ОКП 93 9817

соответствующее комплекту регистрационной документации


КРД № 21676 от 06.07.2007

приказом Росздравнадзора от 17 августа 2007 года № 2332-Пр/07

разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Н.В. Юргель

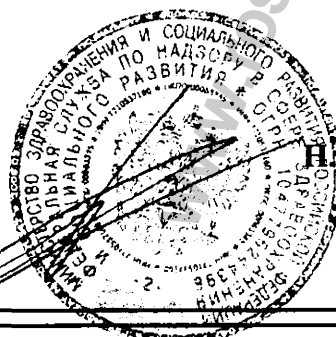

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.gosdrazhnadzor.ru

№ 0575 *

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
ATTACHMENT**

Лист 1

№ ФСЗ 2007/00210

1. ДНК зонды CCND1 ФИШ, Сплит-Сигнал 20 тестов, 0.2мл, CCND1 FISH DNA Probe, Split Signal 20 tests, 0.2mL.
2. С-Пептид 96 лунок, C-Peptide 96 wells.
3. ДНК зонды ETV6 ФИШ, Сплит-Сигнал 20 тестов, 0.2мл, ETV6 FISH DNA Probe, Split Signal 20 tests, 0.2mL.
4. Авидин/ПХ 1мл, Avidin/HRP 1mL.
5. ДНК зонды ALK ФИШ, Сплит-Сигнал 20 тестов, 0.2мл, ALK FISH DNA Probe, Split Signal 20 tests, 0.2mL.
6. Белок мочи Калибратор / Контроль Высокого Уровня / Контроль Низкого Уровня 1мл, Human Urine Protein Calibrator / High Control / Low Control 1mL
7. Бета-2-Микроглобулин Пет Кит 80-150 тестов, Beta-2-Microglobulin PET Kit 80-150 tests.
8. Буфер для разведения 1 Дако Турбидиметрия/Нефелометрия 1л, Dako Turbidimetry/Nephelometry Dilution Buffer 1 1L.
9. Буфер для реакций 1/2/3/4/7/8/9 Дако Турбидиметрия/Нефелометрия 1л, 100мл, Dako Turbidimetry/Nephelometry Reaction Buffer 1/2/3/4/7/8/9 1L, 100 mL.
10. Буфер промывочный для спецокраски, Концентрированный x 10 1л, Special Stains Wash Buffer, Concentrated x 10 1L.
11. Буфер промывочный, Концентрированный x 10 1л, Wash Buffer, Concentrated x 10 1L.
12. Буфер фосфатно-солевой (PBS), pH 7.0 6x1 л, Phosphate-Buffered Saline (PBS), pH 7.0 6 x 1L.
13. Вода PuraFlo™ ASTM Тип 1-A 20л уп., PuraFlo™ ASTM Type 1-A Water 20L box.
14. Гематоксилин / Гематоксилин Майера для ручного использования / для использования в Автостейнере Дако 500мл, Hematoxylin / Hematoxylin Mayer's for Manual Use / for the Dako Autostainer 500mL.
15. Гематоксилин Дако REAL™ 500мл, Dako REAL™ Hematoxylin 500mL.
16. Дако ТМБ+ 100мл, 500 мл, 1л, Dako TMB+ 100mL, 500mL, 1L.
17. Держатель предметных стекол Дако REAL™ 1 шт., Dako REAL™ Slide Holder 1 unit.
18. ДНК зонды FIP1L1-PDGFR A ФИШ, сигнал субделеции 20 тестов, 0.2мл, FIP1L1-PDGFR A FISH DNA Probe, Sub-Deletion Signal 20 tests, 0.2mL.
19. ДНК зонды MALT1 ФИШ, Сплит-Сигнал 20 тестов, 0.2мл, MALT1 FISH DNA Probe, Split Signal 20 tests, 0.2mL.
20. ДНК зонды MLL ФИШ, Сплит-Сигнал 20 тестов, 0.2мл, MLL FISH DNA Probe, Split Signal 20 tests, 0.2mL.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Н.В. Юргель

17 августа 2007 года


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
АТТАШМЕНТ**

Лист 2

№ ФСЗ 2007/00210

21. ДНК зонды MYC ФИШ, Сплит-Сигнал 20 тестов, 0.2мл, MYC FISH DNA Probe, Split Signal 20 tests, 0.2mL.
22. ДНК зонды PAX5 ФИШ, Сплит-Сигнал 20 тестов, 0.2мл, PAX5 FISH DNA Probe, Split Signal 20 tests, 0.2mL.
23. ДНК зонды SIL-TAL1 ФИШ, сигнал суб-делеции 20 тестов, 0.2мл, SIL-TAL1 FISH DNA Probe, Sub-Deletion Signal 20 tests, 0.2mL.
24. ДНК зонды TCF3 ФИШ, Сплит-Сигнал 20 тестов, 0.2мл, TCF3 FISH DNA Probe, Split Signal 20 tests, 0.2mL.
25. ДНК зонды TCRAD ФИШ, Сплит-Сигнал 20 тестов, 0.2мл, TCRAD FISH DNA Probe, Split Signal 20 tests, 0.2mL.
26. ДНК зонды TCRB ФИШ, Сплит-Сигнал 20 тестов, 0.2мл, TCRB FISH DNA Probe, Split Signal 20 tests, 0.2mL.
27. ДНК зонды TCRG ФИШ, Сплит-Сигнал 20 тестов, 0.2мл, TCRG FISH DNA Probe, Split Signal 20 tests, 0.2mL.
28. ДНК зонды TLX1 ФИШ, Сплит-Сигнал 20 тестов, 0.2мл, TLX1 FISH DNA Probe, Split Signal 20 tests, 0.2mL.
29. ДНК зонды TLX3 ФИШ, Сплит-Сигнал 20 тестов, 0.2мл, TLX3 FISH DNA Probe, Split Signal 20 tests, 0.2mL.
30. ДНК зонды биотинилированные GenPoint™ Вируса Папилломы Человека HPV 1мл, GenPoint™ HPV, Biotinylated DNA Probe 1mL.
31. ДНК зонды Вируса Папилломы Человека (HPV) Типы 6/11 Смешанные/Биотинилированные 50 тестов, 1мл, Human Papillomavirus (HPV) Types 6/11 DNA Probe Mix/Biotinylated 50 tests, 1mL.
32. ДНК зонды Вируса Папилломы Человека (HPV) широкий спектр Коктейль/Биотинилированные 50 тестов, 1мл, Human Papillomavirus (HPV) Wide Spectrum DNA Probe Cocktail/Biotinylated 50 tests, 1mL.
33. ДНК зонды смешанные MYC/CEN-8 ФИШ 20 тестов, 0.2мл, MYC/CEN-8 FISH Probe Mix 20 tests, 0.2mL.
34. ДНК зонды ФИШ Сплит-Сигнал IGH / IGK / IGL 20 тестов, 0.2мл, FISH DNA Probe, Split Signal IGH / IGK / IGL 20 tests, 0.2mL.
35. PNA зонды Вируса Эпштейна-Барра /Флюоресцеин (EBER) 40 тестов, 1мл, Epstein-Barr Virus (EBER) PNA Probe/Fluorescein 40 tests, 1mL.
36. Калибратор, Контроль высокого уровня, Контроль низкого уровня С-реактивный белок (чувствительный) 1мл, C-Reactive Protein Calibrator, High Control, Low Control (Sensitive) 1mL.
37. Калибратор, набор контрольных Цистатин С 1мл, 6 x 1мл, Cystatin C Calibrator, Control Set 1mL, 6 x 1mL.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

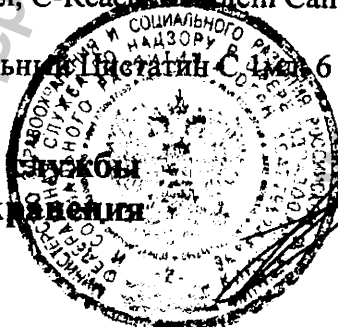

Н.В. Юргель

17 августа 2007 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
ATTACHMENT**

Лист 3

№ ФСЗ 2007/00210

38. Карандаш гидрофобный для ИГХ Дако, Dako Pen.
39. Контейнер для инкубации Дако REAL™, Dako REAL™ Incubation Container
40. Контроли для набора ИФА ЭФРр 3 x 0.5мл, EGFr ELISA Controls 3 x 0.5mL
41. Контроль отрицательный универсальный EPOS™ 80 тестов, 8мл, EPOS™ Universal Negative Control 80 tests, 8mL.
42. Контроль отрицательный, мышинные IgG1, IgG1/APC, IgG1/FITC, IgG1/RPE, IgG1/RPE-Cy5 1мл, Negative Control, Mouse IgG1, IgG1/APC, IgG1/FITC, IgG1/RPE, IgG1/RPE-Cy5 1mL.
43. Контроль отрицательный, мышинные IgG2a, IgG2a/FITC, IgG2a/RPE 1мл, Negative Control, Mouse IgG2a, IgG2a/FITC, IgG2a/RPE 1mL.
44. Контроль отрицательный, мышинные IgG2b/FITC, IgG2b/RPE 1мл, Negative Control, Mouse IgG2b/FITC, IgG2b/RPE 1mL.
45. Контроль отрицательный, мышинные IgM/FITC 1мл, Negative Control, Mouse IgM/FITC 1mL.
46. Контроль отрицательный, фракция Иммуноглобулинов кроликов (нормальная) 2мл, 10мл, Negative Control, Rabbit Immunoglobulin Fraction (Normal) 2mL, 10mL.
47. Контроль отрицательный, фракция Иммуноглобулинов кроликов (Солидная фаза) 2мл, Negative Control, Rabbit Immunoglobulin Fraction (Solid-Phase Absorbed) 2mL.
48. Краситель метиленовый зеленый 500мл, Methyl Green, Counterstain 500mL.
49. Лоток для реагентов Дако REAL™ 250 лотков, Dako REAL™ Reagent Trays 250 trays.
50. мРНК PNA зонды флуоресцентные Каппа/Lambda 40 тестов, 2 x 1мл, Каппа/Lambda mRNA PNA Probes/Fluorescein 40 tests, 2 x 1mL.
51. Набор CINtec™ p16INK4a для цитологии / для гистологии для ручного использования / для использования в Автостейнере Дако 50 тестов, CINtec™ p16INK4a Cytology Kit / Histology Kit for manual use / for Dako Autostainer 50 tests.
52. Набор c-Kit pharmDx™ для ручного использования / для использования в Автостейнере Дако 25 тестов, 35 тестов, c-Kit pharmDx™ for Manual Use / for the Dako Autostainer 25 tests, 35 tests.
53. Набор QIFIKIT® для количественного анализа 10 калибровок, QIFIKIT® 10 calibrations.
54. Набор аксессуаров для ФИШ анализа для гистологии 20 тестов, Histology FISH Accessory Kit 20 tests.
55. Набор аксессуаров для цитологического ФИШ анализа 20 тестов, Cytology FISH Accessory Kit 20 tests.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития



Н.В. Юргель

17 августа 2007 года


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
ATTACHMENT**

Лист 4

№ ФСЗ 2007/00210

56. Набор буферов Дако REAL™, для использования в ТехМейт™ 500 тестов, 4 x 500мл, Dako REAL™ Buffer Kit, for use with the TechMate™ Instruments 500 tests, 4 x 500mL.
57. Набор вспомогательный GenPoint™ 65 тестов, GenPoint™ Ancillary Package 65 tests
58. Набор для количественного определения содержания Цитомегаловируса ReSSQ® CMV 48 тестов, ReSSQ® CMV 48 tests.
59. Набор для количественного определения содержания Вируса Эпштейна-Барра ReSSQ® EBV 48 тестов, ReSSQ® EBV 48 tests.
60. Набор для окрашивания Алциановый Синий pH 2.5 Artisan™ 100 тестов, Artisan™ Alcian Blue pH 2.5 Stain Kit 100 tests.
61. Набор для окрашивания Алциановый Синий/Реактив Шиффа Artisan™ 100 тестов, Artisan™ Alcian Blue/PAS Stain Kit 100 tests.
62. Набор для окрашивания Алциановый Синий/Реактив Шиффа/Гематоксилин Artisan™ 100 тестов Artisan™ Alcian Blue/PAS/Hematoxylin Stain Kit 100 tests.
63. Набор для окрашивания Альфа-Амилаза Artisan™ 100 тестов, Artisan™ Alpha-Amylase 100 tests.
64. Набор для окрашивания Базальных Мембран по Джонсу Artisan™ PAS-M 100 тестов, Artisan™ Jones' Basement Membrane (PAS-M) Stain Kit 100 tests.
65. Набор для окрашивания Гематоксилин с Эозином Artisan™ 100 тестов, Artisan™ Hematoxylin & Eosin (H&E) Stain Kit 100 tests.
66. Набор для окрашивания Железа в тканевых срезах Artisan™ 100 тестов, Artisan™ Iron Stain Kit 100 tests.
67. Набор для окрашивания Кислотоустойчивых Бактерий AFB Artisan™ 100 тестов, Artisan™ Acid-Fast Bacteria (AFB) Stain Kit 100 tests.
68. Набор для окрашивания по Вартину-Старри Artisan™ 100 тестов, Artisan™ Warthin-Starby Stain Kit 100 tests.
69. Набор для окрашивания по Граму Artisan™ 100 тестов, Artisan™ Gram Stain Kit 100 tests.
70. Набор для окрашивания по Фельгену Artisan™ 100 тестов, Artisan™ Feulgen Stain Kit 100 tests.
71. Набор для окрашивания Ретикулина/без докраски Artisan™ 100 тестов, Artisan™ Reticulin/No Counterstain Stain Kit 100 tests.
72. Набор для окрашивания Ретикулина/с Ядерным Красным Прочным Artisan™ 100 тестов, Artisan™ Reticulin/Nuclear Fast Red Stain Kit 100 tests.
73. Набор для окрашивания с Конго Красным Artisan™ 100 тестов, Artisan™ Congo Red Stain Kit 100 tests.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

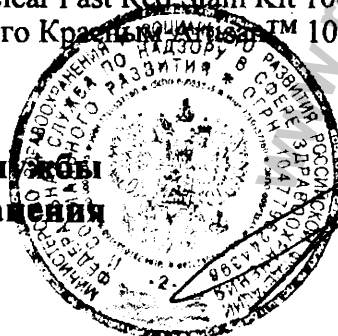

Н.В. Юргель

17 августа 2007 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
ATTACHMENT**

Лист 5

№ ФСЗ 2007/00210

74. Набор для окрашивания с красителем Гимзы Artisan™ 100 тестов, Artisan™ Giemsa Stain Kit 100 tests.
75. Набор для окрашивания с Метенаминовым Серебром по Грокотту GMS Artisan™ 100 тестов, Artisan™ Grocott's Methenamine Silver (GMS) Stain Kit 100 tests.
76. Набор для окрашивания с Муцикармином Artisan™ 100 тестов, Artisan™ Mucicarmine Stain Kit 100 tests.
77. Набор для окрашивания с раствором Шиффа PAS Artisan™ 100 тестов, Artisan™ Periodic Acid Schiff (PAS) Stain Kit 100 tests.
78. Набор для окрашивания с раствором Шиффа и красителем зеленым Artisan™ 100 тестов, Artisan™ PAS-Green Stain Kit 100 tests.
79. Набор для окрашивания трехцветный по Гомори Artisan™ 100 тестов, Artisan™ Gomori's Trichrome Stain Kit 100 tests.
80. Набор для окрашивания трехцветный по Гомори с зеленым Artisan™ 100 тестов, Artisan™ Gomori's Green Trichrome Stain Kit 100 tests.
81. Набор для окрашивания трехцветный по Массону Artisan™ 100 тестов, Artisan™ Masson's Trichrome Stain Kit 100 tests.
82. Набор для окрашивания эластичных волокон Artisan™ 100 тестов, Artisan™ Elastic Stain Kit 100 tests.
83. Набор для определения амплификации антигена HER2 ФИШ pharmDx™ 20 тестов, HER2 FISH pharmDx™ Kit 20 tests.
84. Набор для определения амплификации антигена HER-2/neu ИФА 96 лунок, HER-2/neu ELISA 96 wells.
85. Набор для определения амплификации антигена HER-2/neu ИФА контроля 3 x 0.5мл, HER-2/neu ELISA Controls 3 x 0.5mL.
86. Набор для определения амплификации гена TOP2A ФИШ pharmDx™ 20 тестов, TOP2A FISH pharmDx™ Kit 20 tests.
87. Набор для определения апоптоза АПОПТЕСТ™-FITC 100 тестов, АРОПТЕСТ™-FITC 100 tests.
88. Набор для определения суперэкспрессии белка HER2 ГерцепТест™ для ручного использования / для использования в Автостейнере Дако / для ТекМейт™ 35 тестов, 50 тестов, HercepTest™ for Manual Use / for the Dako Autostainer / for the TechMate™ Instruments 35 tests, 50 tests.
89. Набор для подсчета CD34 50 двойных тестов, CD34Count Kit 50 duplicate tests.
90. Набор для подсчета клеток ЦитоКаунт™ > 150 тестов, 17 мл, CytoCount™ > 150 tests, 17 mL.
91. Набор для фиксации и пермеабилзации ИнтраСтейн 100 тестов, IntraStain 100 tests.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Н.В. Юргель

17 августа 2007 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
ATTACHMENT**

Лист 6

№ ФСЗ 2007/00210

92. Набор для определения Теломеров PNA /FITC для проточной цитометрии 20 тестов, Telomere PNA Kit/FITC for Flow Cytometry 20 tests.
93. Набор для определения Теломеров PNA ФИШ/Су3 20 тестов, Telomere PNA FISH Kit/Су3 20 tests.
94. Набор для определения Теломеров PNA ФИШ/FITC 20 тестов, Telomere PNA FISH Kit/FITC 20 tests.
95. Набор ИФА PAI-1 96 лунок, PAI-1 ELISA 96 wells.
96. Набор ИФА PAI-1 контроли 3 x 1мл, PAI-1 ELISA Controls 3 x 1mL .
97. Набор ИФА uPA 96 лунок, uPA ELISA 96 wells.
98. Набор ИФА uPA Контроли 3 x 1мл, uPA ELISA Controls 3 x 1mL.
99. Набор ИФА uPA:PAI-1 Комплекс 96 лунок, uPA:PAI-1 Complex ELISA 96 wells.
100. Набор ИФА uPA:PAI-1 Контроли 3 x 1мл, uPA:PAI-1 ELISA Controls 3 x 1mL .
101. Набор ИФА для определения бычьего лейкоза 480 лунок, 2400 лунок, Bovine Leucosis ELISA Kit 480 wells, 2400 wells.
102. Набор ИФА Инсулин 96 лунок, Insulin ELISA Kit 96 wells.
103. Набор ИФА Хромогранин А 96 лунок, Chromogranin A ELISA Kit 96 wells.
104. Набор ИФА ЭФРр 96 лунок, EGFr ELISA 96 well.s
105. Набор контролей для иммунного анализа диабета 3 x 2мл, Diabetes Immunoassay Control Set 3 x 2mL.
106. Набор МетЧек™ 20 тестов, MetCheck™ Kit 20 tests.
107. Набор системных реагентов Дако REAL™, Пероксидаза/ДАБ, для ТехМейт™ 500/500 Плюс/1000/Горизонт 500 тестов, Dako REAL™ System Kit, Peroxidase/DAB, for TechMate™ 500/500 Plus/1000/Horizon 500 tests.
108. Набор ЭР/ПР pharmDx™ Kit для ручного использования / для использования в Автостейнере Дако 35 тестов, 50 тестов, ER/PR pharmDx™ Kit for Manual Use / for the Dako Autostainer 35 tests, 50 tests.
109. Набор ЭФРР pharmDx™ для ручного использования / для использования в Автостейнере Дако 35 тестов, 50 тестов, EGFR pharmDx™ Kit for Manual Use / for the Dako Autostainer 35 tests, 50 tests.
110. ОФД таблетки Дако, 2мг, для ИФА 100 таблеток, Dako OPD Tablets, 2mg, For ELISA 100 tablets.
111. ПАП мышинные моноклональные 1мл, PAP, Mouse, Monoclonal 1mL.
112. Пепсин 6 x 2г, Pepsin 6 x 2g.
113. Подушка абсорбирующая Дако REAL™, для ТехМейт™ 500/500 Плюс/1000/Горизонт 50 подушек, 150 подушек, Dako REAL™ Absorbent Pads. for TechMate™ 500/500 Plus/1000/Horizon 50 pads, 150 pads.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Н.В. Юргель

17 августа 2007 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
ATTACHMENT**

Лист 7

№ ФСЗ 2007/00210

114. Полоски контрольные Паскаль 100 полосок, Pascal Quality Strips 100 strips.
115. Полоски контроля влажности для Гибридайзера 20 полосок, Hybridizer Humidity Control Strips 20 strips.
116. Протеиназа К концентрированная, готовая к применению 2мл, 150 тестов, 15мл, 10 x 11мл, 1100 тестов, 110мл, Proteinase K Concentrate / Ready-to-Use 2mL, 150 tests, 15mL, 10 x 11mL, 1100 tests, 110mL.
117. Протеиназа К Дако REAL™ (40x) 4мл, Dako REAL™ Proteinase K (40x) 4mL.
118. Разбавитель антител 50 мл, 125мл, Antibody Diluent 50 mL, 125mL.
119. Разбавитель антител Дако REAL™ 250мл, Dako REAL™ Antibody Diluent 250mL
120. Разбавитель антител с компонентами снижения фоновой окраски 50мл, 125мл, Antibody Diluent with Background-Reducing Components 50mL, 125mL.
121. Разбавитель Протеиназы К Дако REAL™ 250 мл, Dako REAL™ Proteinase K Diluent 250mL .
122. Раствор для восстановления антигена (10x) Дако REAL™ 500мл, Dako REAL™ Target Retrieval Solution (10x) 500mL .
123. Раствор для восстановления антигена Дако, pH 9 Концентрированный x 10, готовый к применению 500 мл, Dako Target Retrieval Solution, pH 9 (Concentrated x 10), Ready-to-Use 500mL.
124. Раствор для восстановления антигена Дако, цитратный pH 6 (x 10) 500мл, Dako Target Retrieval Solution, Citrate pH 6 (x 10) 500mL.
125. Раствор для восстановления антигена, высокий pH, готовый к применению, Концентрированный x 10 500мл, Target Retrieval Solution, High pH, , Ready-to-Use, Concentrated x 10 500mL.
126. Раствор для восстановления антигена, готовый к применению, концентрированный x 10 500мл, Target Retrieval Solution, Ready-to-Use, Concentrated x 10 500mL .
127. Раствор для деконтаминации для проточных цитометров 5л, Decontaminating. Solution for Flow Cytometers 5L.
128. Раствор Левамизоля 15мл, Levamisole Solution 15mL.
129. Раствор очищающий и промывающий для проточных цитометров 5л, Cleaning and Rinse Solution for Flow Cytometers 5L.
130. Раствор промывающий (x50) Artisan™ 4 x 200мл, Artisan™ Wash Solution (x 50) 4 x 200mL .
131. Раствор рабочий PuraFlo™ 1X, 8X для проточного цитометра 100л уп., 20л уп., 4 x 6 л, PuraFlo™ 1X Sheath Fluid 100L уп., 20L box, 4 x 6L .
132. Раствор рабочий для проточного цитометра 20л, Sheath Fluid for Flow Cytometry 20L .

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Н.В. Юргель

17 августа 2007 года


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
ATTACHMENT

Лист 8

№ ФСЗ 2007/00210

133. Раствор трис-буфера с NaCl и с Твин 20 (TBST), pH 7.6, Концентрированный x 10 500мл, Tris-Buffered NaCl Solution with Tween 20 (TBST), pH 7.6, Concentrated x 10 500mL .
134. Раствор, блокирующий пероксидазу, Дако REAL™ 250мл, Dako REAL™ Peroxidase-Blocking Solution 250mL .
135. Реагент двойной для блокировки эндогенных ферментов 15мл, 10 x 11мл, Dual Endogenous Enzyme Block 15mL, 10 x 11mL.
136. Реагент для лизиса эритроцитов EasyLyse™ 300 тестов, 6 x 5мл, EasyLyse™, Erythrocyte-Lysing Reagent 300 tests, 6 x 5mL .
137. Реагент для лизиса Эритроцитов Uti-Lyse™ 250 тестов, 25мл, 500 тестов, 50мл, Uti-Lyse™, Erythrocyte-Lysing Reagent 250 tests, 25mL, 500 tests, 50mL.
138. Реагент очищающий для специального окрашивания Clear-It 3.8л, Clear-It Cleaning Reagent for Special Stains 3.8L.
139. Реагент, блокирующий пероксидазу, Готовый к применению, для ручного использования / для использования в Автостейнере Дако 15мл, 10 x 11мл, 110мл, Peroxidase-Blocking Reagent, Ready-to-Use, for Manual Use / for the Dako Autostainer 15mL, 10 x 11mL, 110mL.
140. Система хемилуминесцентная для блоттинга нуклеиновых кислот (20 блотов x 150см²) 20 блотов, Chemiluminescent System for Nucleic Acid Blotting (20 Blots x 150cm²) 20 blots.
141. Система, блокирующая биотин 15 + 15мл, Biotin Blocking System 15 + 15mL .
142. Смесь ДНК зондов для ФИШ EMSY/ЦЕН-11 20 тестов, 0.2мл, EMSY/CEN-11 FISH Probe Mix 20 tests, 0.2mL.
143. Смесь ДНК зондов для ФИШ ЭФРР/ЦЕН-7 20 тестов, 0.2мл, EGFR/CEN-7 FISH Probe Mix 20 tests, 0.2mL .
144. Среда для заключения водная Faramount, Готовая к применению 15мл, Faramount, Aqueous Mounting Medium, Ready-to-Use 15mL.
145. Среда для заключения водная Glycergel® 15мл, Glycergel®, Aqueous Mounting Medium 15mL.
146. Среда для заключения перманентная водная Ultramount, Готовая к применению 15мл, Ultramount, Aqueous Permanent Mounting Medium, Ready-to-Use 15mL
147. Среда для заключения флуоресцентная 15мл, Fluorescence Mounting Medium 15mL.
148. Стекла предметные силанизированные, Silanized Slides.
149. Сыворотка козья (нормальная) 10мл, Goat Serum (Normal) 10mL.
150. Сыворотка мышьяная (нормальная) 1мл, Mouse Serum (Normal) 1mL.

Информация о регистрации в сфере здравоохранения
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

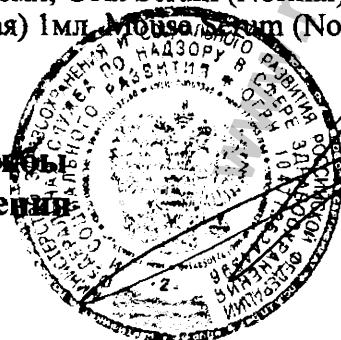

Н.В. Юргель

17 августа 2007 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
ATTACHMENT**

Лист 9

№ ФСЗ 2007/00210

151. Сыворотка человеческая С-реактивный белок Калибратор / Контроль Высокого Уровня / Контроль Низкого Уровня 1мл, 5мл, Human Serum C-Reactive Protein Calibrator / High Control / Low Control 1mL, 5mL.
152. Сыворотка человеческая Липопротеин Калибратор / Контроль Высокого Уровня / Контроль Низкого Уровня 1мл, Human Serum Lipoprotein Calibrator / High Control / Low Control 1mL.
153. Сыворотка человеческая Протеин Калибратор / Контроль Высокого Уровня / Контроль Низкого Уровня 1мл, Human Serum Protein Calibrator / High Control / Low Control 1mL.
154. Твин 20 100мл, Tween 20 100mL.
155. Трис-буфер солевой (TBS), pH 7.6 6 x 1 л, 2 x 5 л, Tris-Buffered Saline (TBS), pH 7.6 6 x 1 L, 2 x 5 L.
156. Удалитель ДАБ® 1.25л, DAB Away® 1.25L.
157. Фермент протеолитический, Готовый к применению 10 x 11мл, Proteolytic Enzyme, Ready-to-Use 10 x 11mL.
158. ДНК зонды ФИШ, Сплит-Сигнал, BCL10, BCL2, BCL3, BCL6, BCR 20 тестов, 0.2мл, FISH DNA Probe, Split Signal, BCL10, BCL2, BCL3, BCL6, BCR 20 tests, 0.2mL.
159. Штатив для предметных стекол с капиллярными промежутками Дако REAL™, 100µm (голубой), 155µm (желтый), 75 µm (серый) ~ 504 стекла, Dako REAL™ Capillary Gap Microscope Slides, 100µm (Blue), 155µm (Yellow), 75µm (Grey) ~ 504 slides.
160. Штатив-держатель для 14 контейнеров с реагентами Artisan™, Artisan™ 14 Pack Reagent Holder.

Производства:

«Дако Джапан Инк.» (Dako Japan Inc.), Япония, Iidabashi First Building, 2-5-1 Koraku Bunkyo-ku Tokyo, 112-0004, Japan

«Дако Норз Америка Инк.» (Dako North America, Inc.), США, 6392 Via Real Carpinteria, CA 93013, USA

«Дако Колорадо, Инк.» (Dako Colorado, Inc.), США, 4850 Innovation Drive Fort Collins, Colorado 80525, USA

«Дако ЮК Лтд.» (Dako UK Ltd.), Объединенное Королевство Великобритания Denmark House Angel Drove, Ely Cambridgeshire CB7 4ET, United Kingdom.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития



Н.В. Юргель

17 августа 2007 года