


Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.roszdramprom.ru

Фотографические изображения медицинского изделия
*«Система физиологической навигации для нейрохирургии
NeuroNav, Neuro Omega, NeuroSmart с принадлежностями»*
Производства «Alpha Omega Engineering Ltd.», Израиль

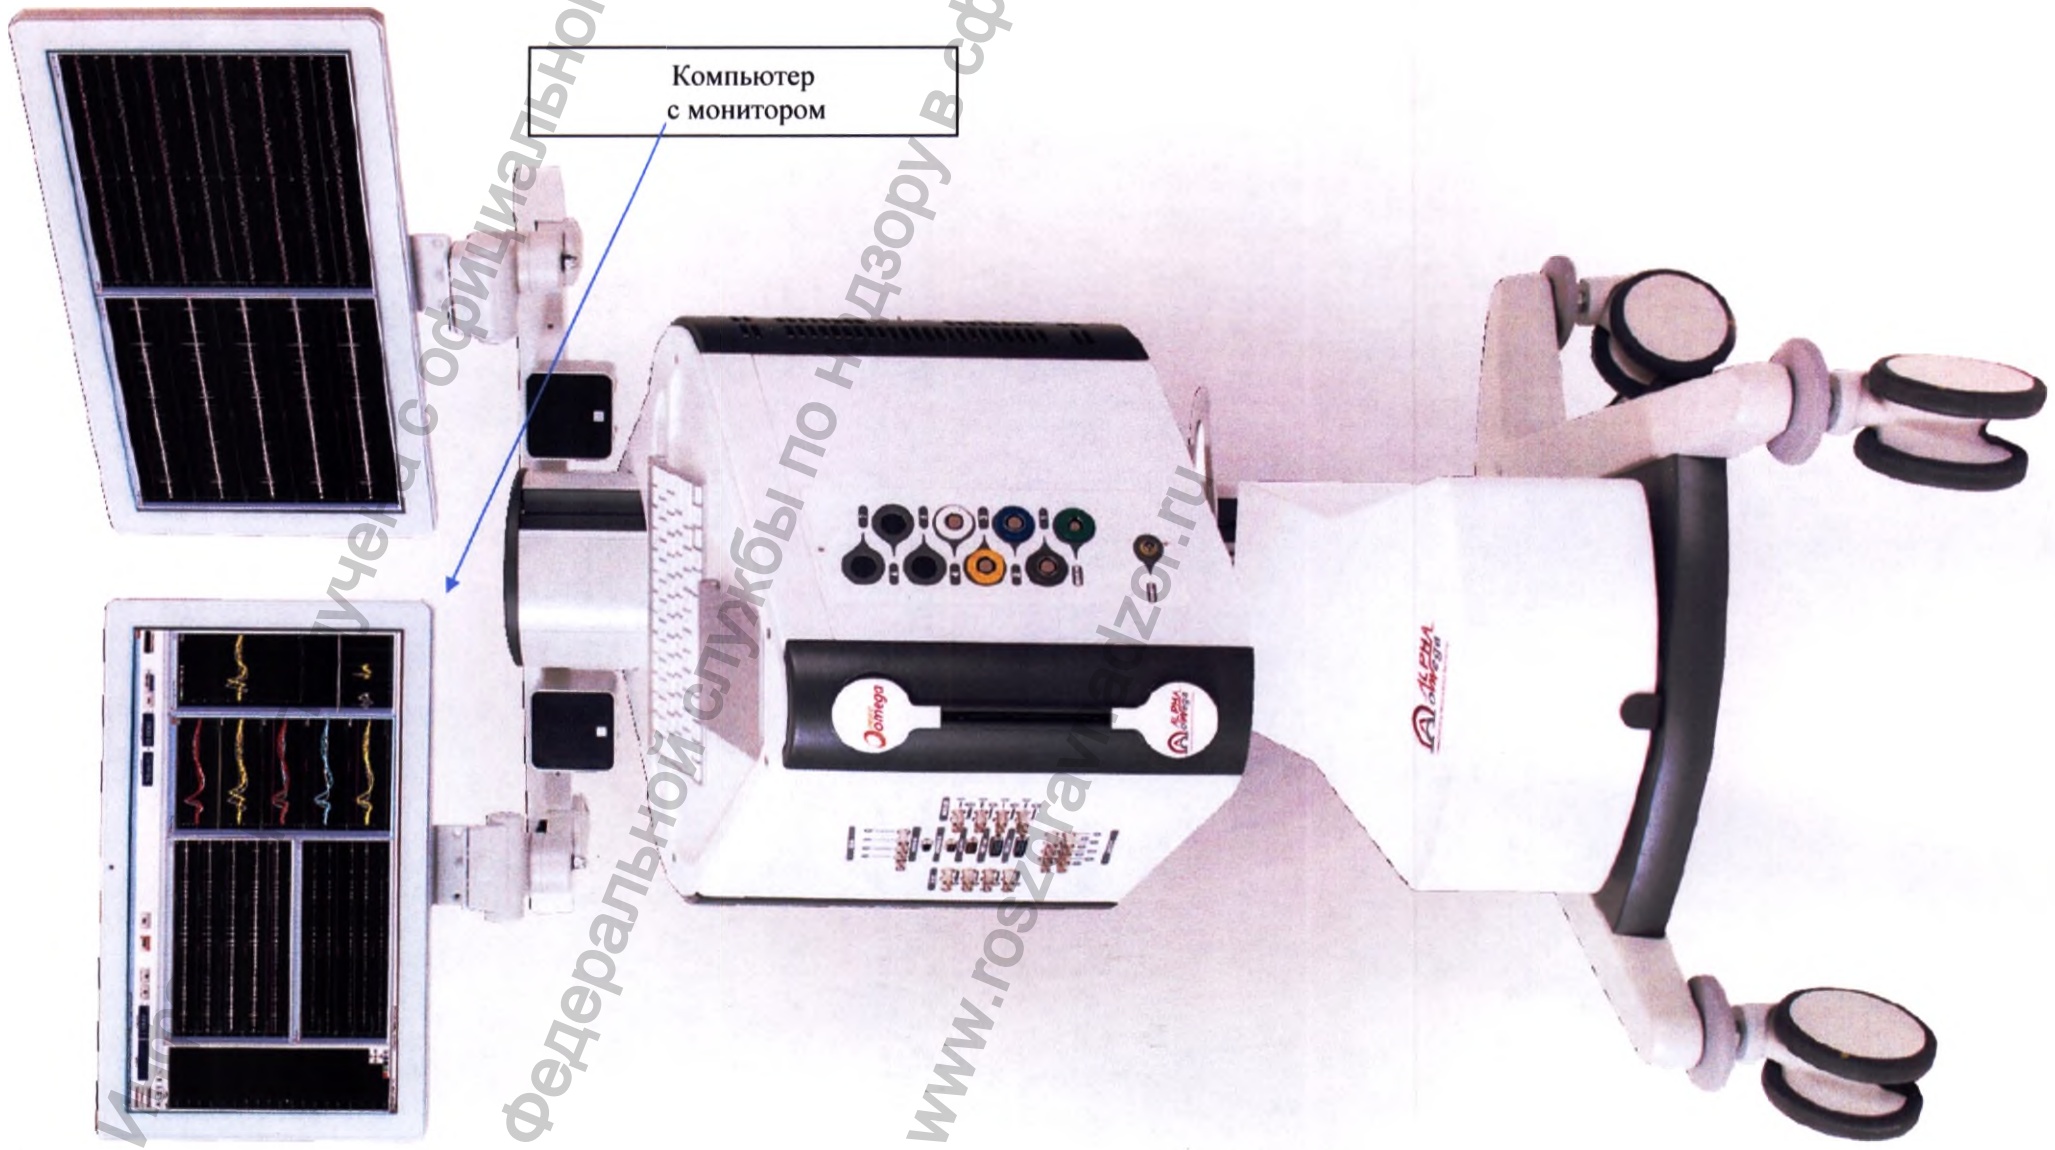

Компьютер
с монитором

Система физиологической навигации для нейрохирургии NeuroOmega

Информация получена с официального сайта
Федерального центра по надзору в сфере
www.goszdravnadzor.ru

Refer to instructions for use in Users Manual

SN: 143

11/2015

CE 0297

100 - 240 50/60Hz 5 2812 844

AlphaOmega Engineering
Naxosstr. Industriepark Building
Naxosstr. 16 12102, 86386
Tel: +872-4-858-3377
Fax: +872-104-857-8078


AlphaOmega GmbH
Ludwigstr. 26
42699 Solingen, Germany
Tel: +49 (0) 21 2391034
Fax: +49 (0) 21 2391034

AlphaOmega Co USA
5155 North First Street
USA 288
Alpharega CA 92024
China: 871-819-8285
Fax: 871-871-2825

Neuro Omega
System for recording
and stimulation


ALPHA
Omega

Шильдик NeuroOmega

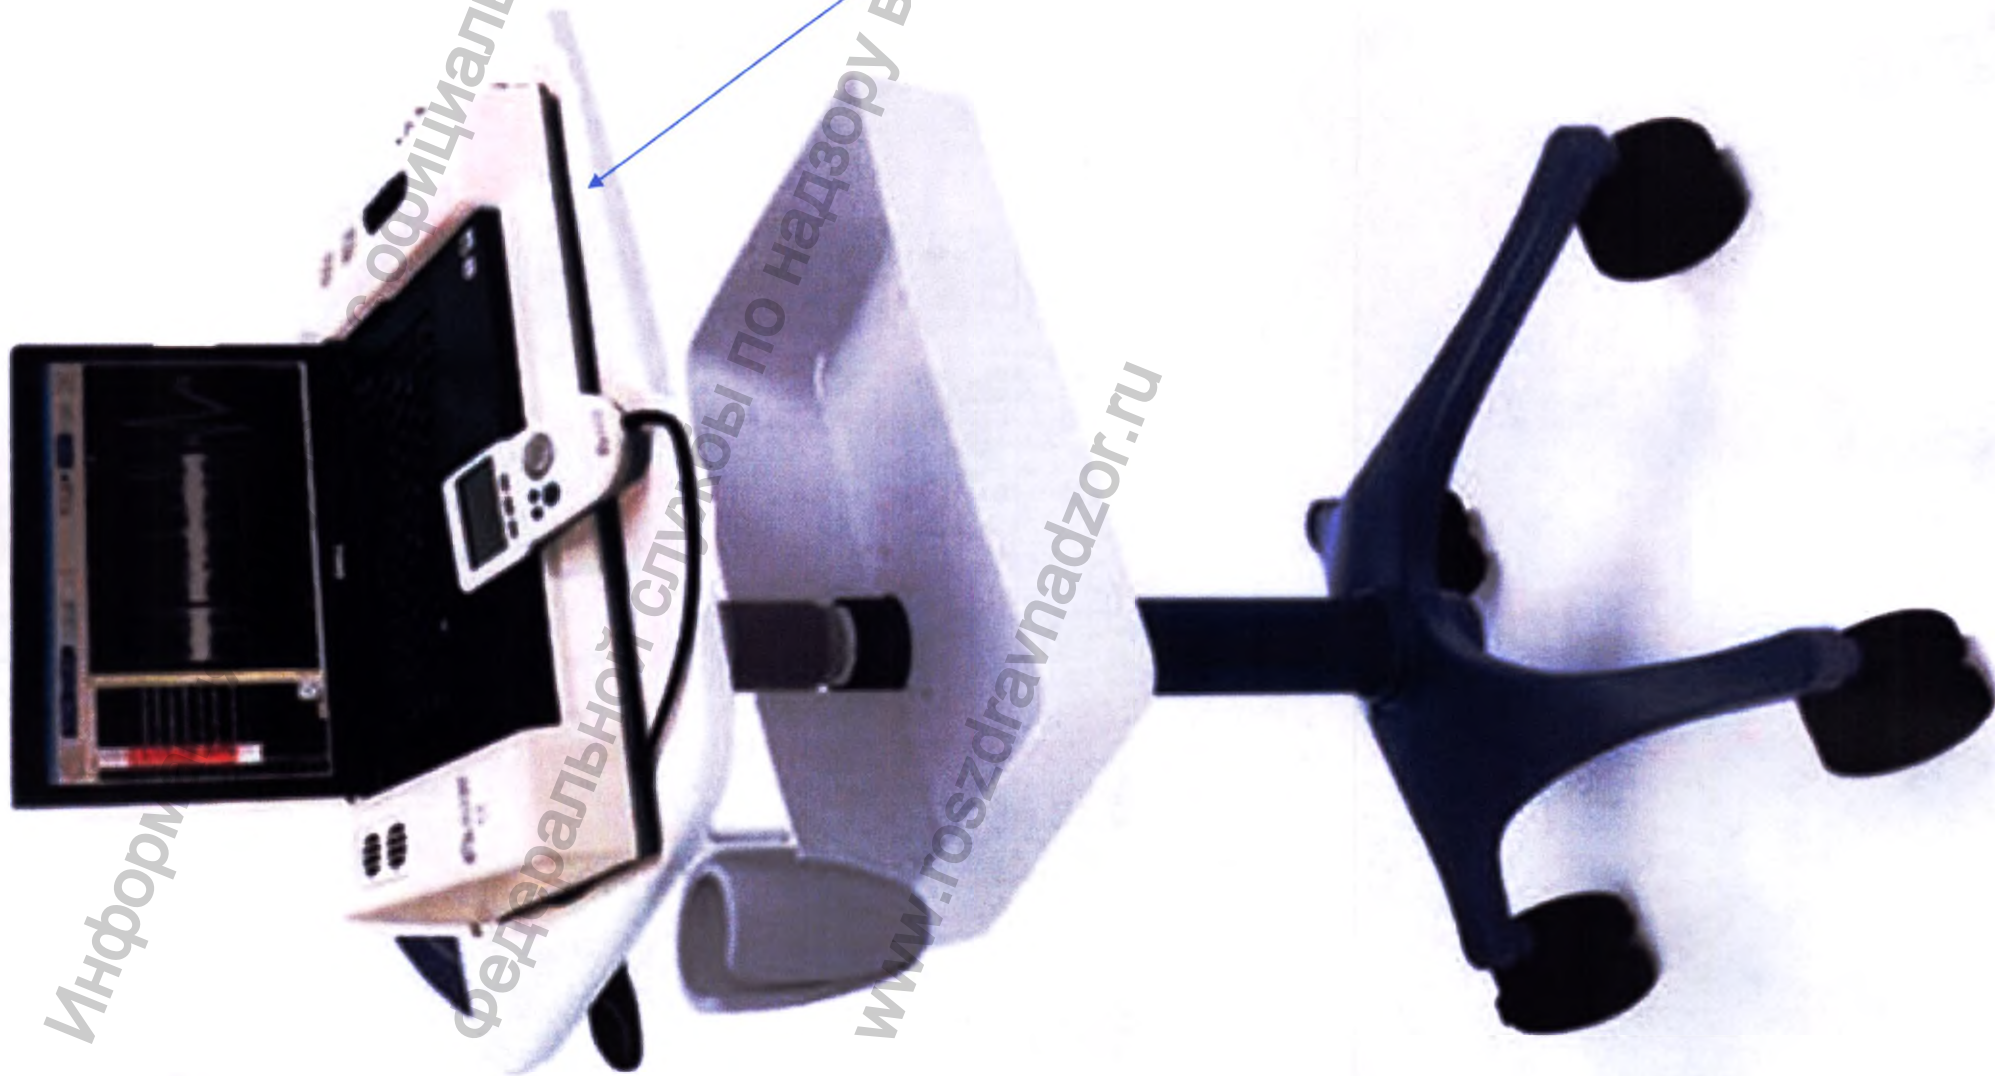

Компьютер
с монитором

Система физиологической навигации для нейрохирургии NeuroNav

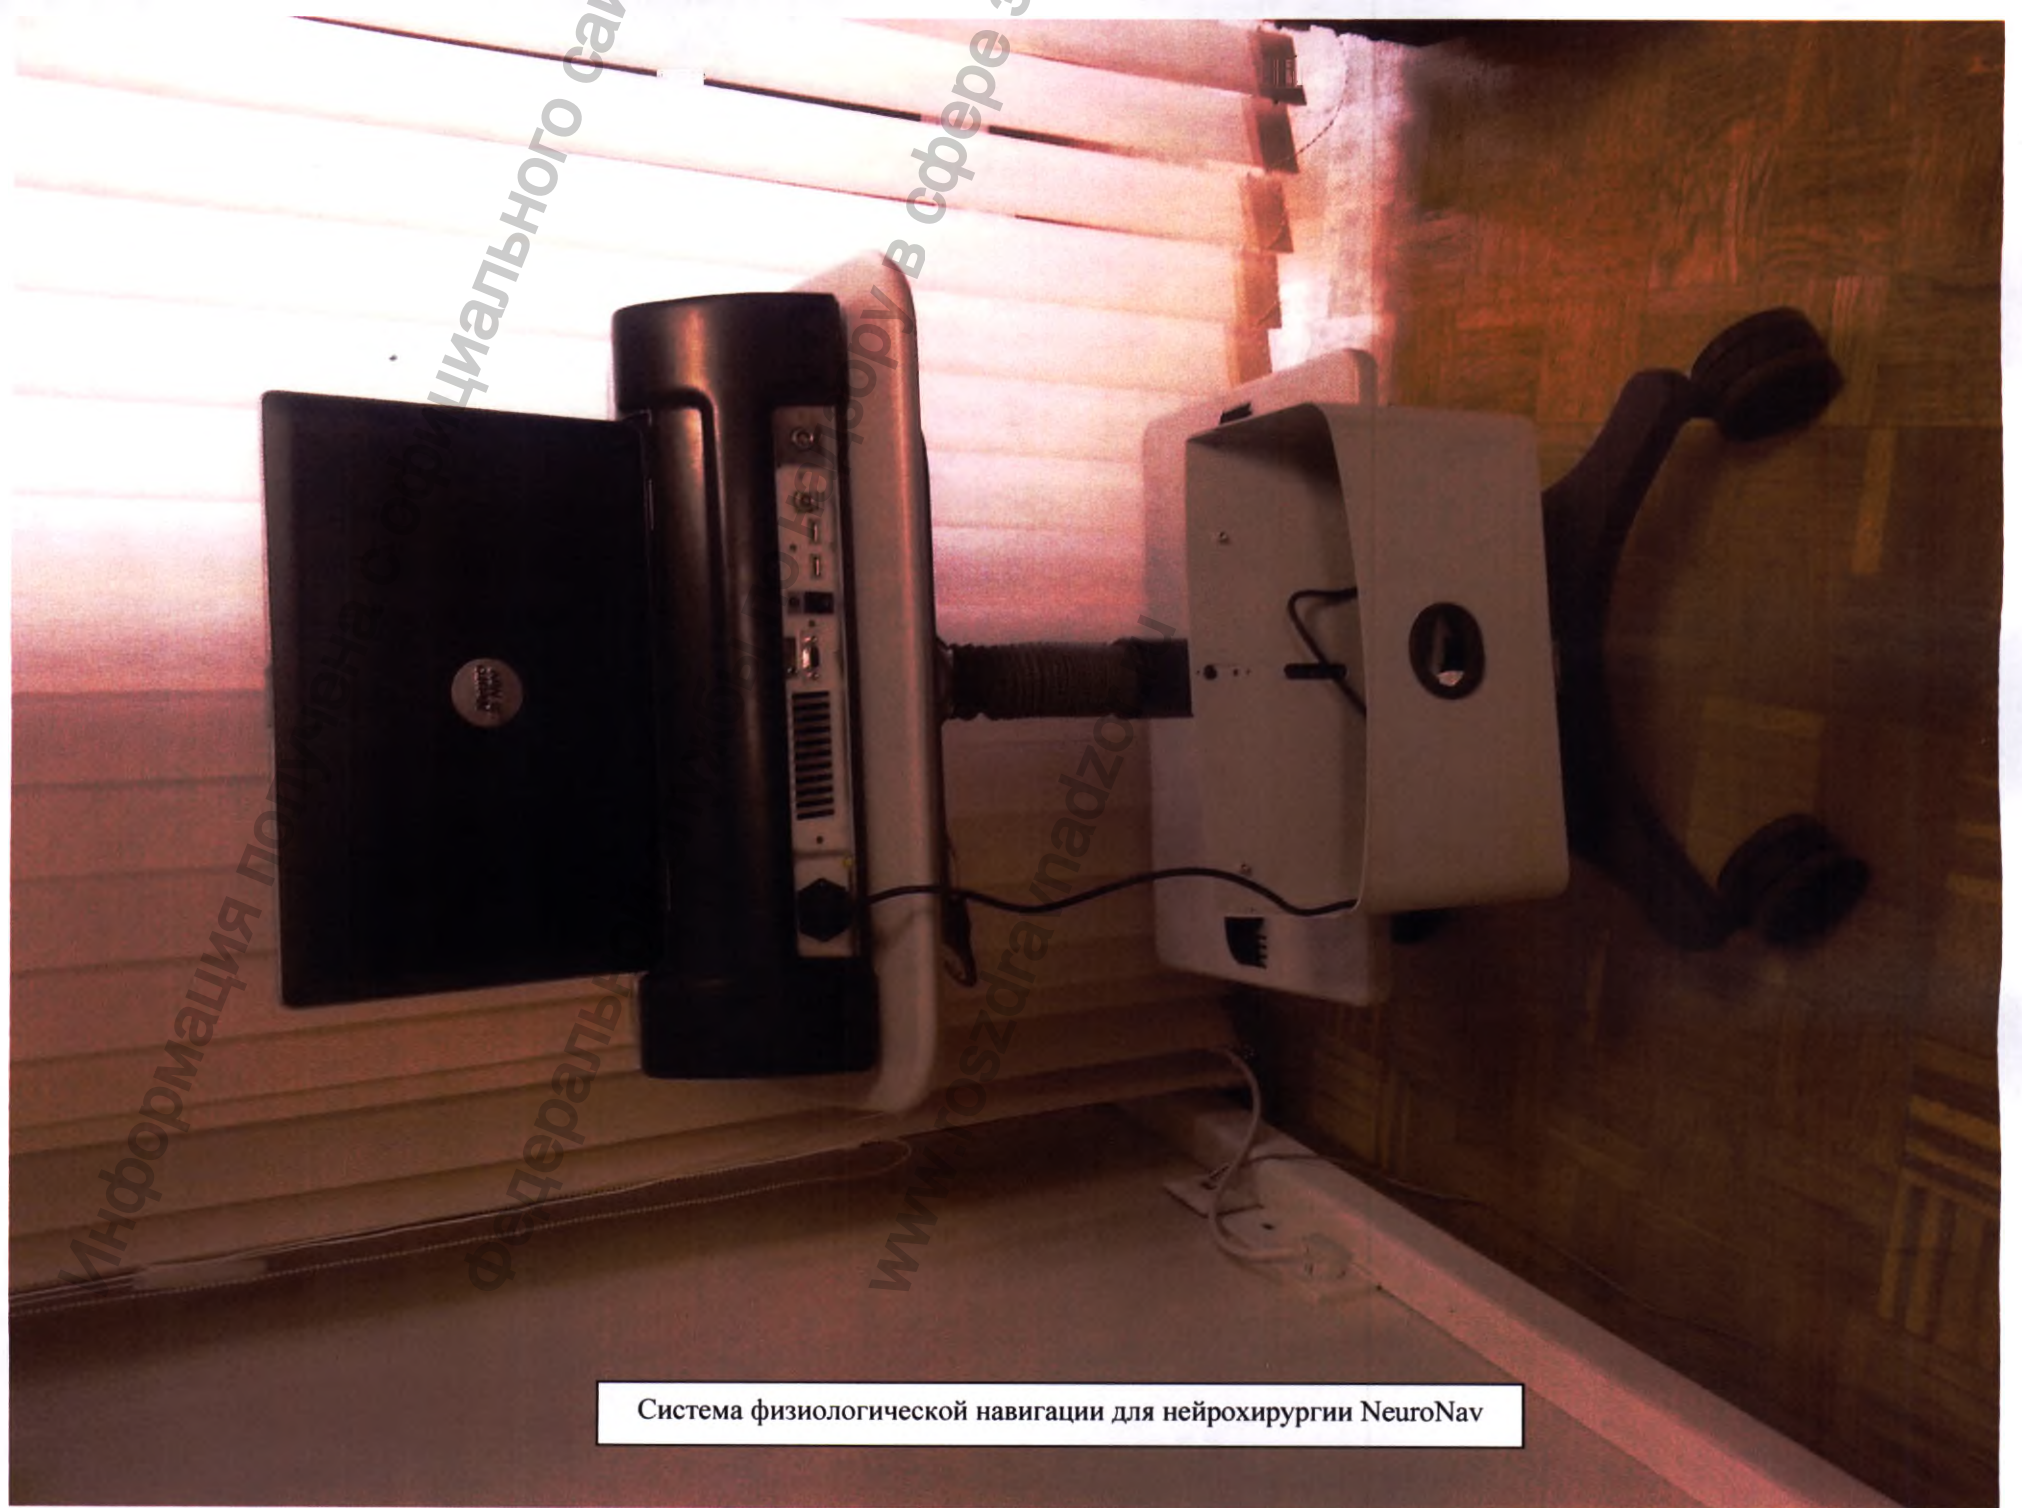

Система физиологической навигации для нейрохирургии NeuroNav

NeuroNav

System for recording and
stimulation during Neurosurgery



Defining Neuroscience Technology



Refer to instructions for use in
Users Manual

SN: 190/09



09/2014




CE
0297

AlphaOmega Co. USA
5755 North Point Pkwy
Unit 229
Alpharetta GA 30022
Office: 877-919-6288
Fax (877) 471-2055


AlphaOmega GmbH
Ubstadter Str. 28
Ubstadt-Weiher, 76698
Germany
Toll Free 00-800-2574-2111
Fax +49 (0) 721-2391034

AlphaOmega Engineering
Nazareth Industrial Park Building
Mount Precipice, PO Box 2268
Nazareth 1612102, Israel
Tel +972-4-656-3327
Fax +972-(0)4-6574075

Шильдик NeuroNav

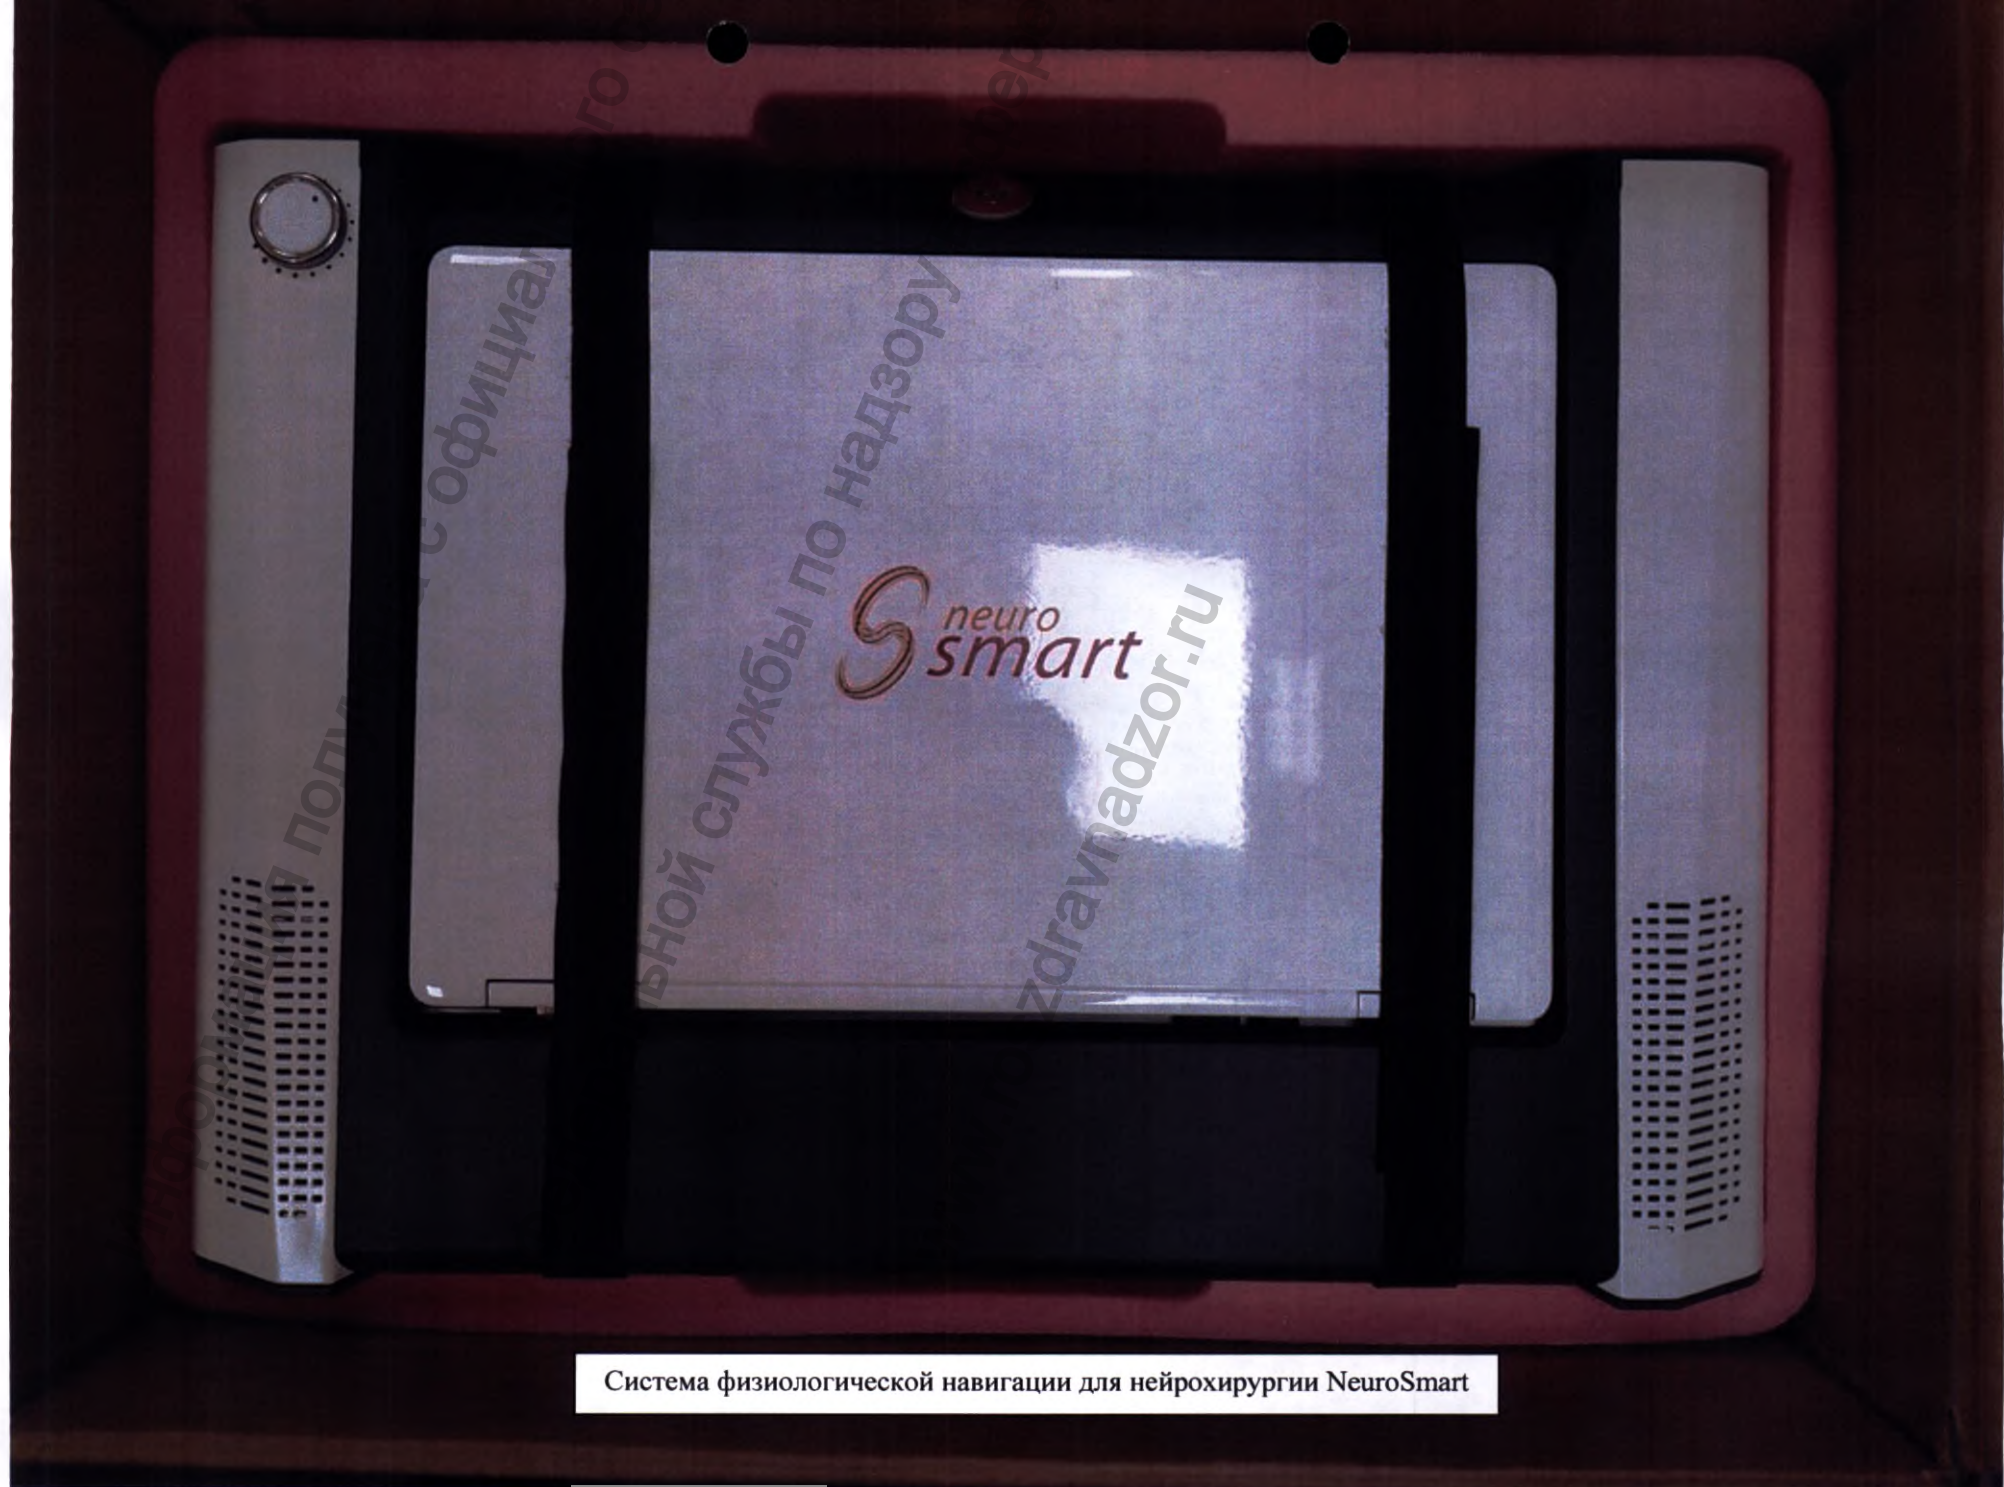

Система физиологической навигации для нейрохирургии NeuroSmart

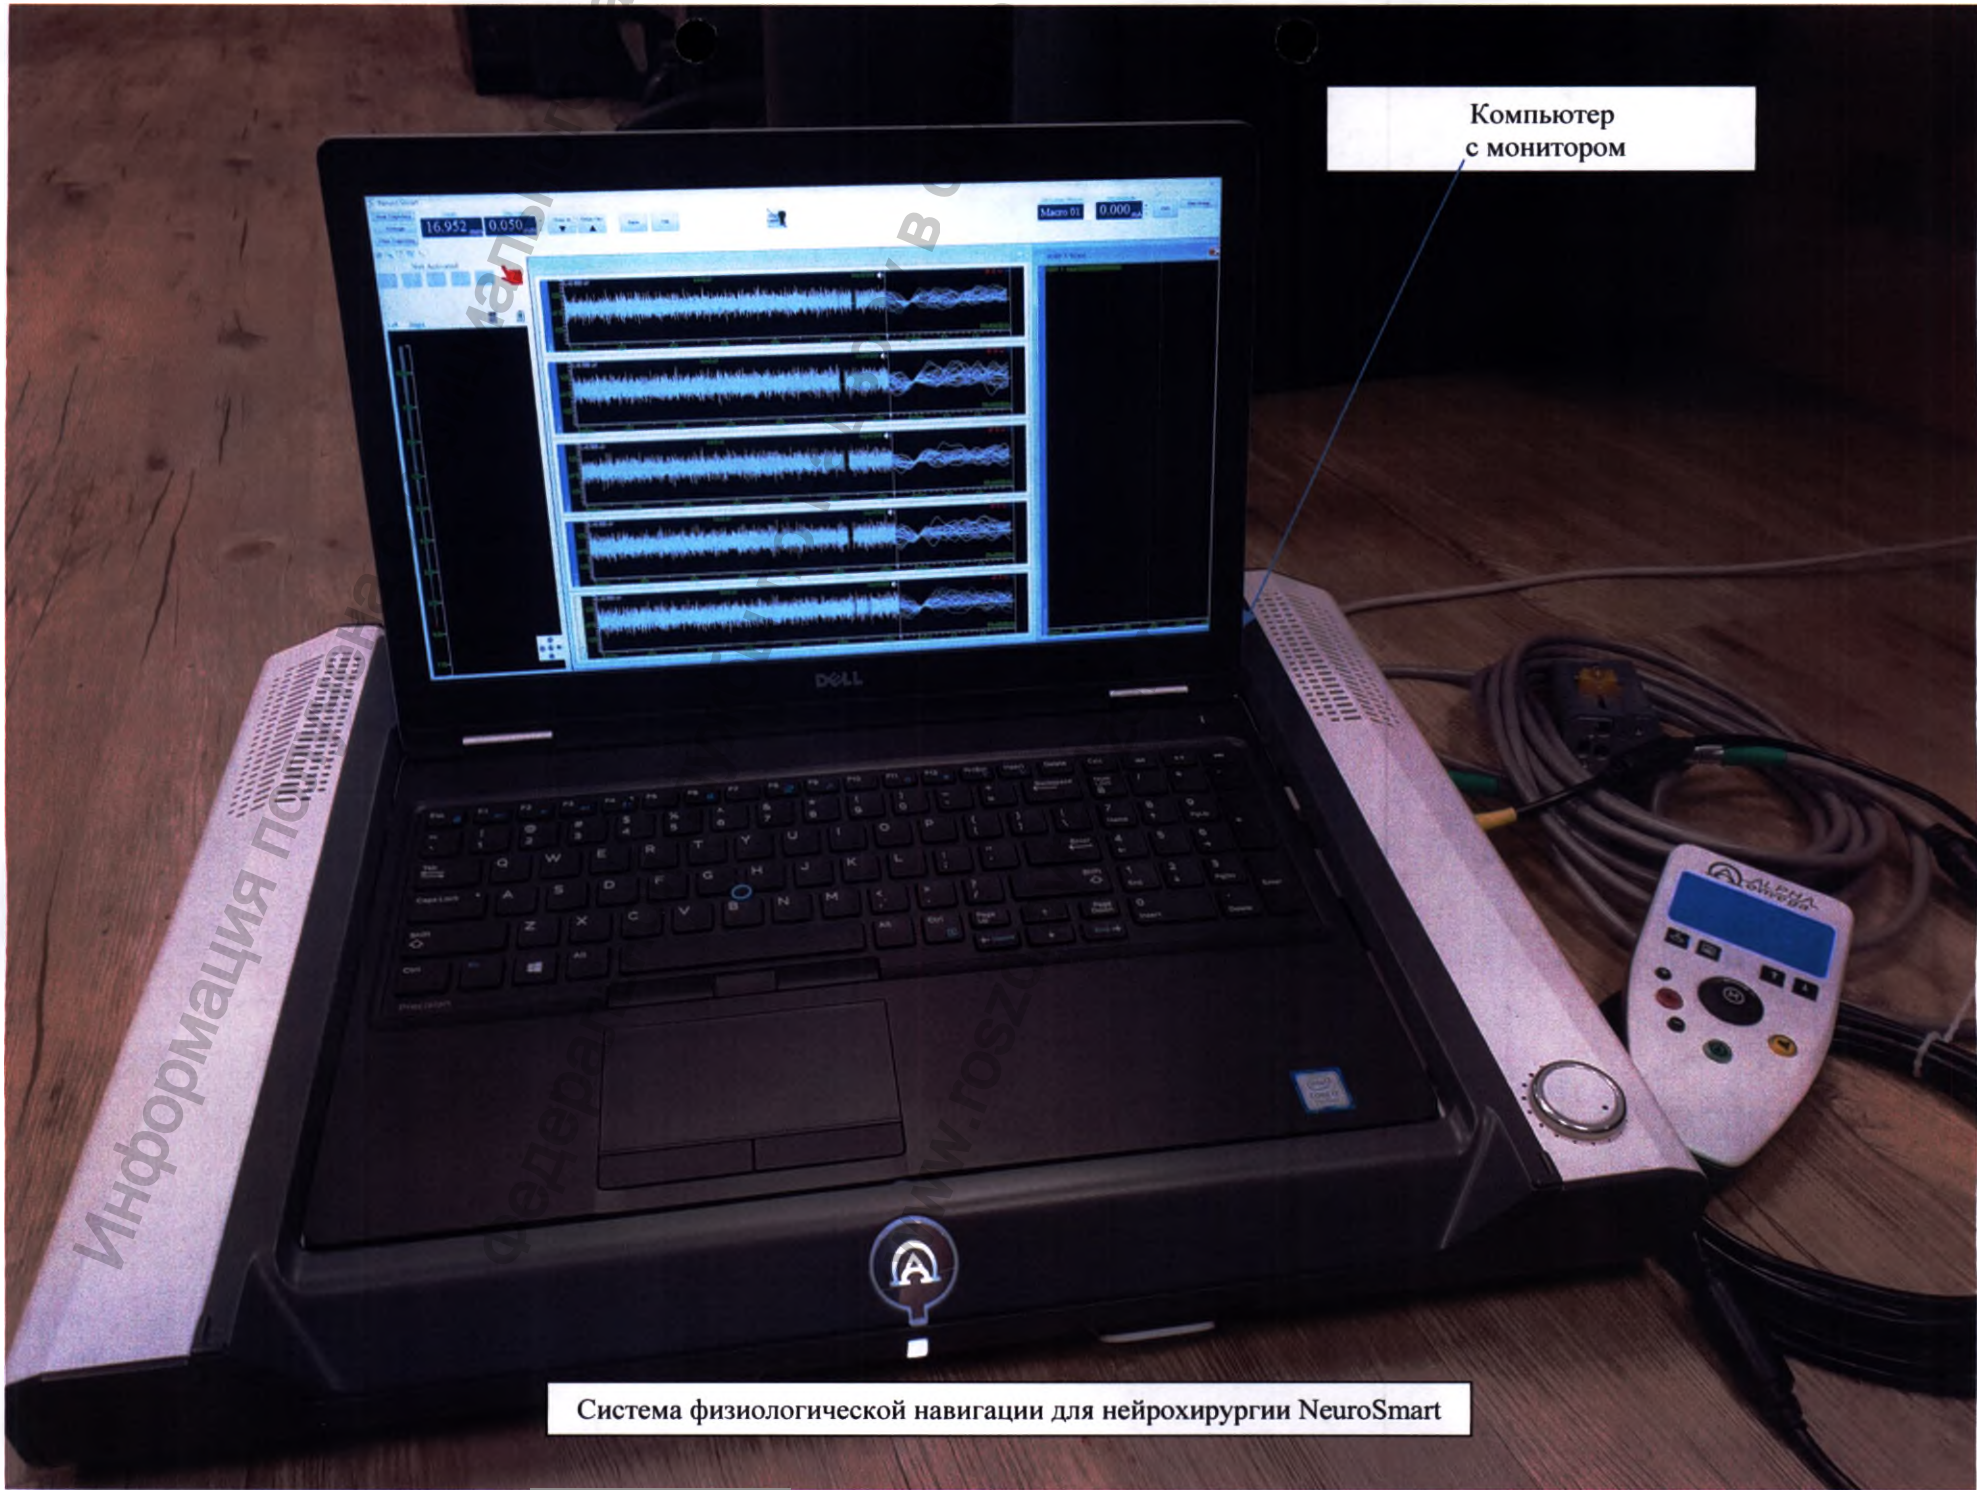


Компьютер с монитором


Система физиологической навигации для нейрохирургии NeuroSmart

NeuroSmart

System for recording and
stimulation during
Neurosurgery

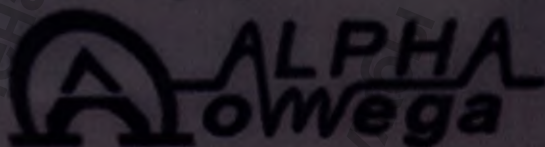

— Defining Neuroscience Technology



Refer to instructions for
use in Users Manual

REF

700-006007-00

SN

1020



2019-06-04
(YYYY-MM-DD)



CE 0297

Rx Only



(01)07290014954083(11)190604(21)1020


Made in Israel

Alpha Omega Co. USA
5765 North Point Pkwy
Unit 228
Alpharetta GA 30022
Office: 877-619-6288
Fax: 877-471-3955


Alpha Omega GmbH
Ubstadt Str. 28
Ubstadt-Weiher, 76608
Germany
Toll free: 00-800-2574-2111
Fax: +49 (0) 721-2391034

Alpha Omega Engineering
Nazareth Industrial Park Building
Mount Precipice, P.O. Box 2268
Nazareth 1612102 Israel
Tel: +872-4-858-3327
Fax: +872-(0)4-8574875


Шильдик NeuroSmart

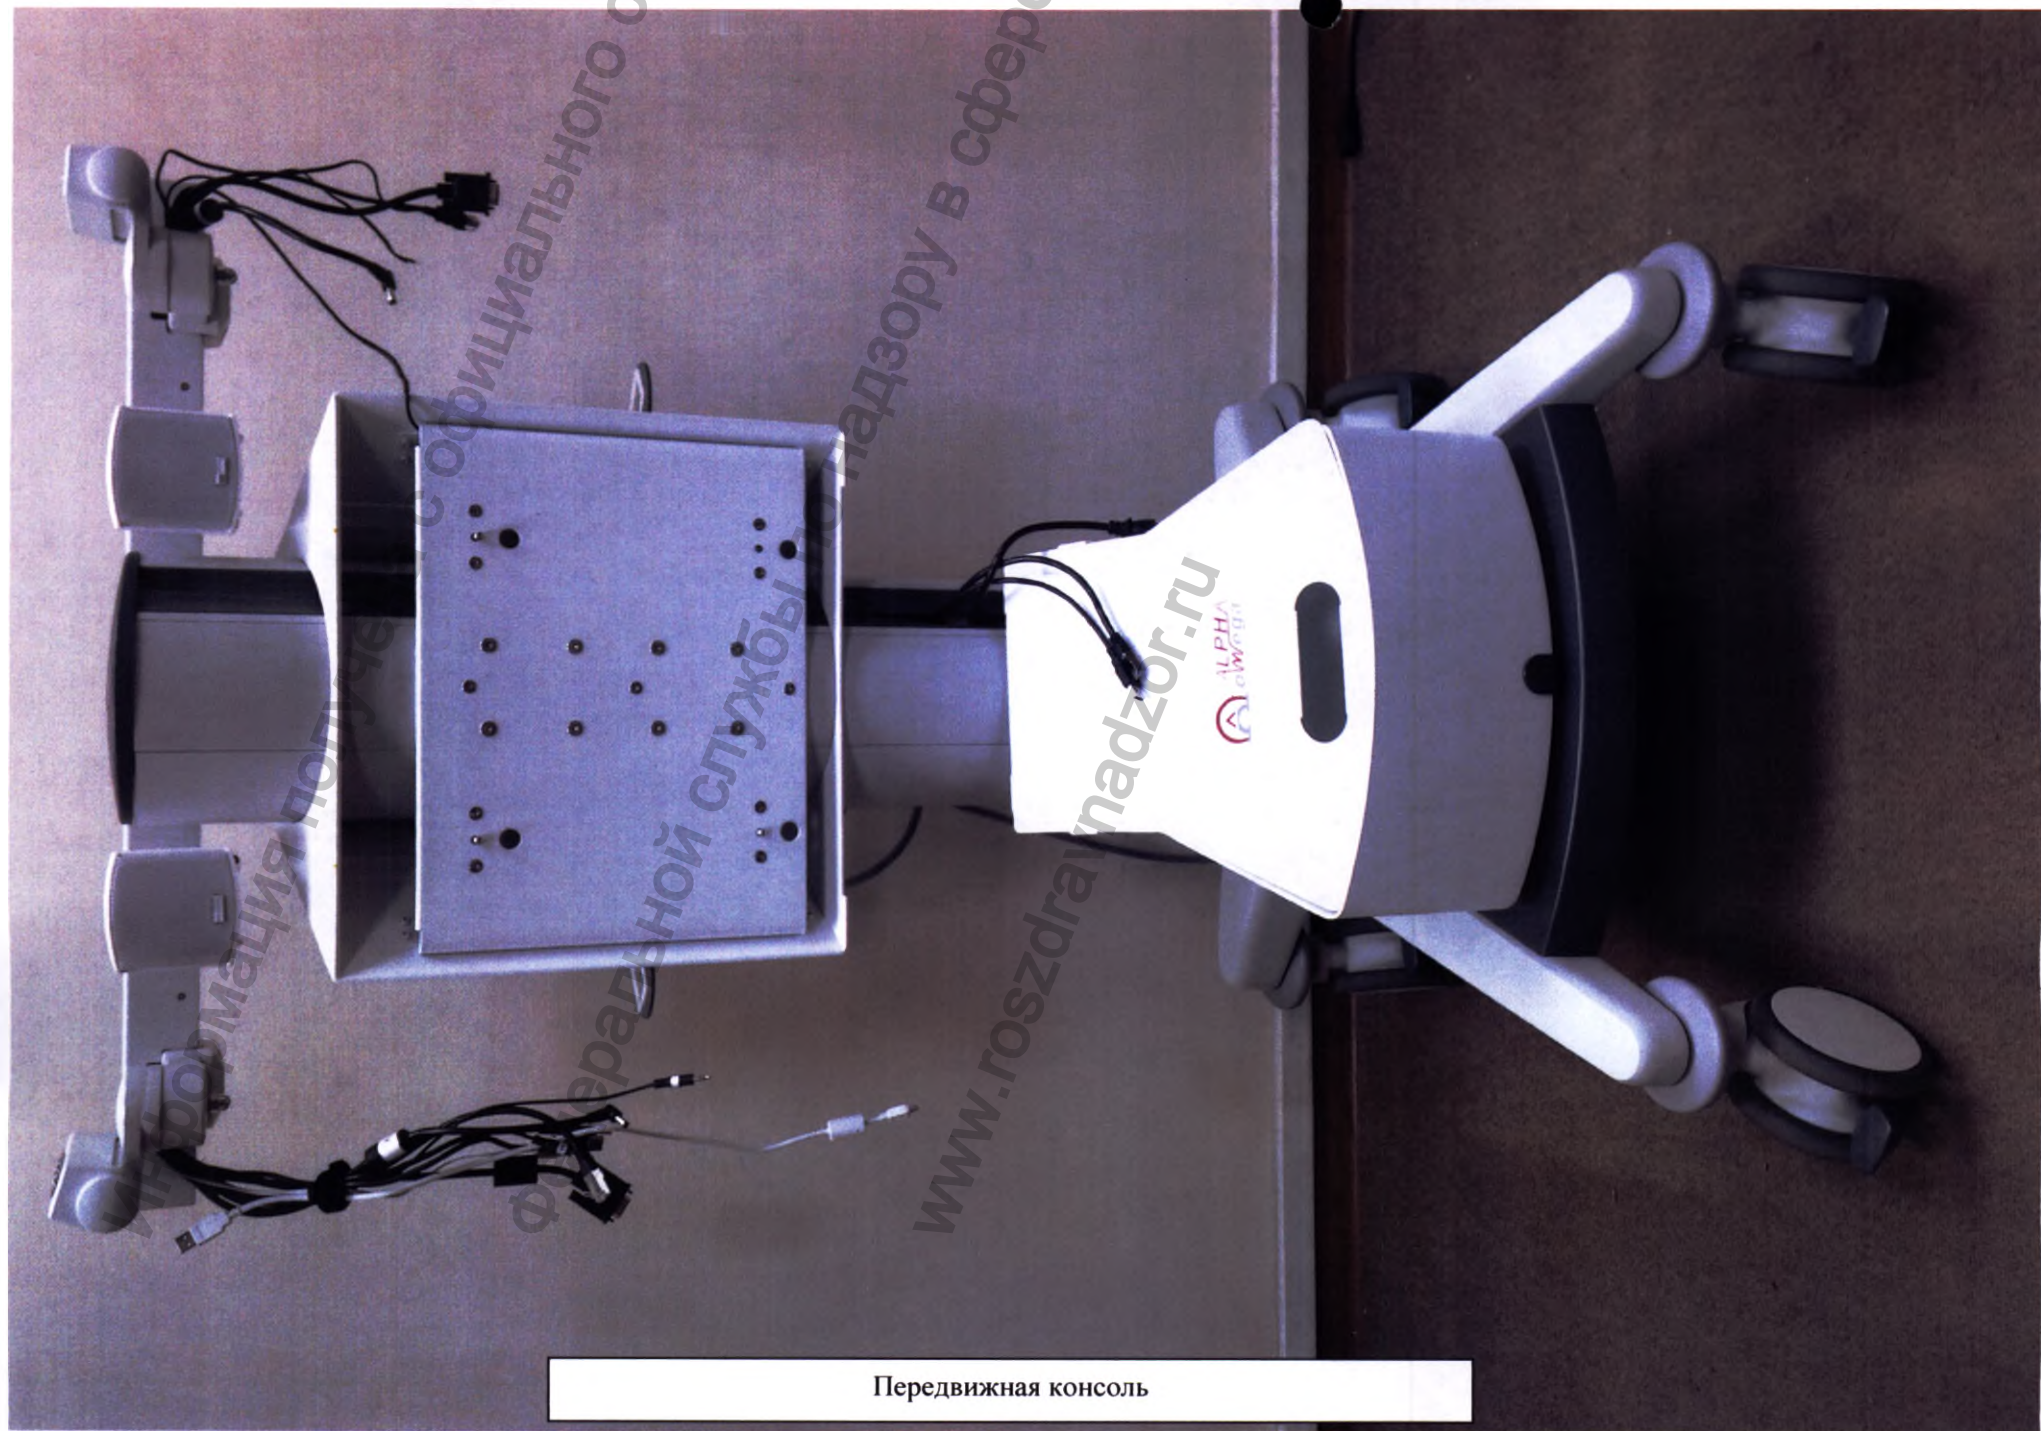

Передвижная консоль

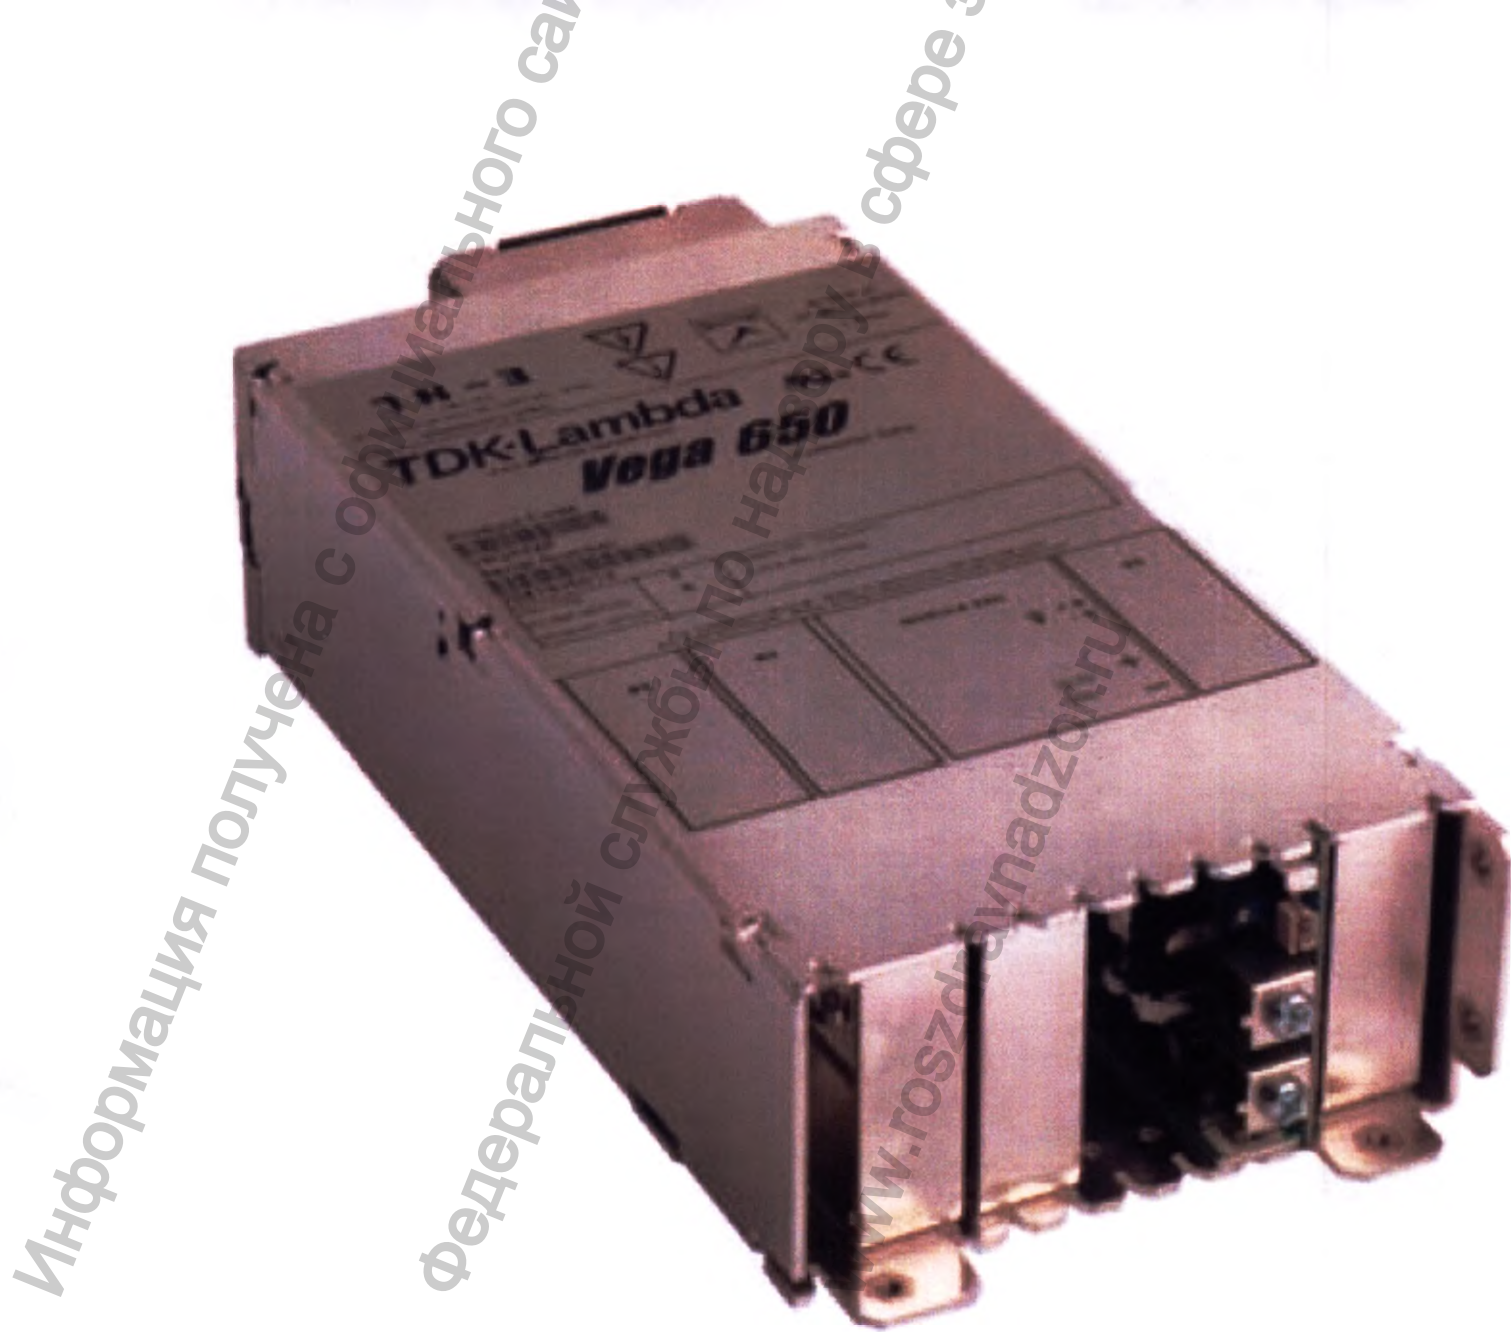


Блок питания

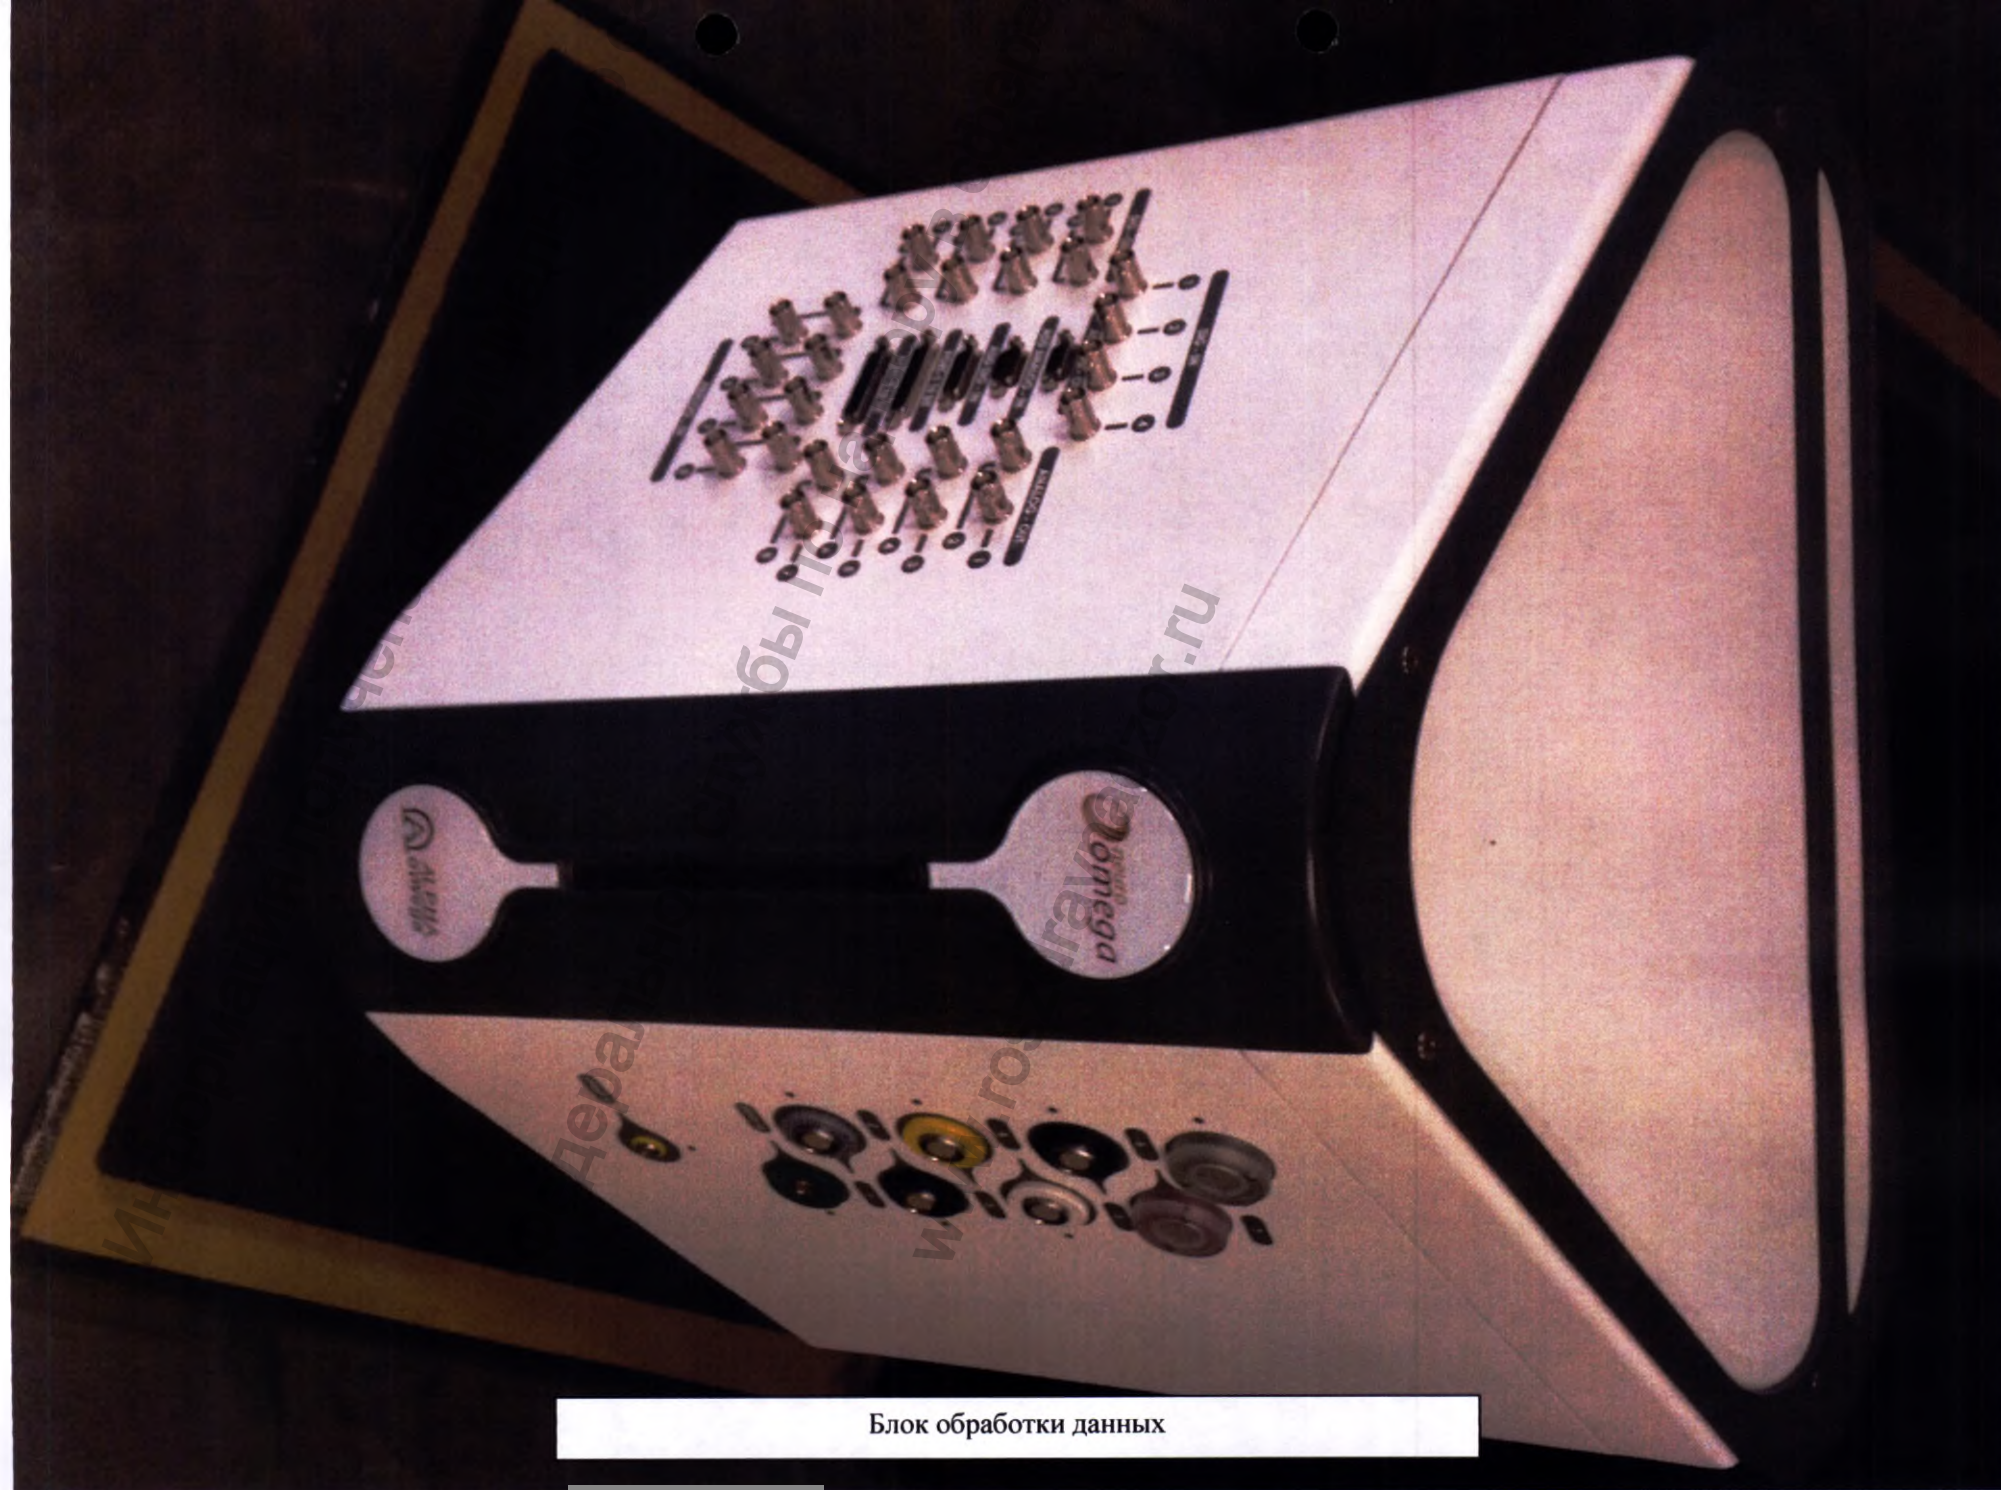

Блок обработки данных



Устройство погружения электродов с усилителем для записи сигналов

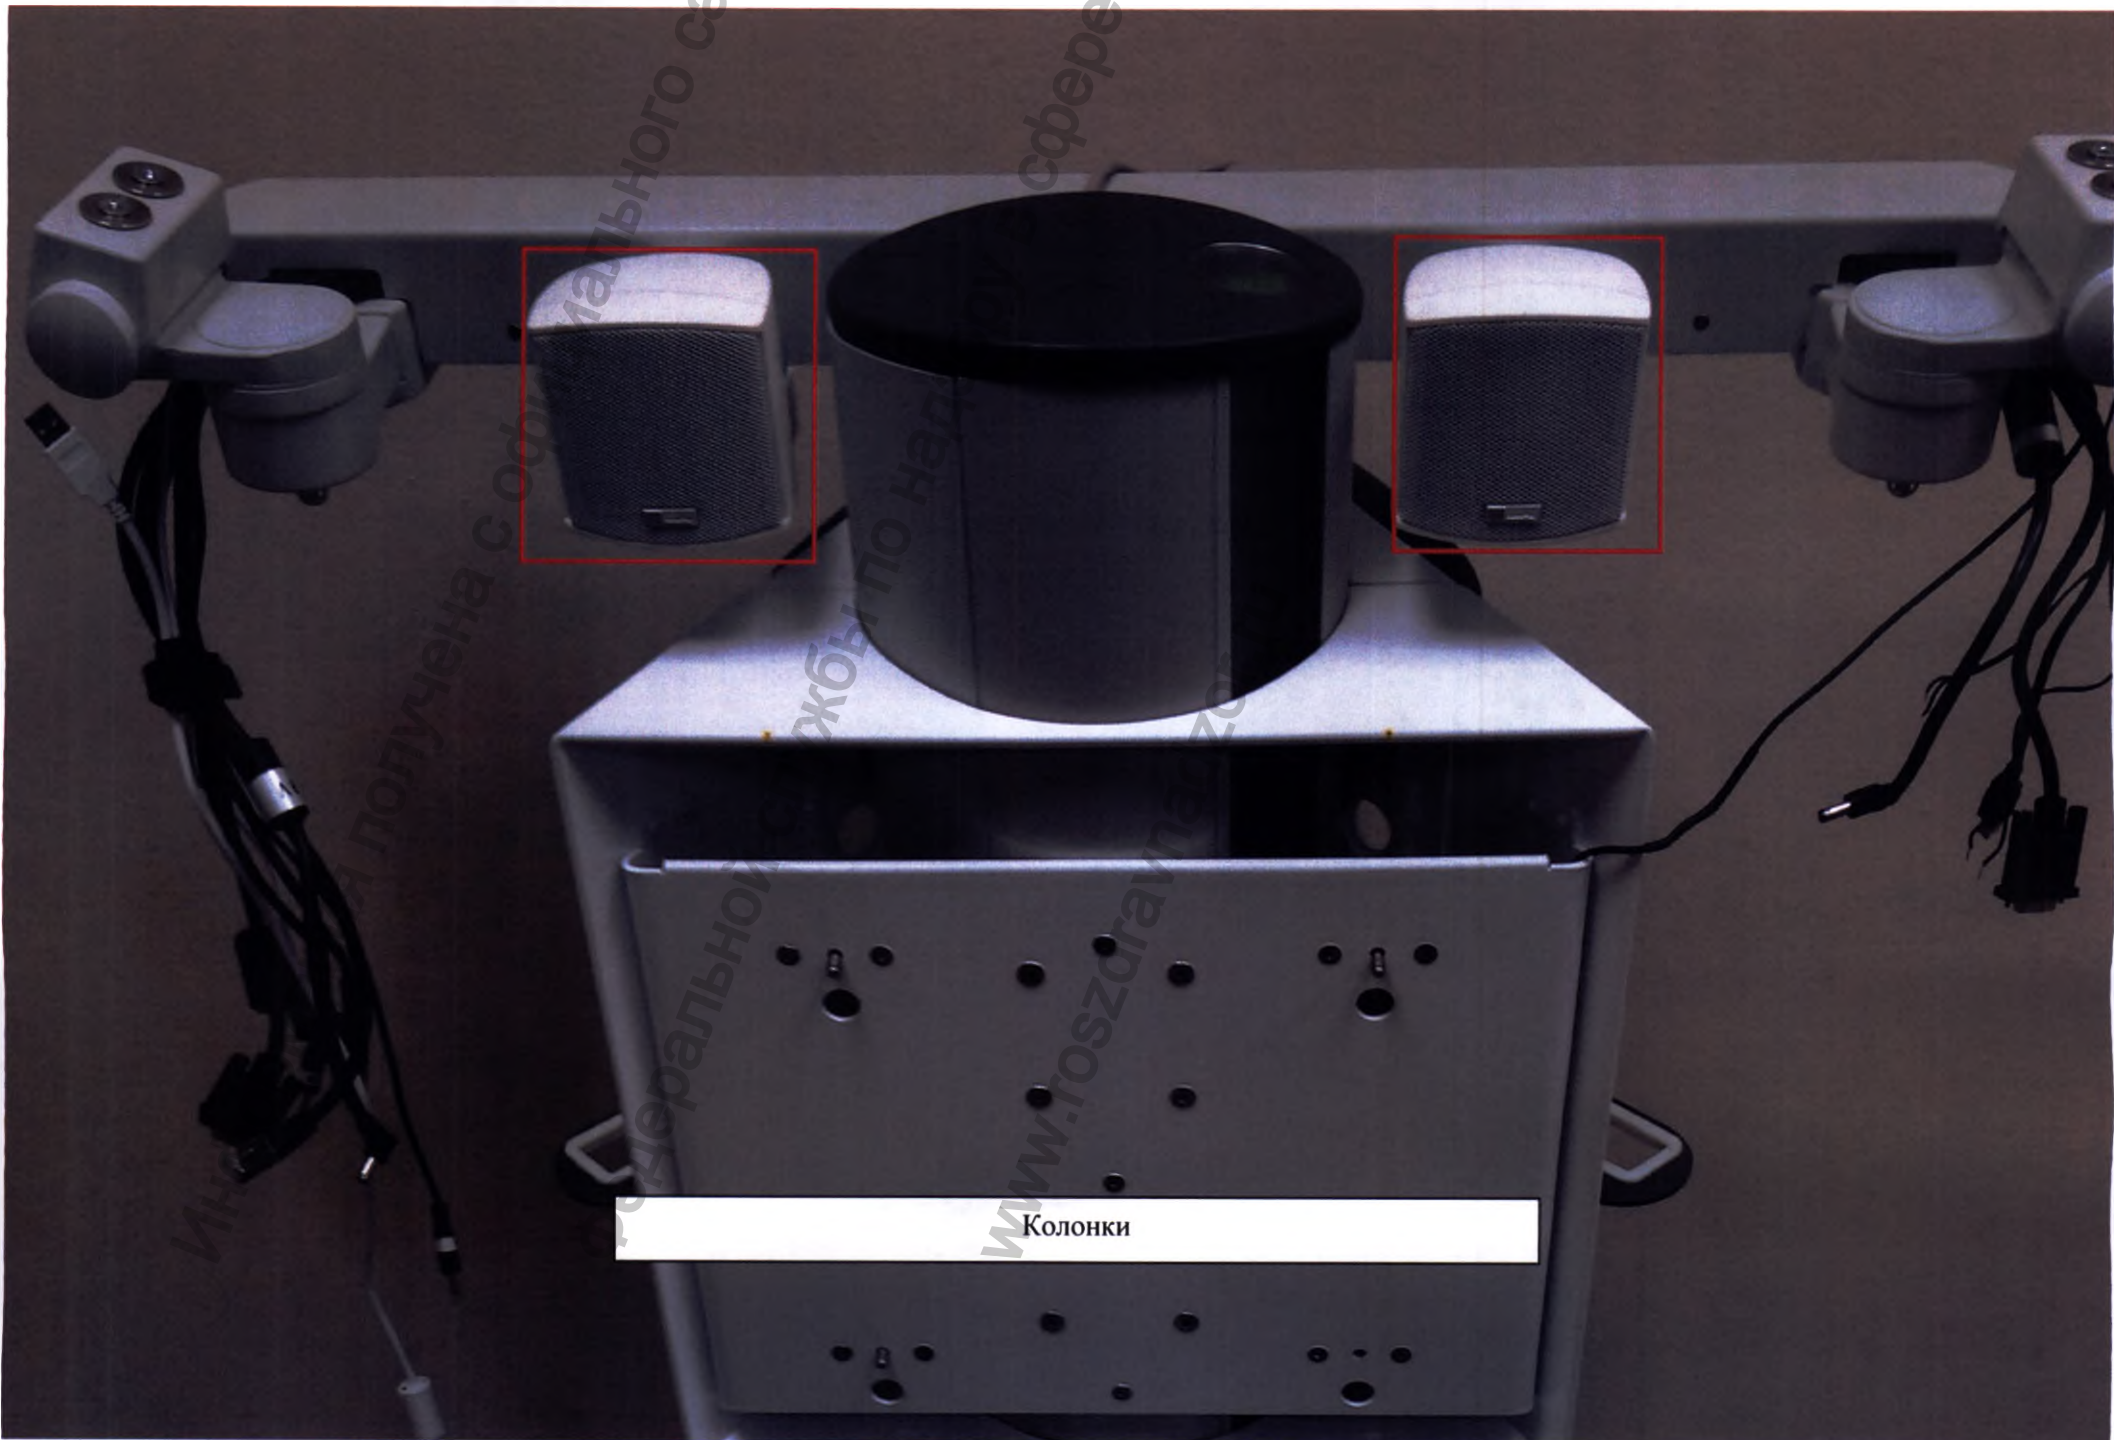

Колонки



Комплект кабелей

Microdrive depth and controls

Save

Impedance

Stimulation

Scripting

New Trajectory
Settings
Print Trajectory

Depth: 0.000
Step size: 1.000


Drive InV Drive OutA Save Imp

Stim channel: Micro 01

Stim amplitude: 0.000

Stim Setup: Square Tri
Script Start
Script Settings

ry map

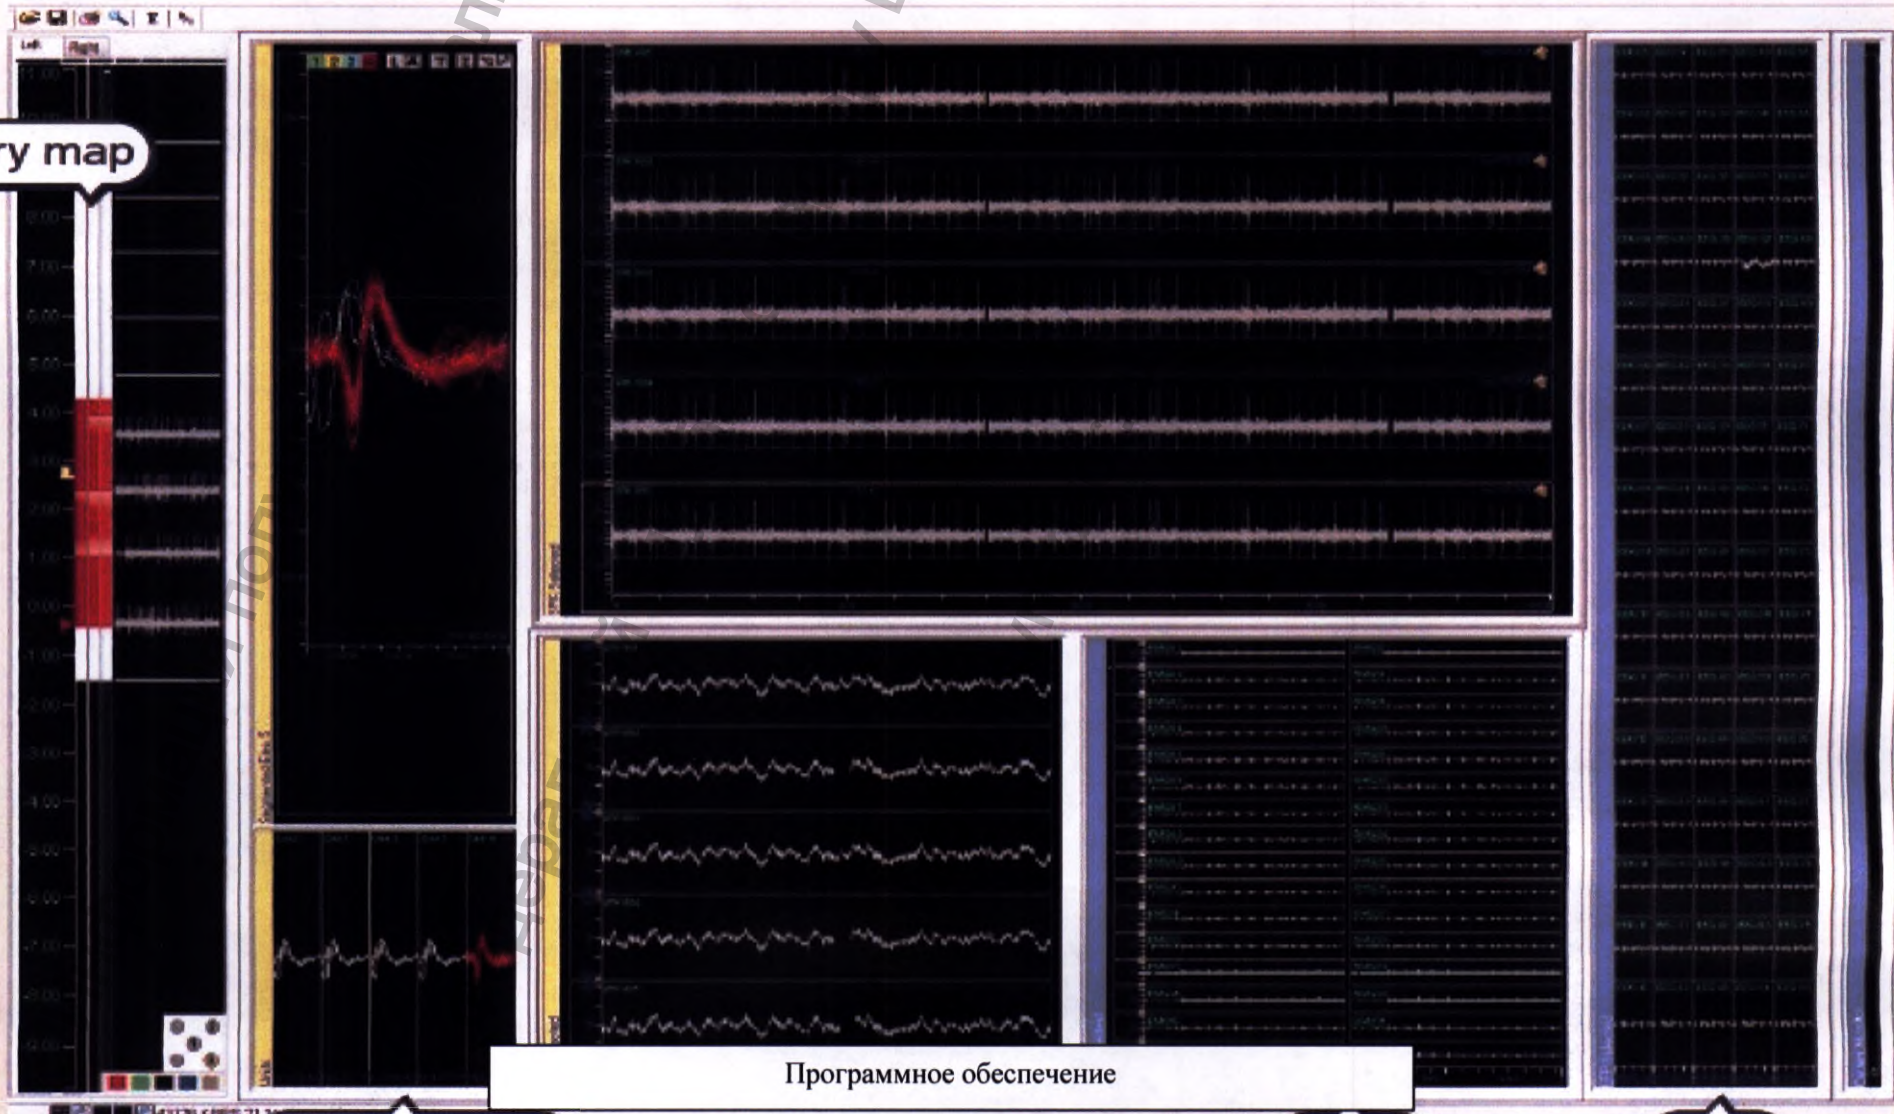

Программное обеспечение

Spike sorting

EMG

EEG




Монитор



Клавиатура



Пульт дистанционного управления

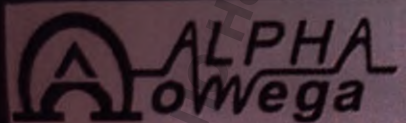

— Defining Neuroscience Technology

Made in Israel
Nazareth Industrial Park Building
Mount Precipice
P.O. Box 2268, Nazareth 1612102
Israel
E-Mail: info@alphapmega-eng.com



Refer to instructions for
use in Users Manual

Product: NeuroSmart

Model: Remote Control



700-006011-00



112



2019-05-15
(YYYY-MM-DD)



Пульт дистанционного управления

Информация
официального сайта
Федерального
надзора в сфере
www.gos



Мышь/сенсорная панель управления



Принтер




Привод CD/DVD

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.goszdravnadzor.ru




Отвертки

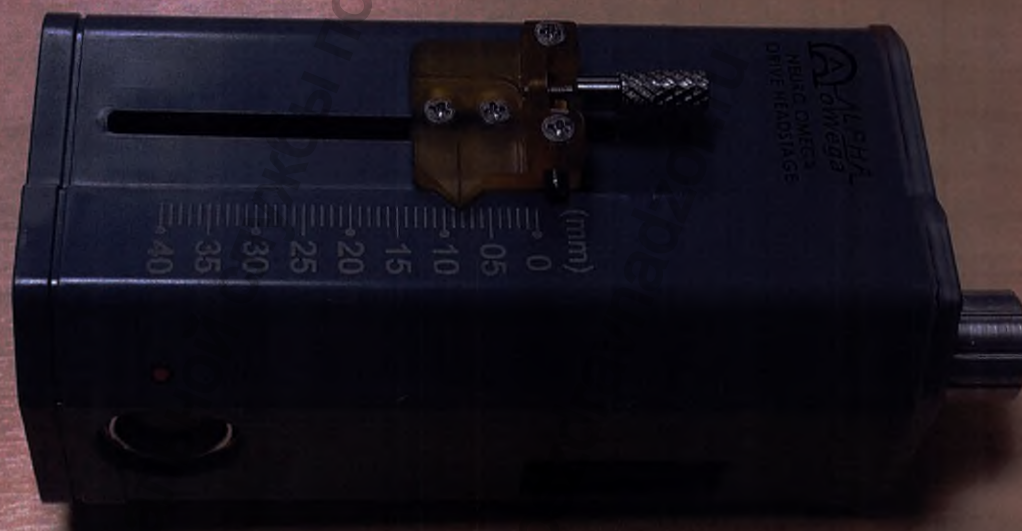


Устройство погружения электродов




Панели

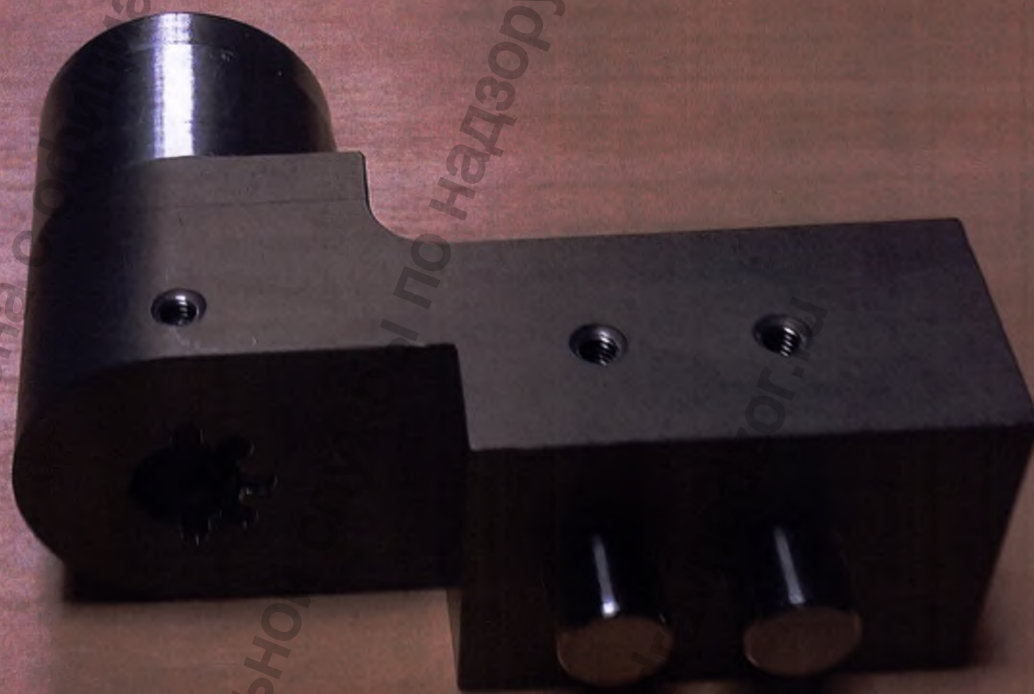


Установочные платформы для устройства погружения электродов

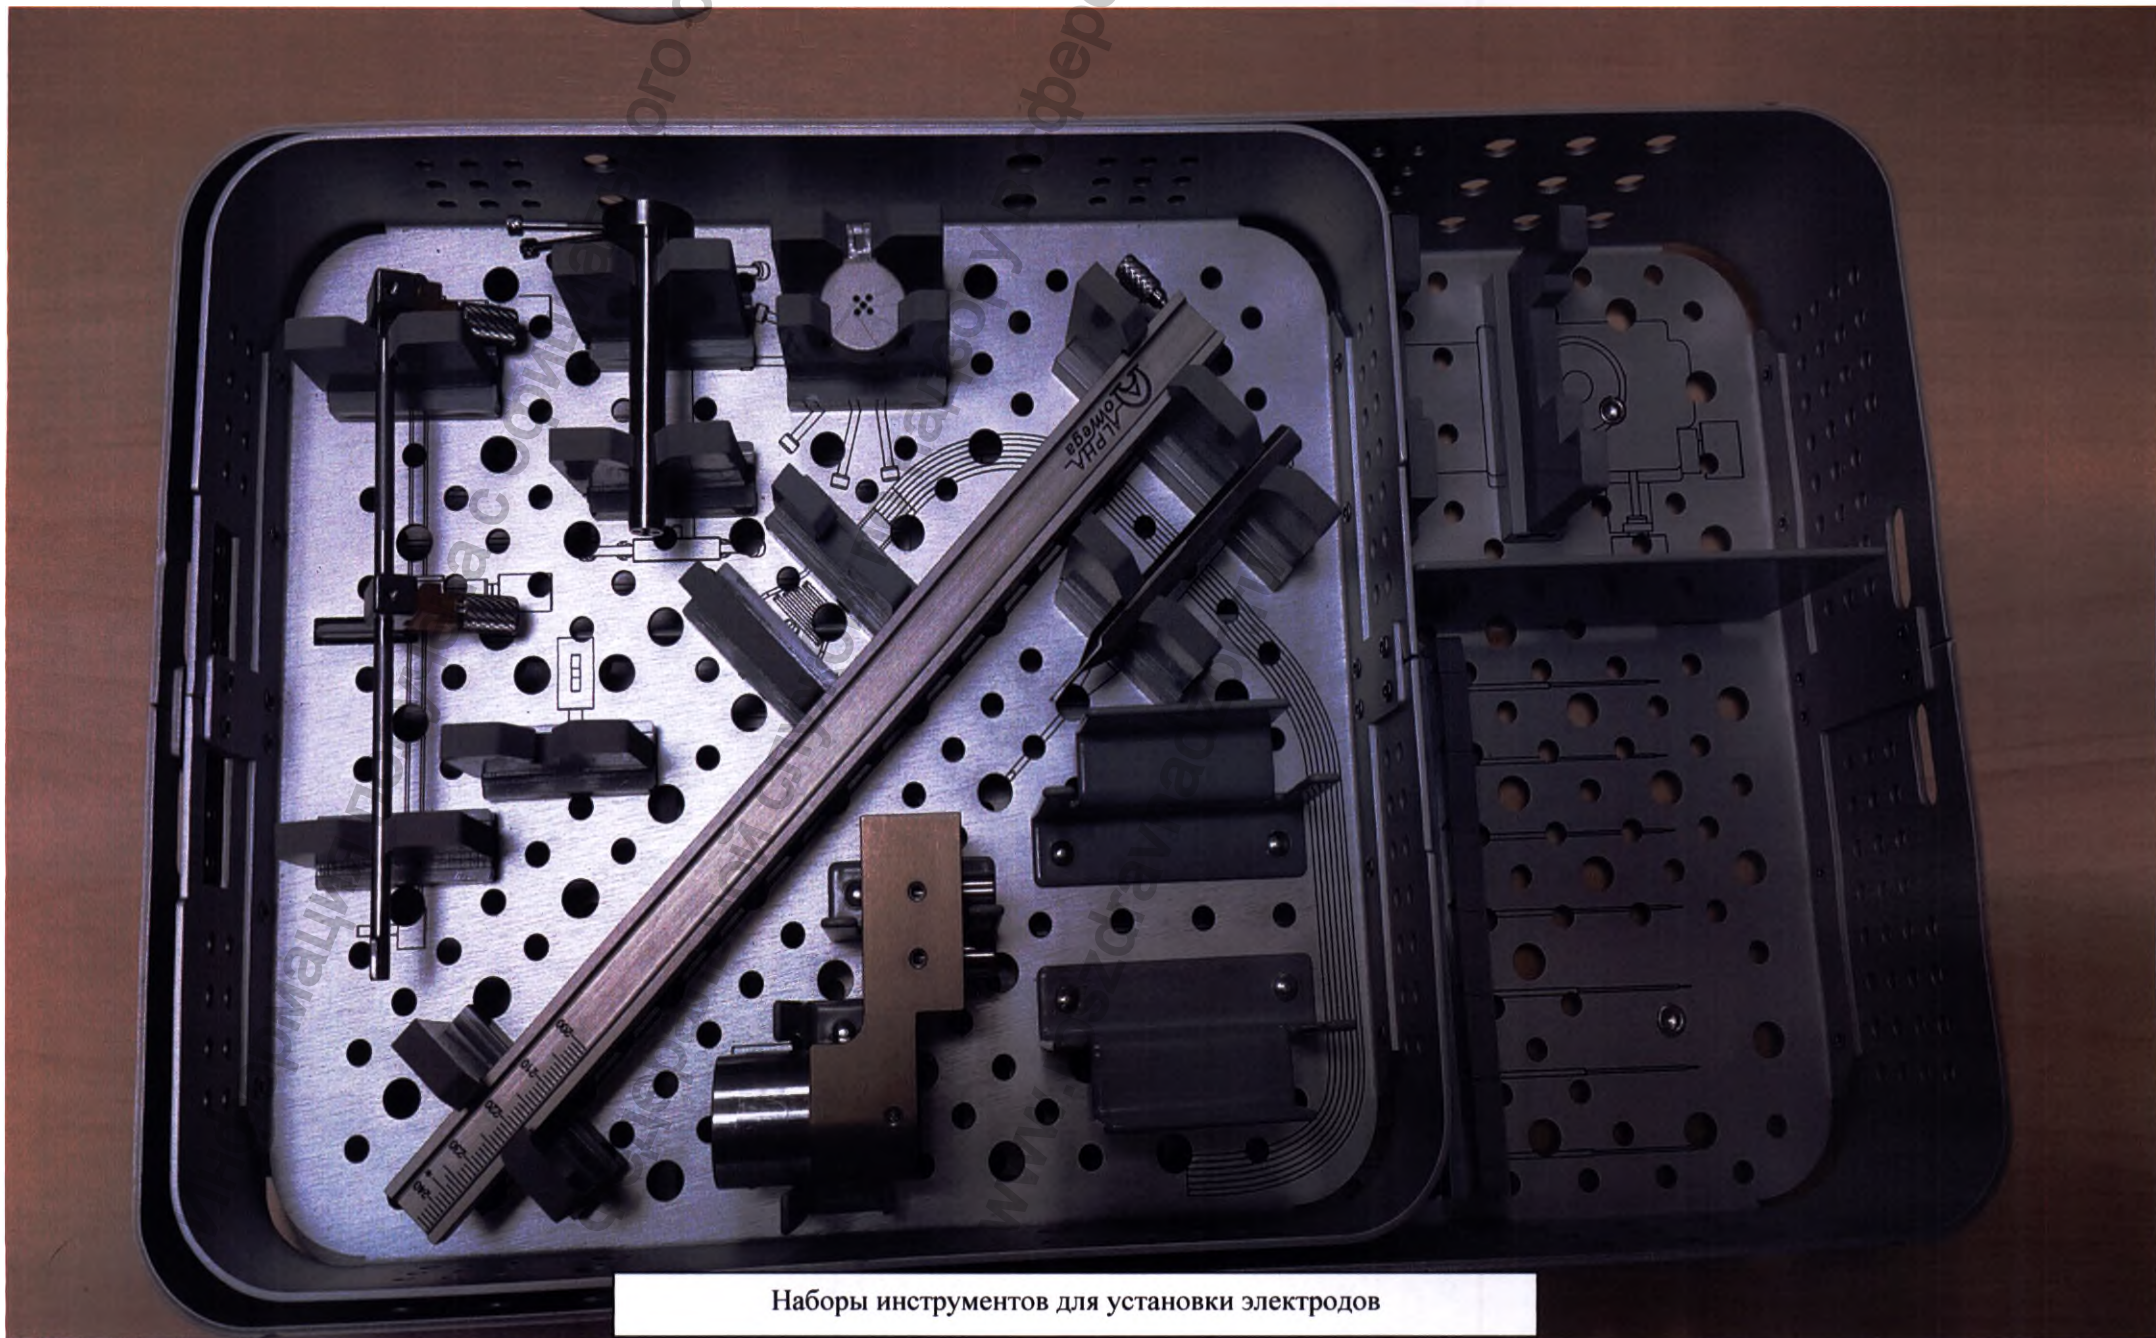


Наборы инструментов для установки электродов

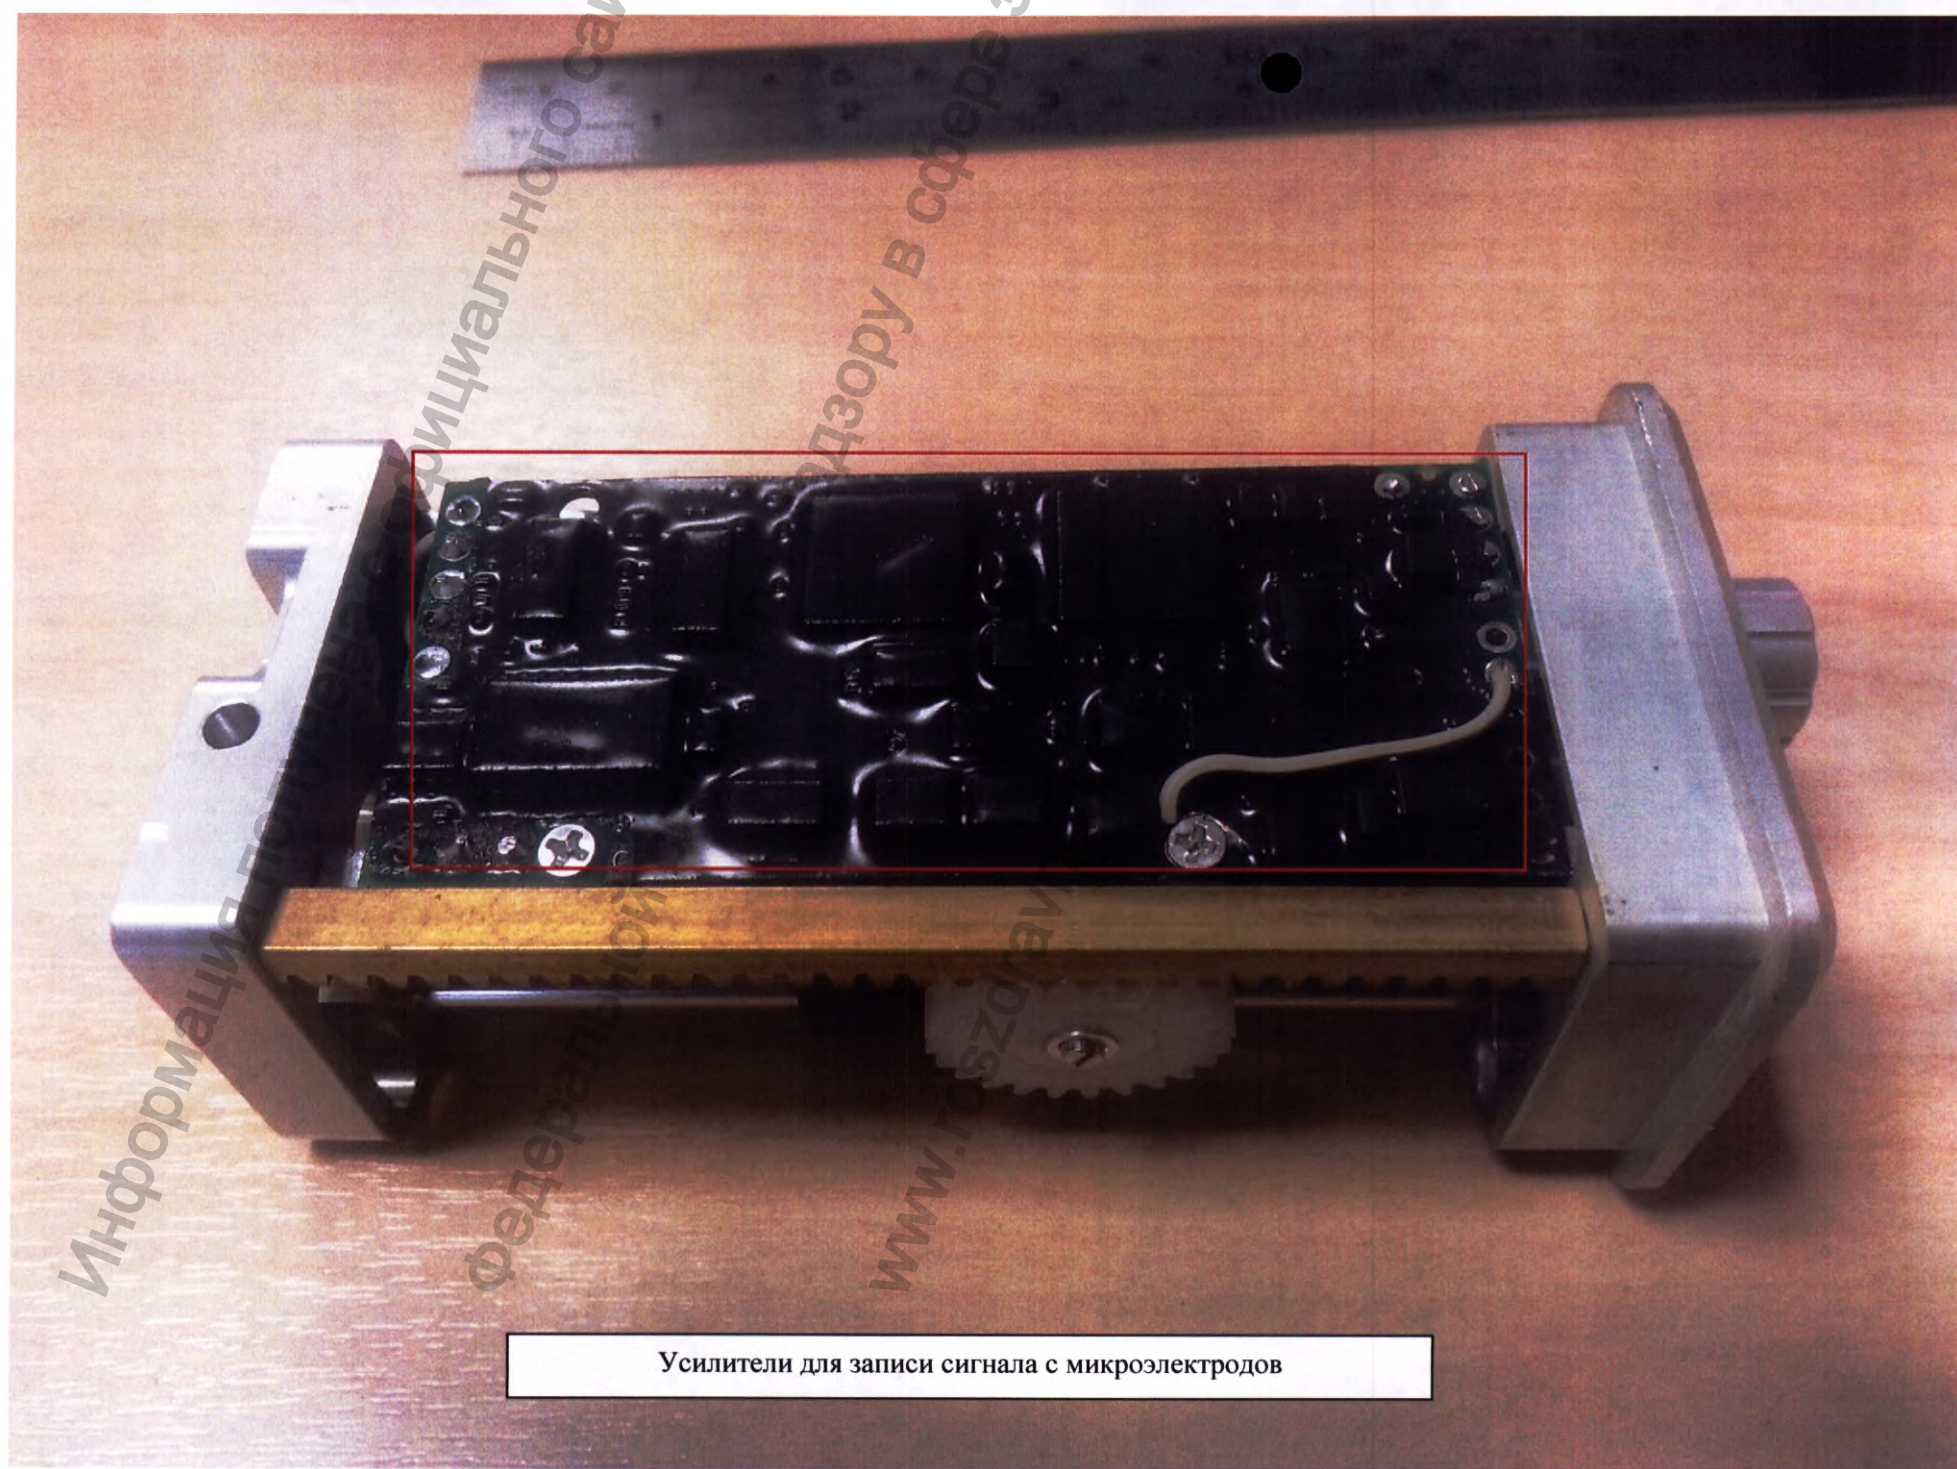


Усилители для записи сигнала с микроэлектродов

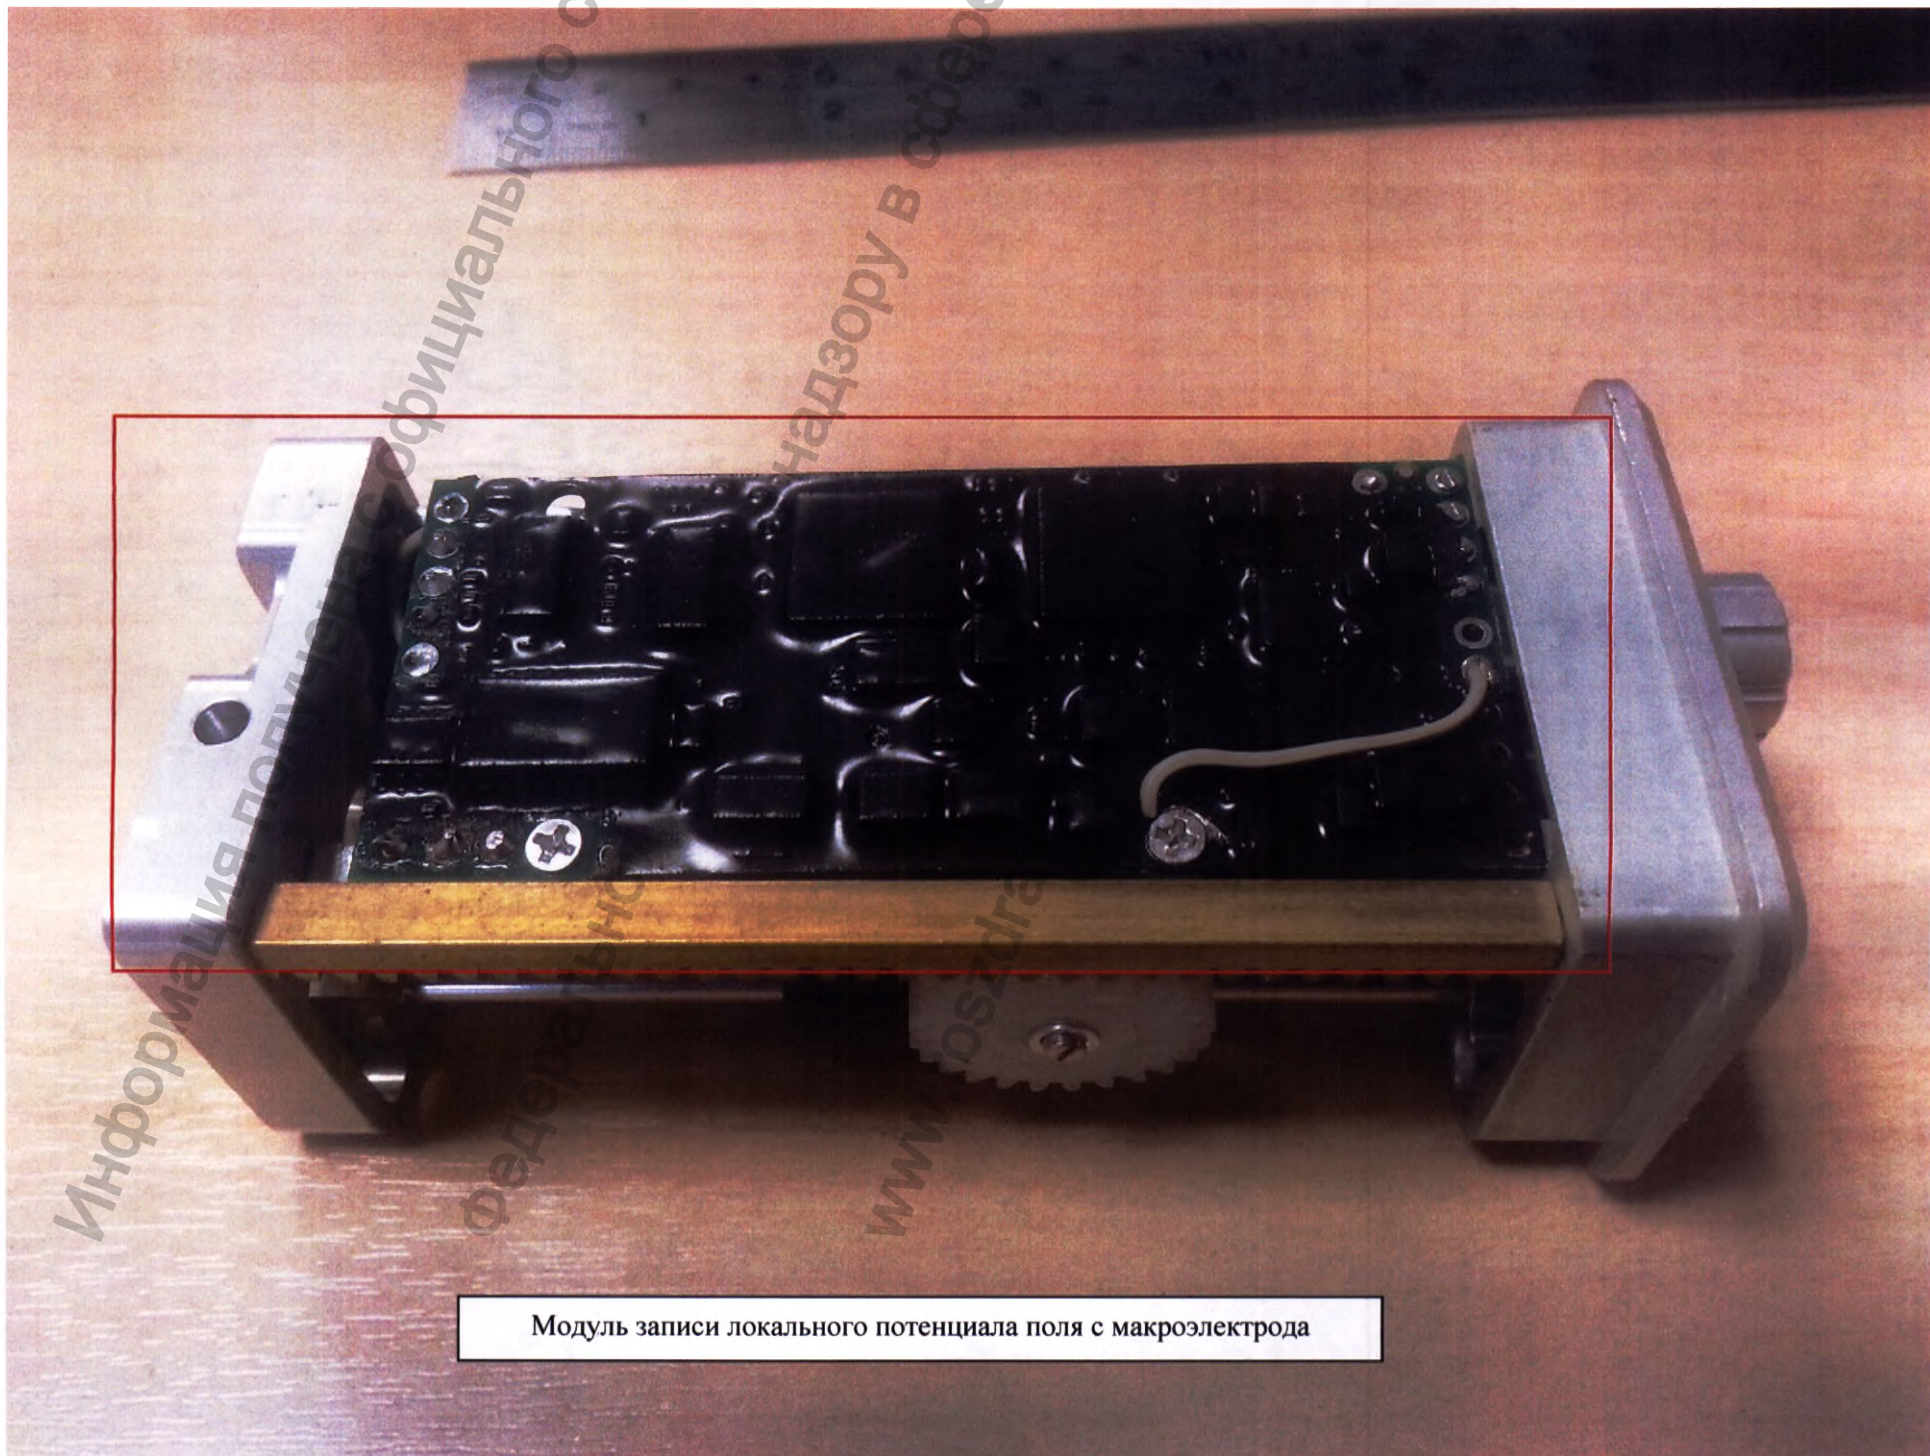

Модуль записи локального потенциала поля с макроэлектродом

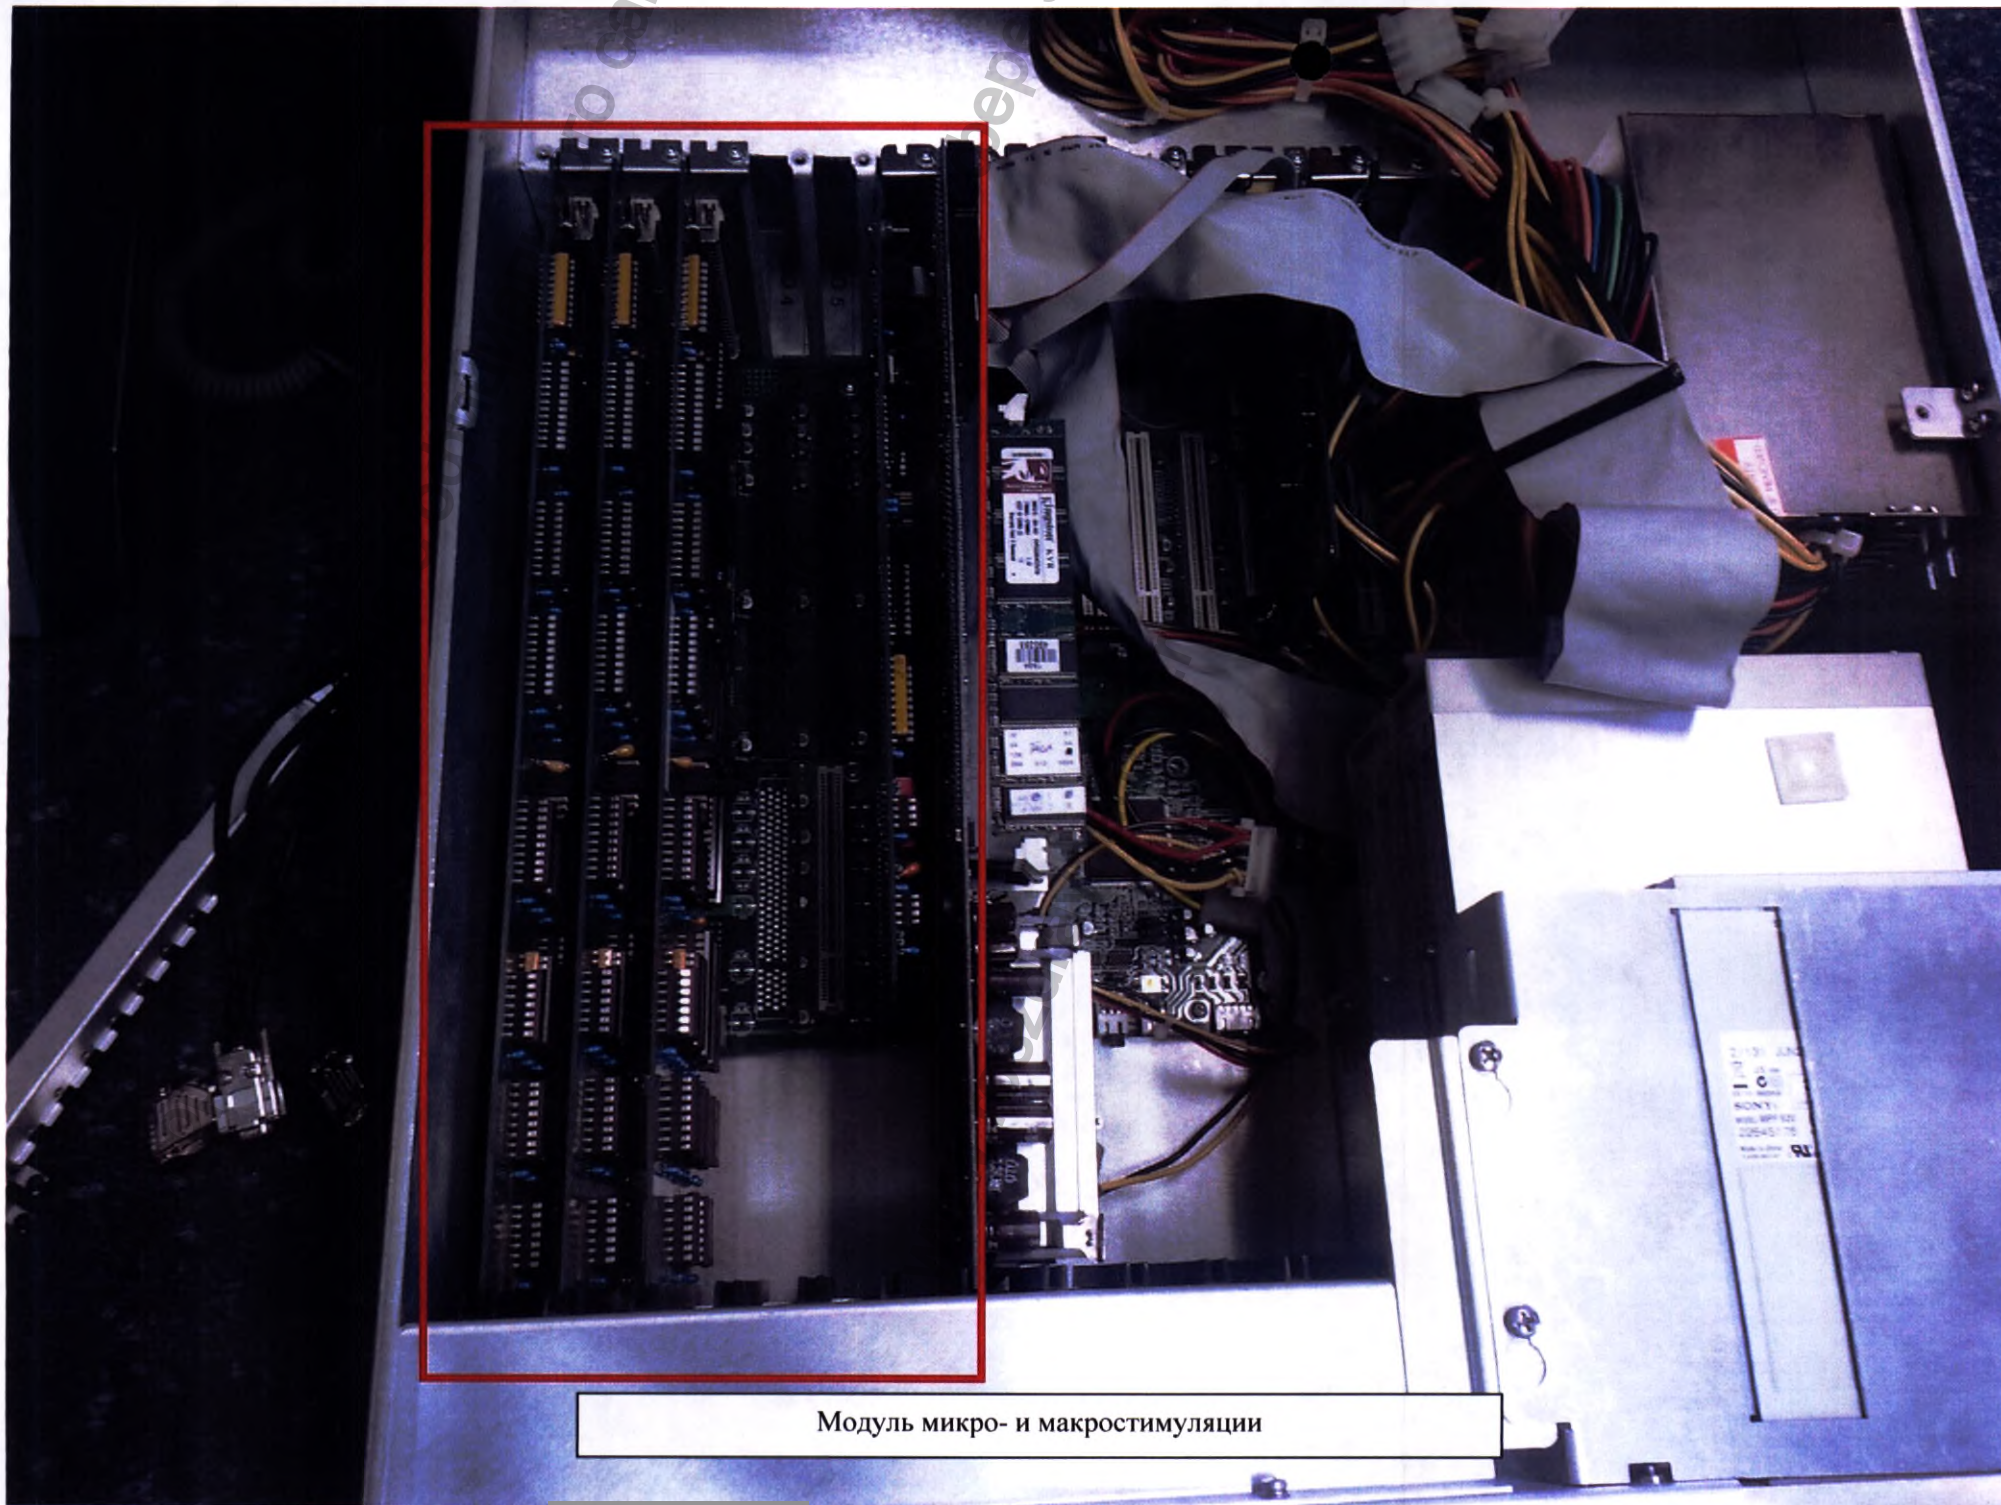

Модуль микро- и макростимуляции

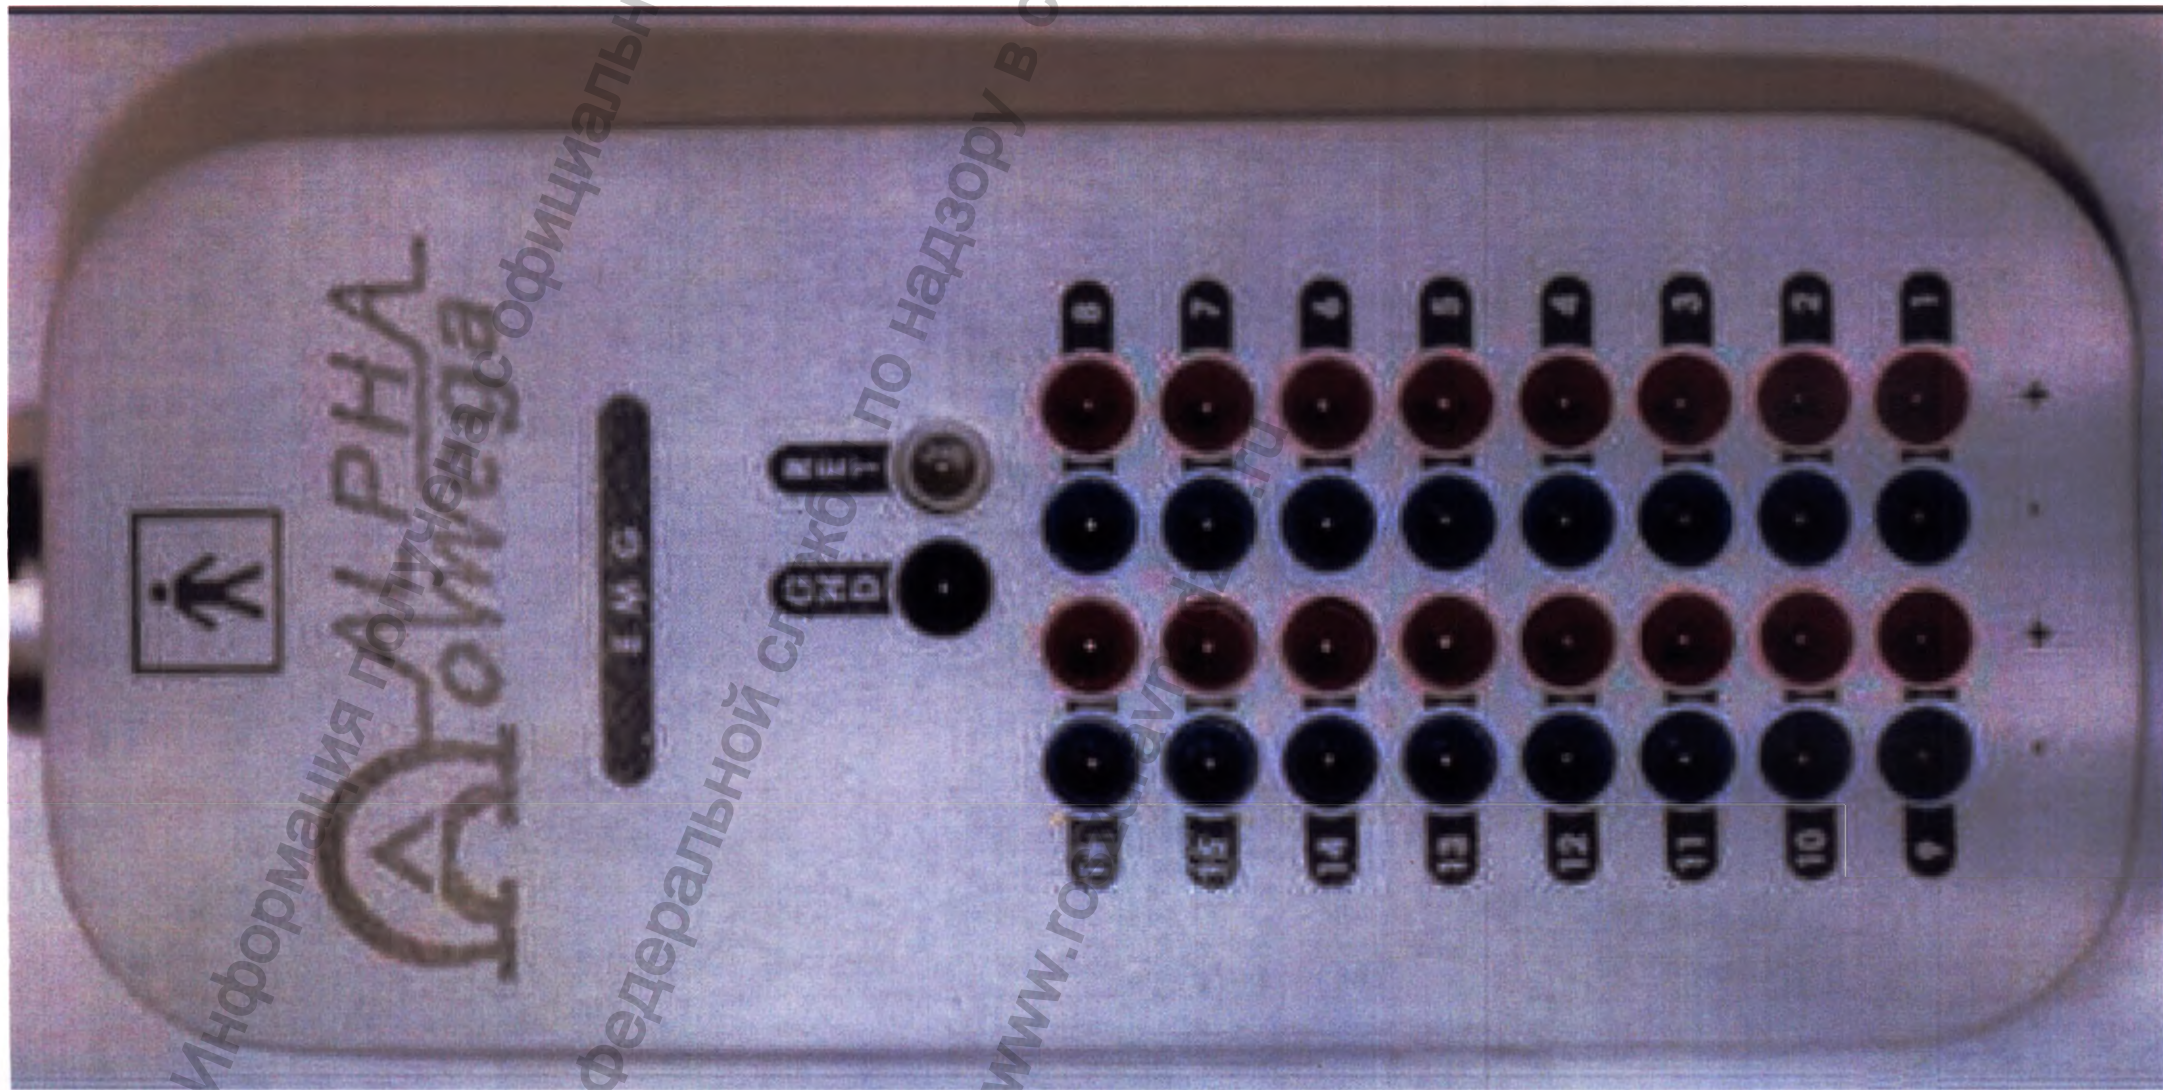

Модули регистрации ЭЭГ, ЭМГ

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdramnadzor.ru



Направляющие трубки и стилеты

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramnadzor.ru




Экранированные электроды

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdrazhnadzor.ru



Неэкранированные электроды

Кейсы для стерилизации, хранения

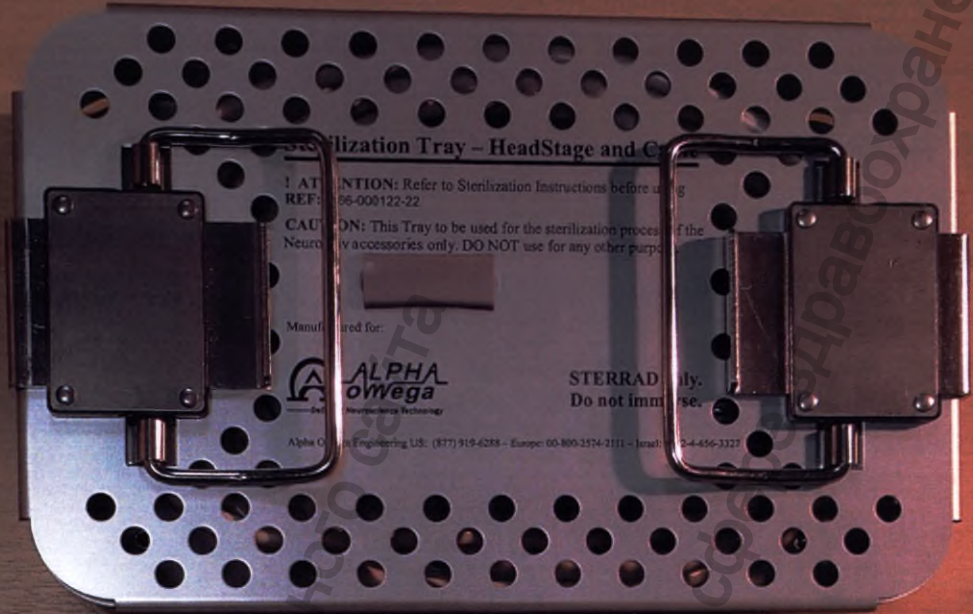

Sterilization Tray - HeadStage and Components

! ATTENTION: Refer to Sterilization Instructions before using.
REF: 366-000122-22


CAUTION: This Tray to be used for the sterilization process of the NeuroNav accessories only. DO NOT use for any other purpose.

Manufactured for:



STERRAD only.
Do not immerse.

Alpha Omega Engineering US: (877) 919-6288 - Europe: 00-800-2574-2111 - Israel: +972-4-656-3327

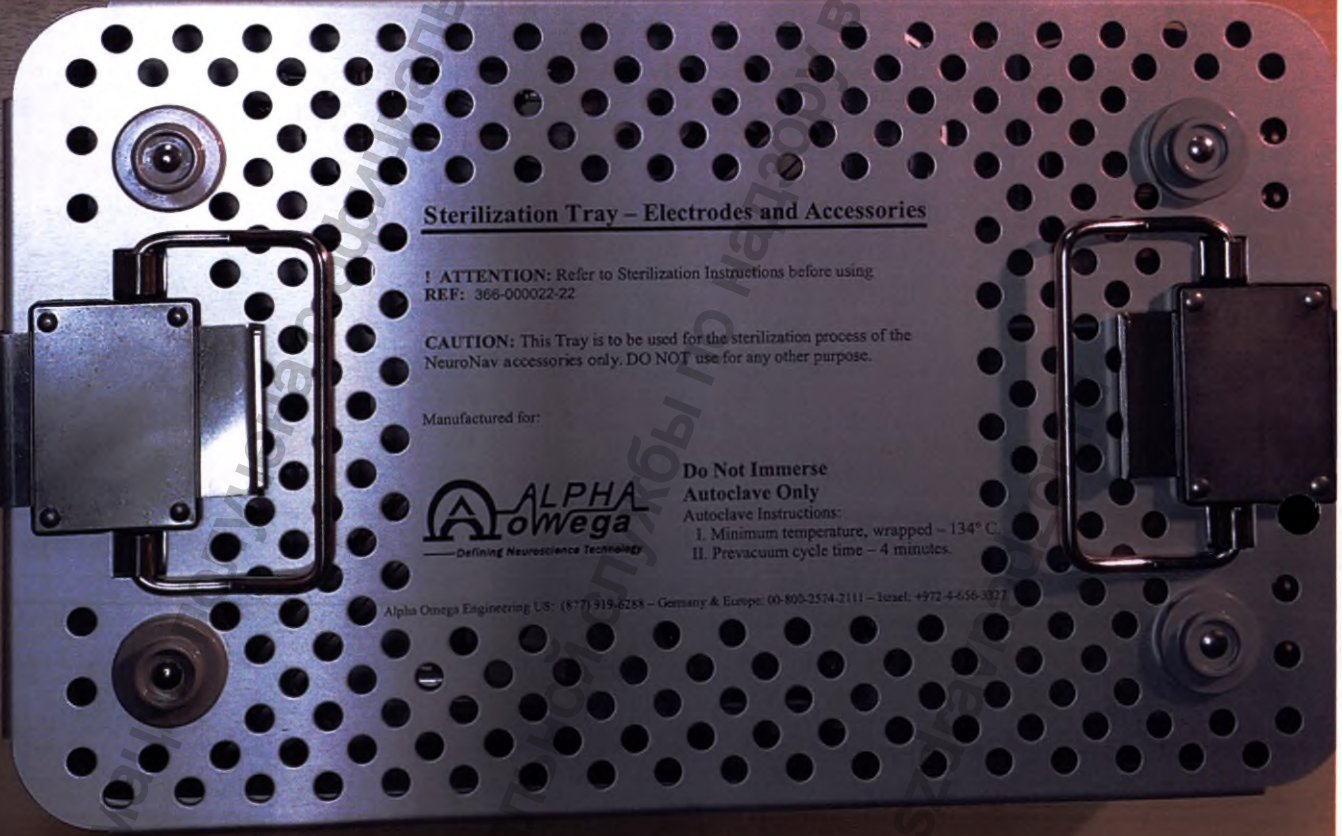

Sterilization Tray - Electrodes and Accessories

! ATTENTION: Refer to Sterilization Instructions before using.
REF: 366-000022-22

CAUTION: This Tray is to be used for the sterilization process of the NeuroNav accessories only. DO NOT use for any other purpose.

Manufactured for:




**Do Not Immerse
Autoclave Only**

Autoclave Instructions:
I. Minimum temperature, wrapped - 134° C.
II. Prevacuum cycle time - 4 minutes.

Alpha Omega Engineering US: (877) 919-6288 - Germany & Europe: 00-800-2574-2111 - Israel: +972-4-656-3327

Информация получена с официального сайта
www.goszdrnadzor.ru
Материалы
www.goszdrnadzor.ru
Трубы по надзору в сфере

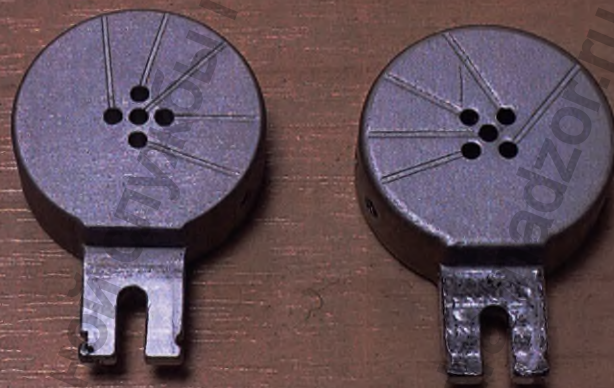


Адаптеры



Информация
получена с официального сайта
Федеральное агентство по надзору в сфере
www.gost.ru
og.ru

Разъемы

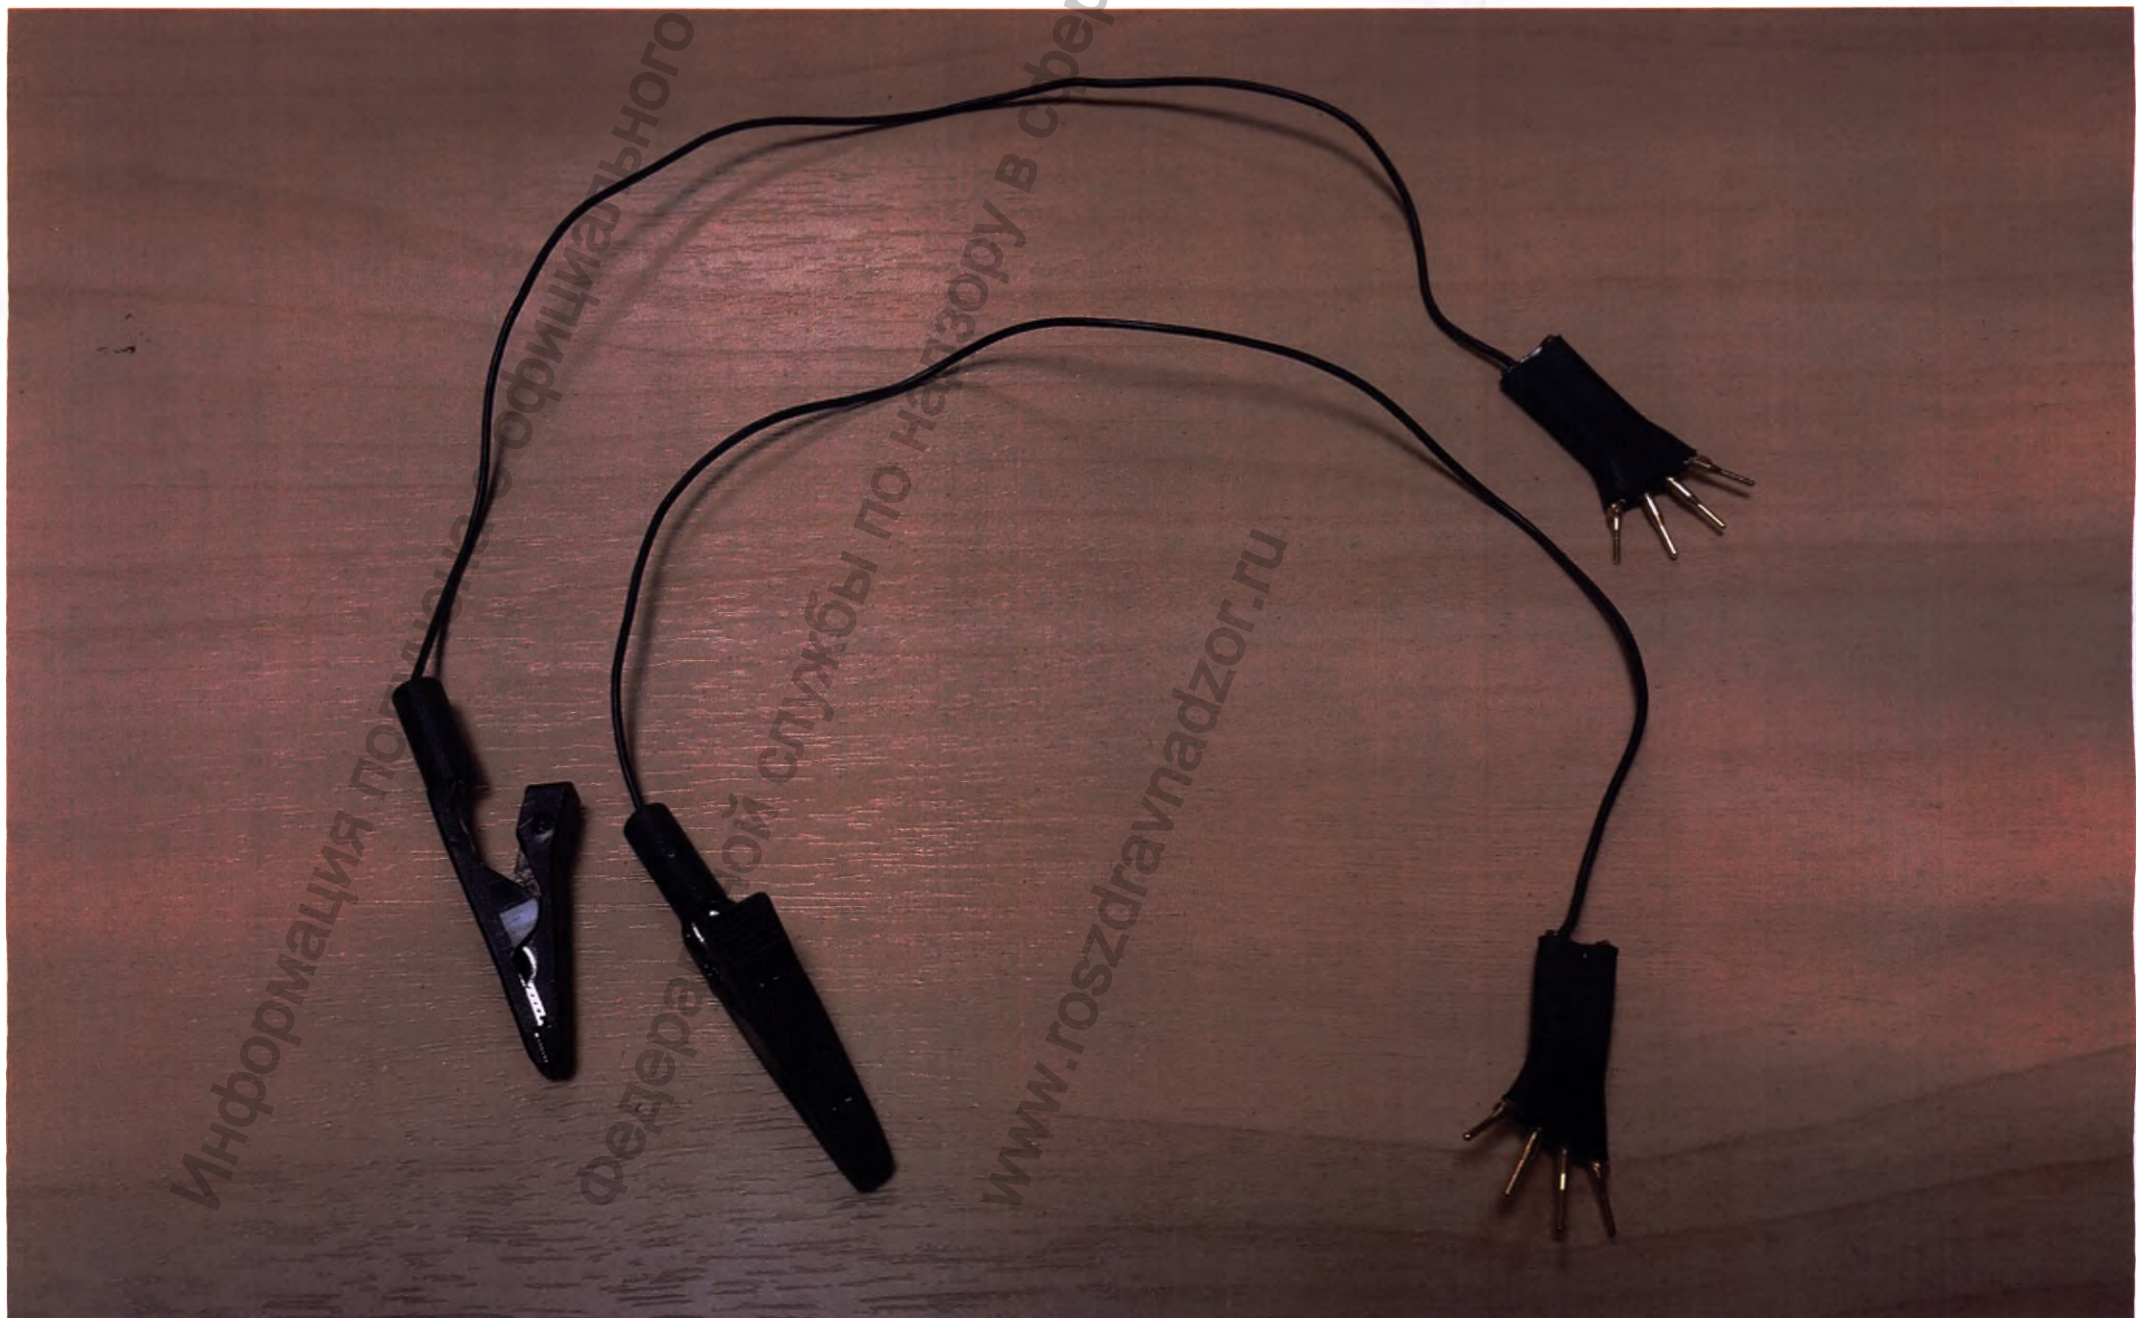

Удлинители кабеля



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
технического регулирования
www.nadzor.ru

Кабели

Винты




Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.goszdravnadzor.ru

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.goszdravnadzor.ru




Держатели электродов


Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.gost.ru

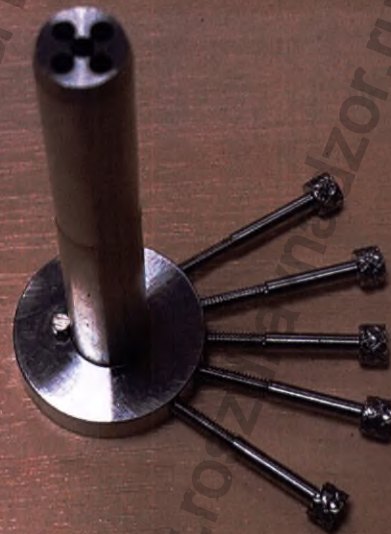


Направляющие электродов

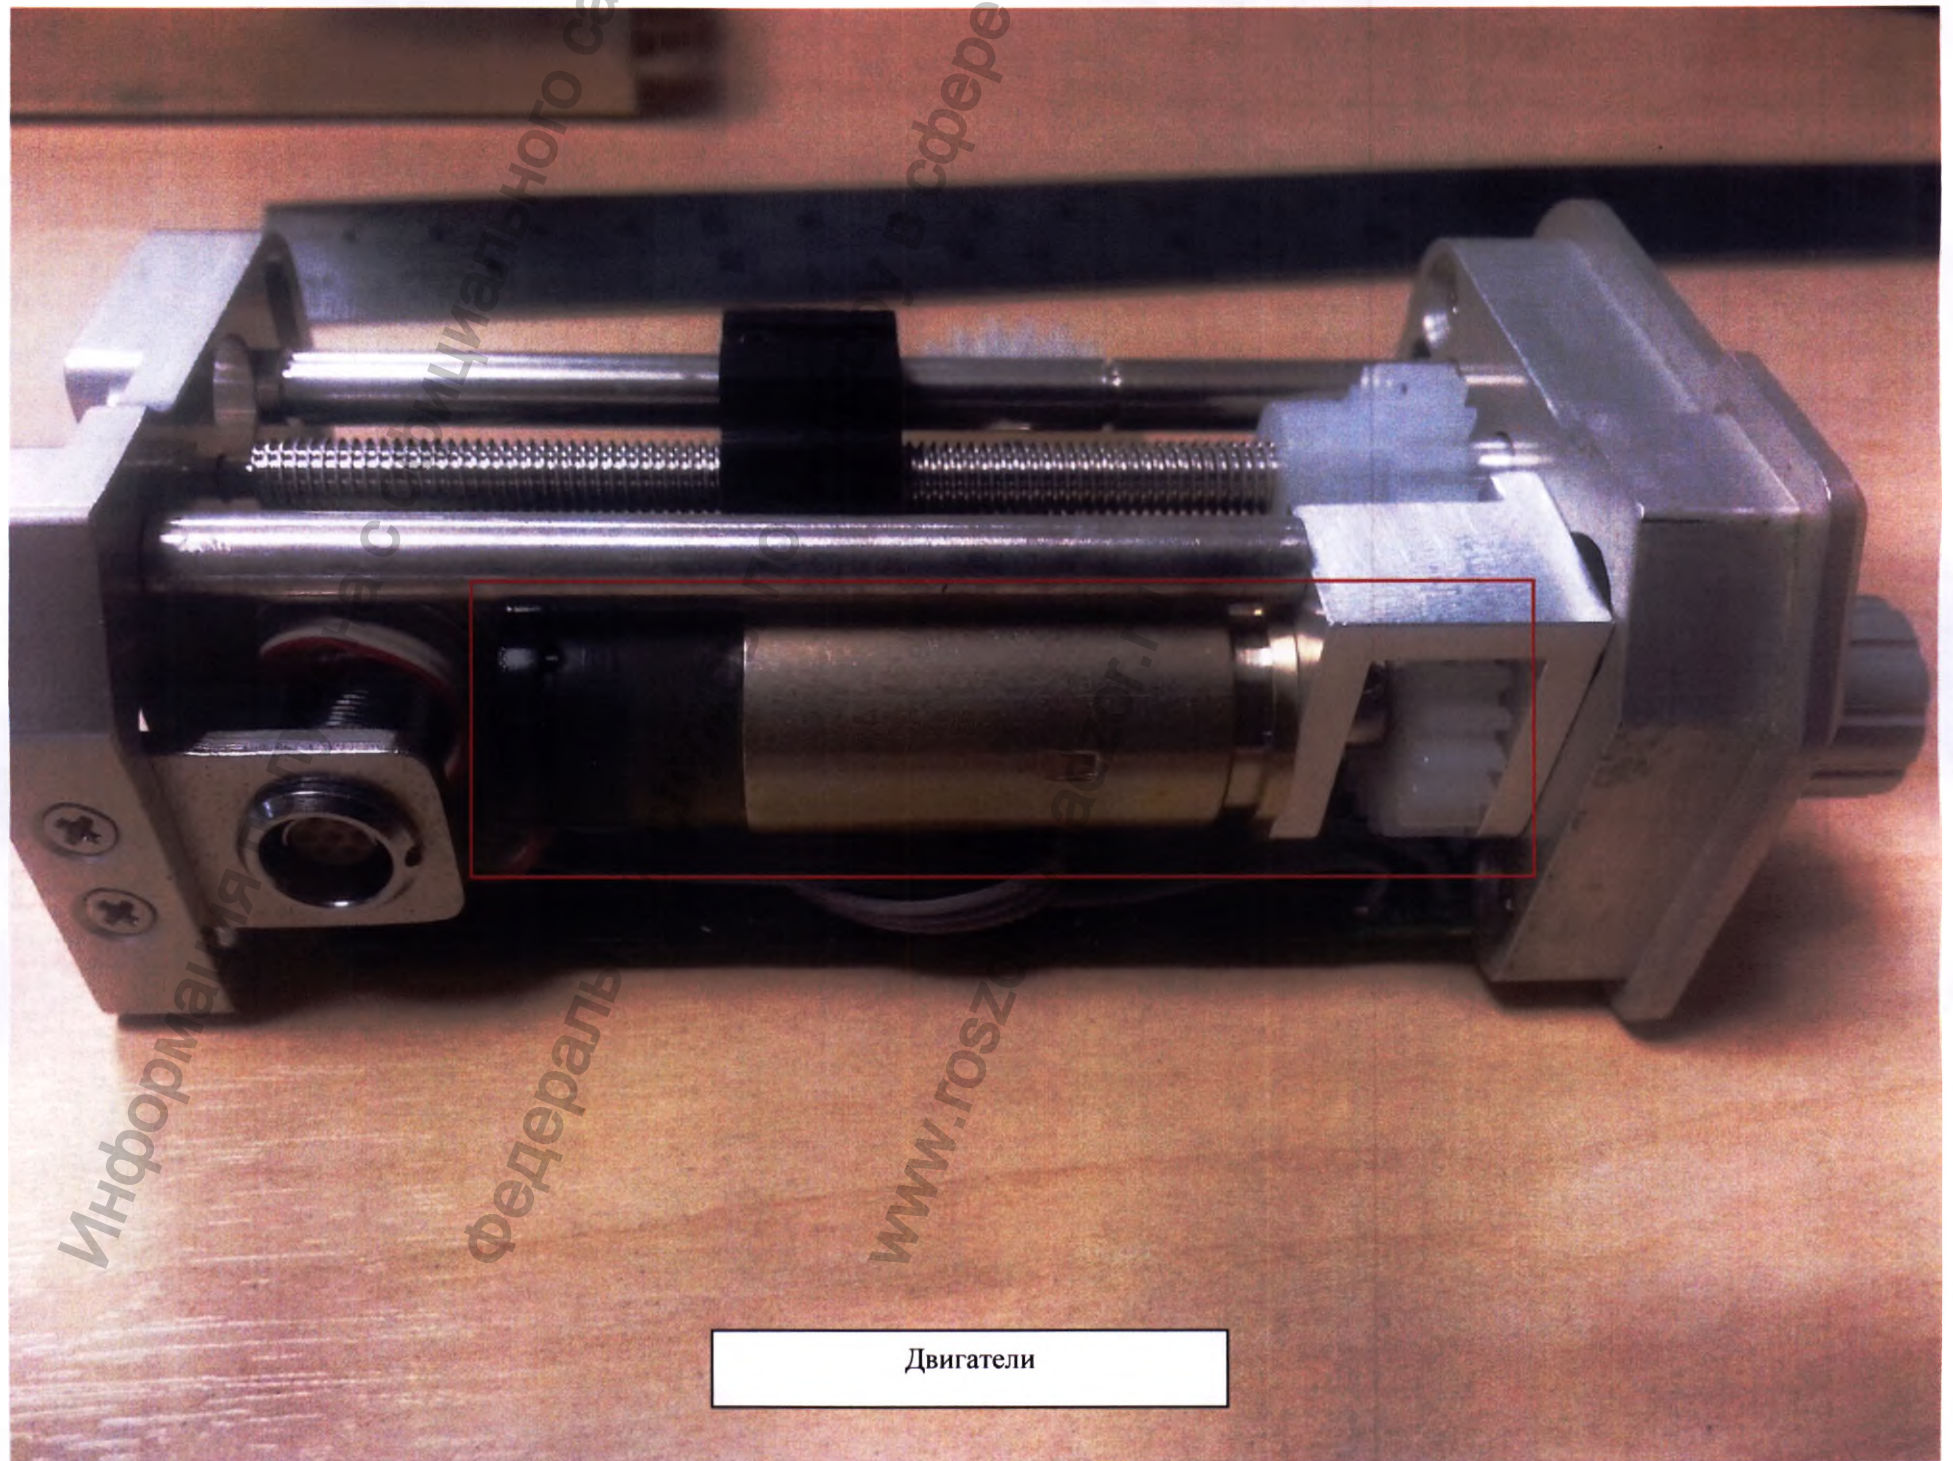

Двигатели

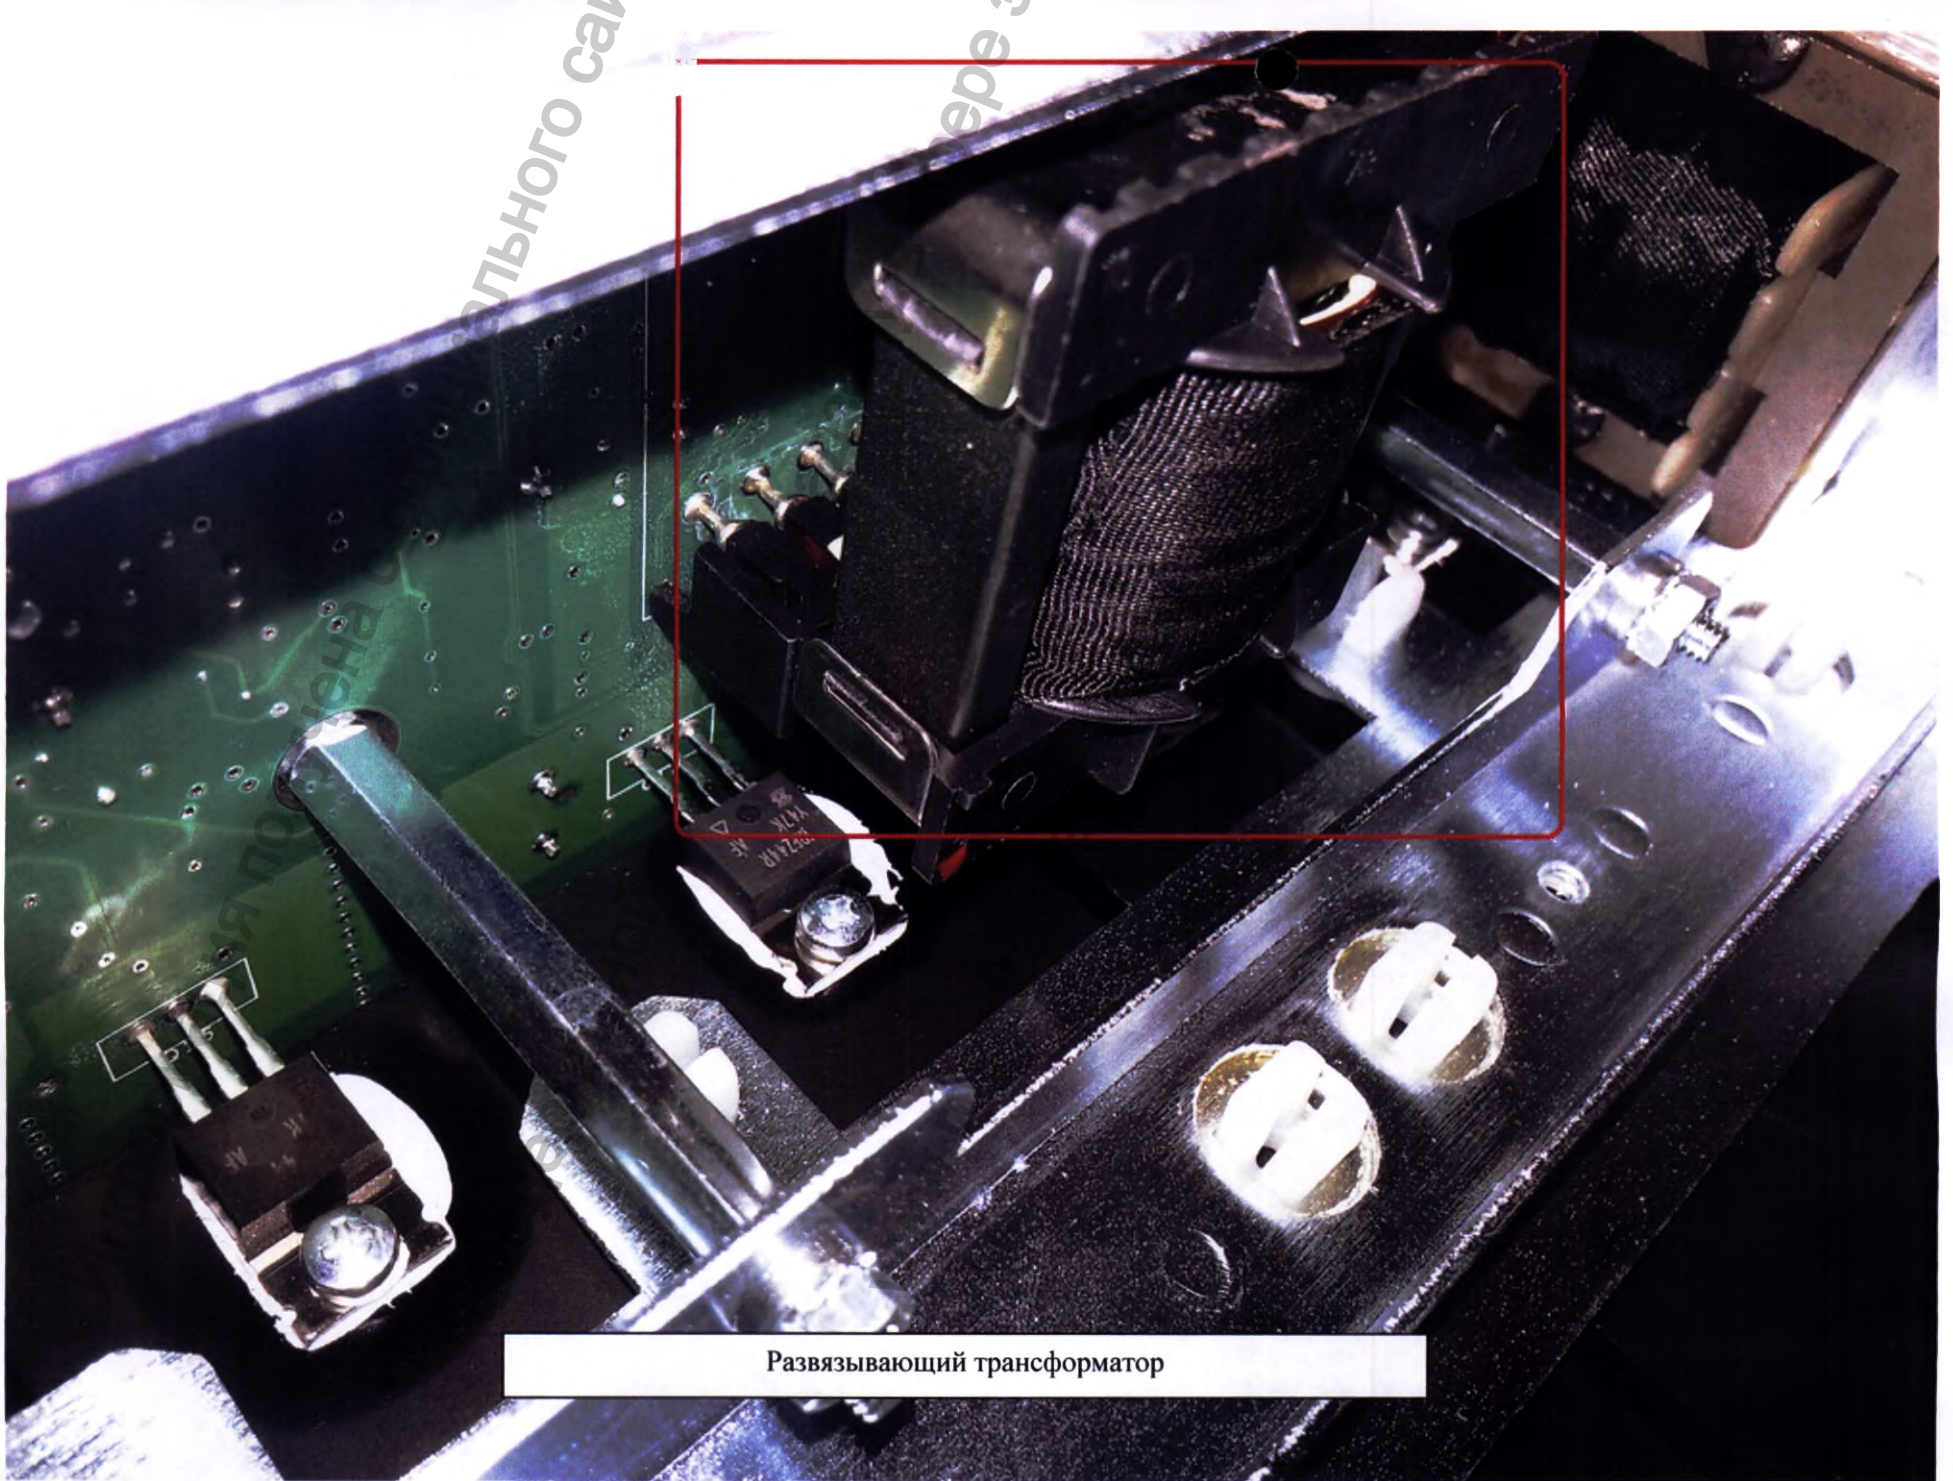

Развязывающий трансформатор

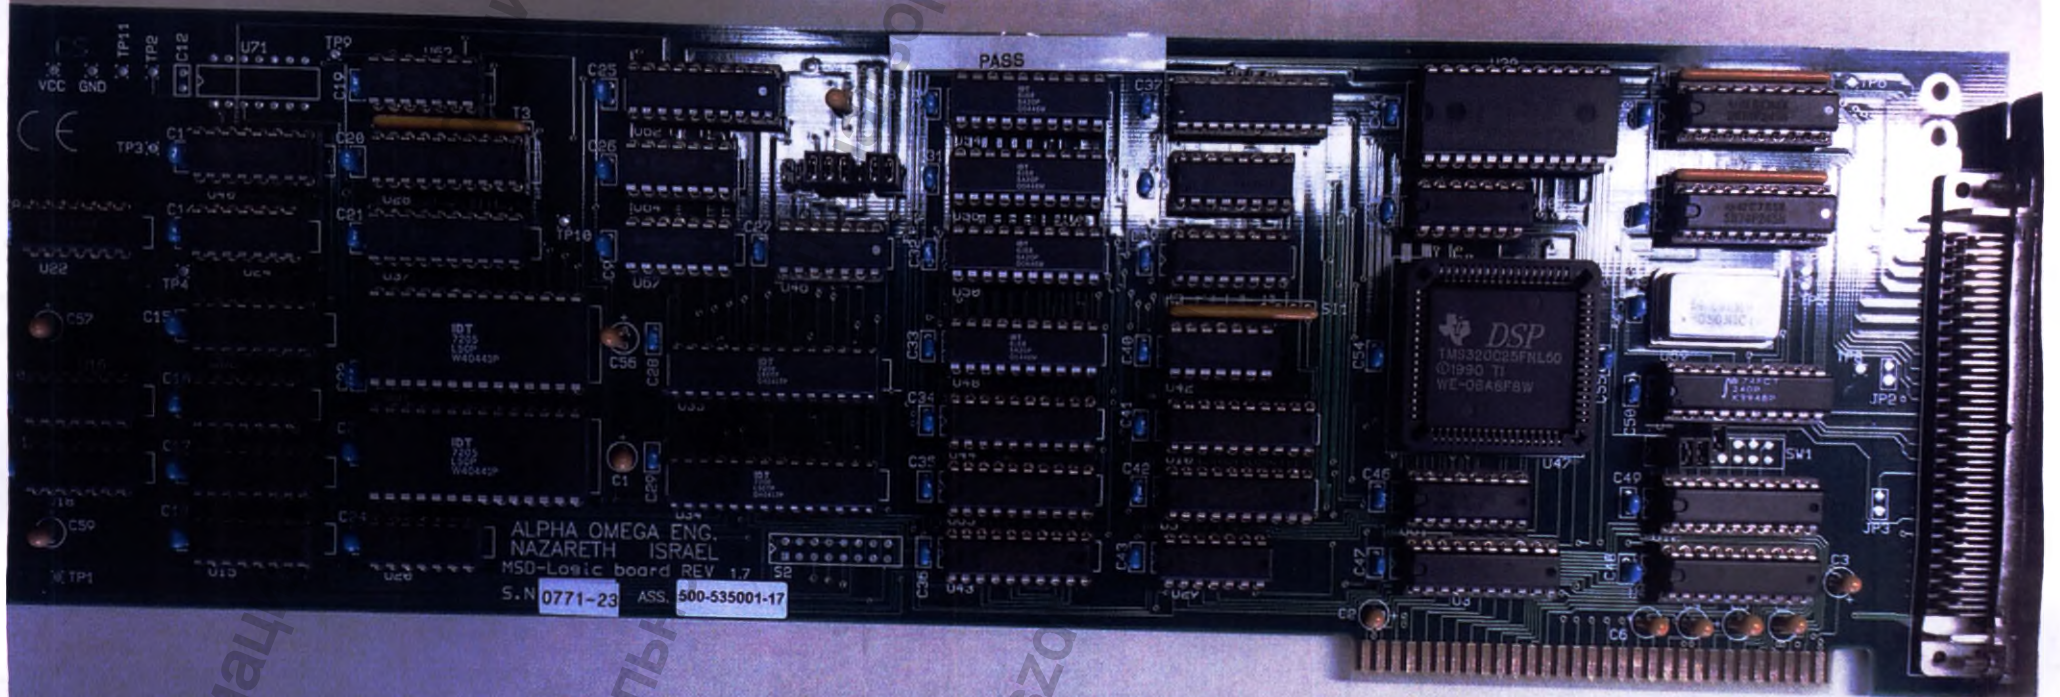

Электронные платы



Линейка

Информация получена с официального сайта

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

47 (Союз Сели) лист 06

Директор Ч / Чебурашкин Д.М.



Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.ru