

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)


Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Вариант 1. Комплектация 1



Внешний вид (комплектаций по ГД-13447/03211 от 01.07.2017)  
на реанентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

ектация 2

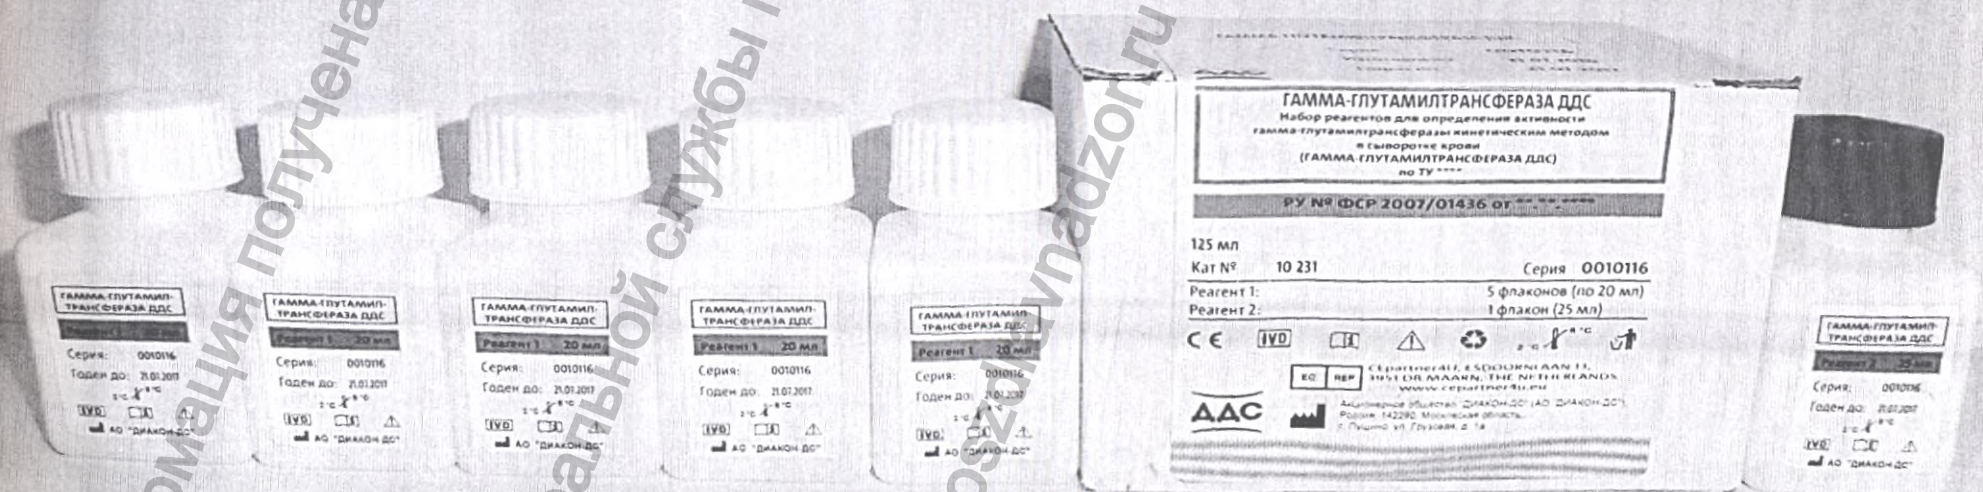

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
[www.gosnadzor.ru](http://www.gosnadzor.ru)

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 3



Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)


набора реактивов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

лекция 4




Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)  
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 5

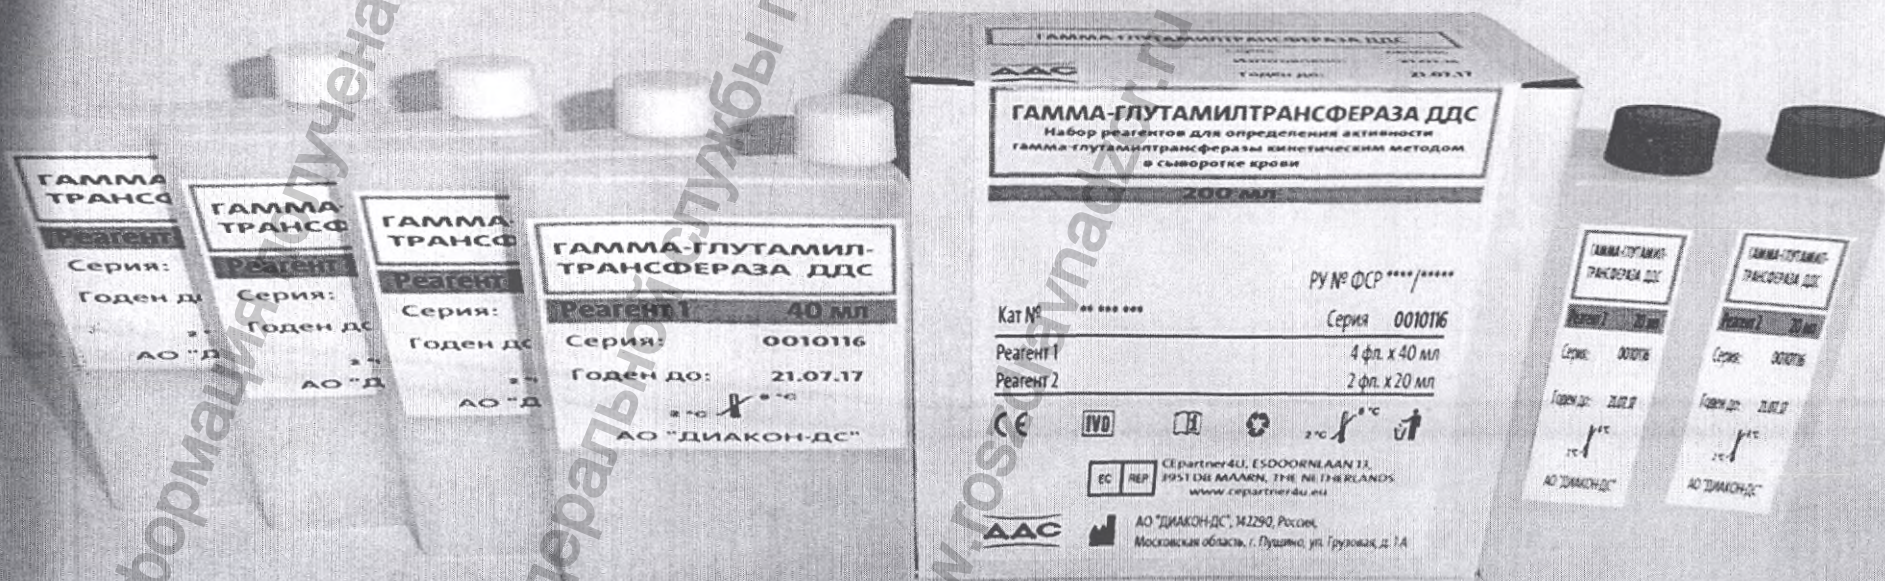

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)  
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 6

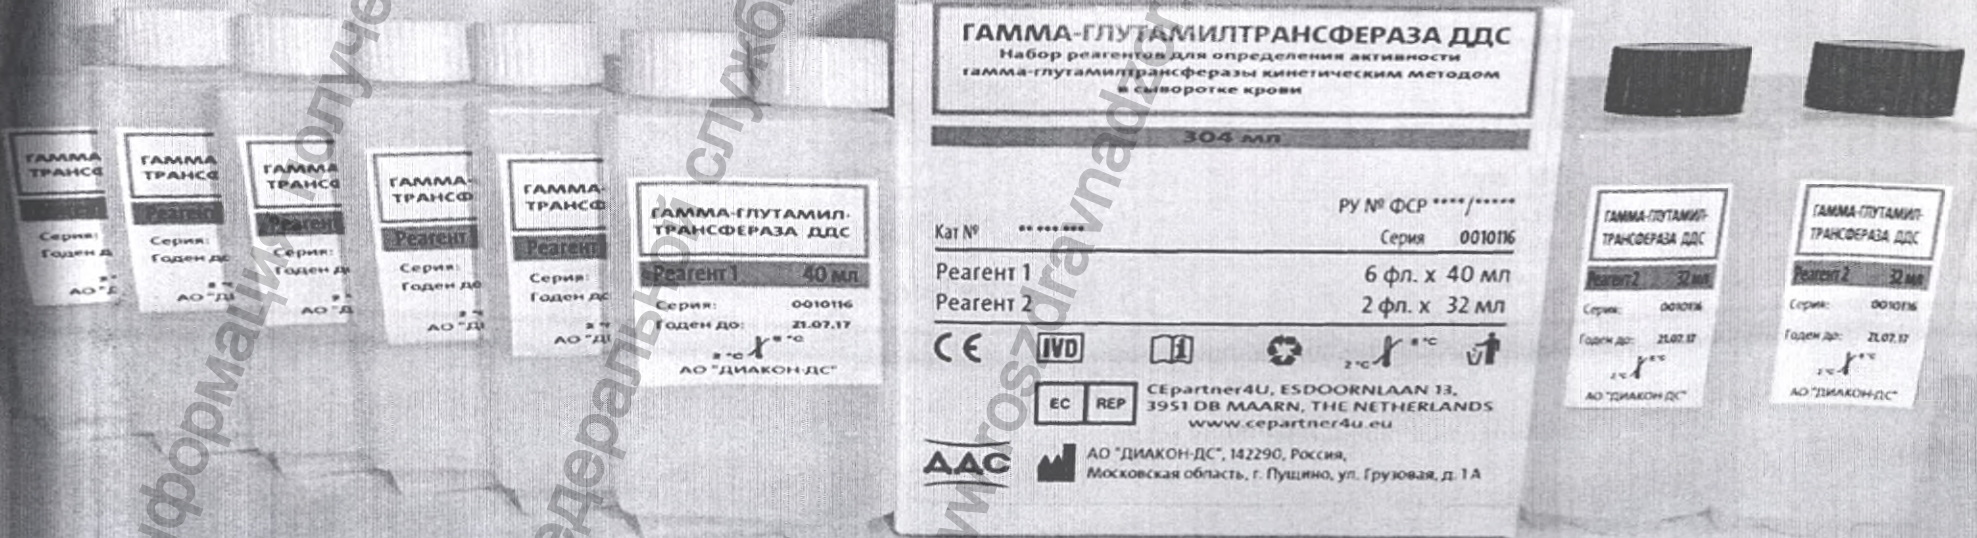

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 7

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС

Реагент 1 68 мл

Серия: 0010116

Годен до: 21.07.17

2°C 8°C

АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС

Реагент 1 68 мл

Серия: 0010116

Годен до: 21.07.17

2°C 8°C

АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС

Набор реагентов для определения активности  
гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом  
в сыворотке крови

170 мл

РУ № ФСР \*\*\*\*/\*\*\*\*\*

Кат № \*\*\*\*\*

Серия 0010116

Реагент 1 2 фл. x 68 мл

Реагент 2 2 фл. x 17 мл

CE IVD I E 2°C 8°C

ЕС REP СЕpartner4U, ES000RNLAAN 13,  
3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS  
www.сеpartner4u.eu

ДАС

АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,  
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

ГАММА-ГЛУТАМ  
ТРАНСФЕРАЗА

РЕАГЕНТ 2

Серия: 001

Годен до: 21.07.17

2°C 8°C

АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМ  
ТРАНСФЕРАЗА

РЕАГЕНТ 2

Серия: 001


Годен до: 21.07.17

2°C 8°C

АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)  
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 8

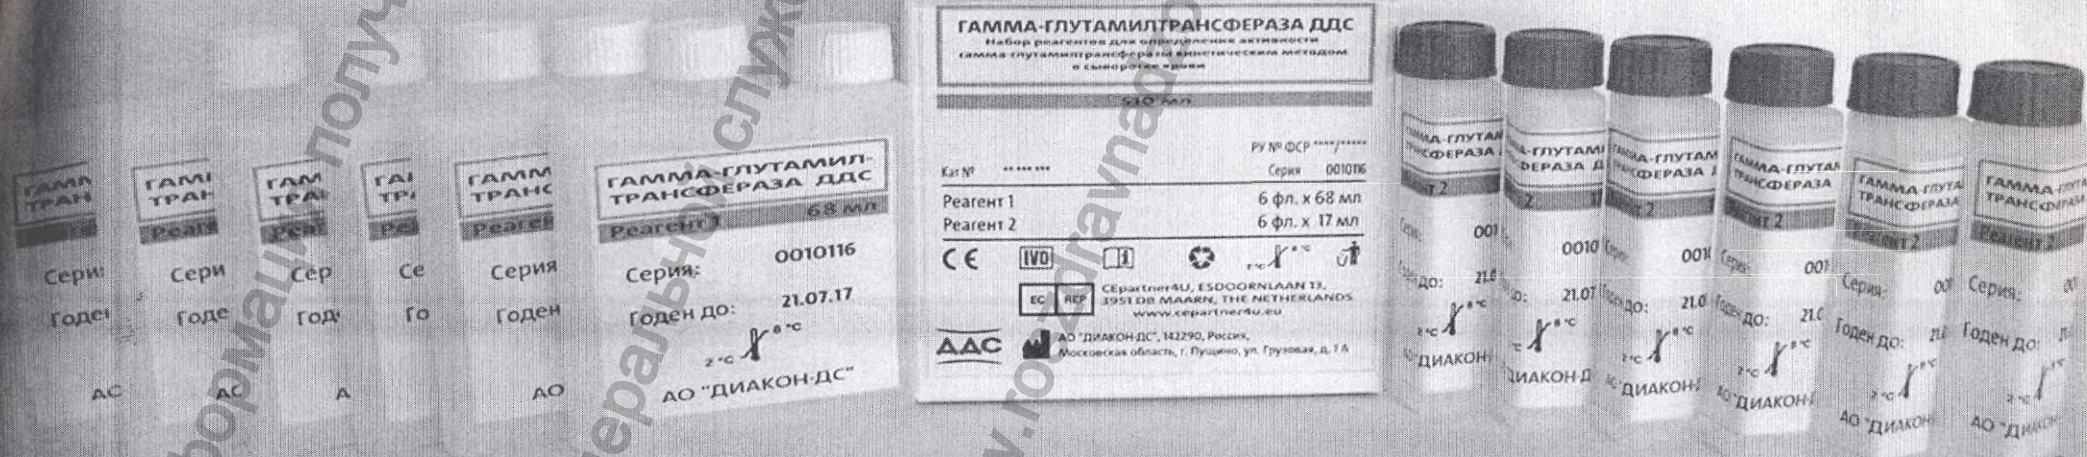



Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)  
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 9

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС

Реагент 1 64 мл

Серия: 0010116

Годен до: 21.07.17

2 °C

АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС

Реагент 1 64 мл

Серия: 0010116

Годен до: 21.07.17

2 °C

АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС

Набор реагентов для определения активности  
гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом  
в сыворотке крови

1000 ml

РУ № ОСР \*\*\*\*/\*\*\*\*\*

Кат № \*\*\*\*

Серия 0010116

Реагент 1 2 фл. х 64 мл

Реагент 2 2 фл. х 20 мл

CE IVD

EC REP

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,  
3951 DB MAAKRE, THE NETHERLANDS  
www.cepartner4u.eu

ДАС

АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,  
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовик, д. 1А

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС

Реагент 2 20 мл

Серия: 0010116

Годен до: 21.07.17

2 °C

АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)  
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 10



ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС  
Реагент 1 64 мл  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2°C X 8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС  
Набор реагентов для определения активности  
гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом  
в сыворотке крови  
Кат № \*\*\*\*\* Серия 0010116  
Реагент 1 6 фл. x 64 мл  
Реагент 2 6 фл. x 20 мл  
CE IVD ISO 9001  
www.seraatlab.ru  
АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,  
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2°C X 8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2°C X 8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2°C X 8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2°C X 8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2°C X 8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛ-  
ТРАНСФЕРАЗА ДДС  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2°C X 8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)  
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 11

**ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
Реагент 1 65 мл  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2°C  
АО "ДИАКОН-ДС"

**ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
Реагент 2 65 мл  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2°C  
АО "ДИАКОН-ДС"

**ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
Кат № ...  
Серия 0010116  
Реагент 1 2 фл. х 65 мл  
Реагент 2 2 фл. х 20 мл  
CE IVD  
CE partner4U, ES DOORNLAAN 11, 1951 DH MAAK, THE NETHERLANDS  
www.cepartner4u.eu  
АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская область, с. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

**ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
Реагент 1 20 мл  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2°C  
АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

# Набора реagens для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 12



**ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
Набор reagens для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови

270 мл


Кат № \*\*\*\* РУ № ФСР 2007/01436 Серия 0010116

Реагент 1	6 фл. x 33 мл
Реагент 2	6 фл. x 12 мл

CE IVD

ES REP Серpartner B.V. ESDOORNLAAN 13, 3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS www.cpartnerb.v.u


АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1А

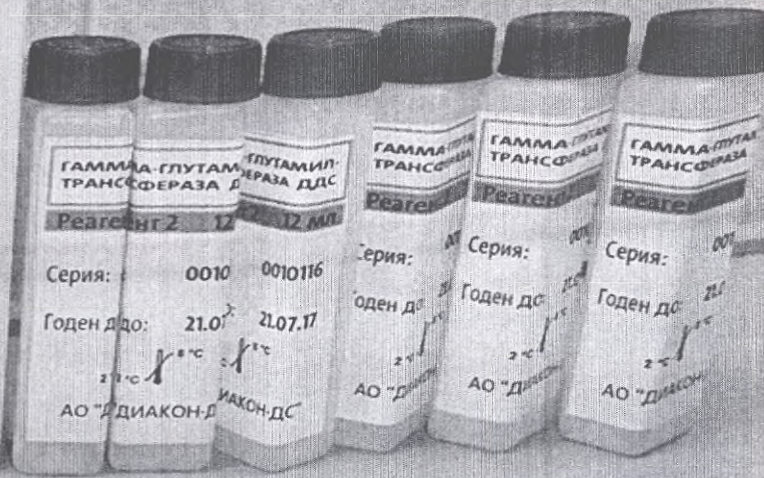

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 13

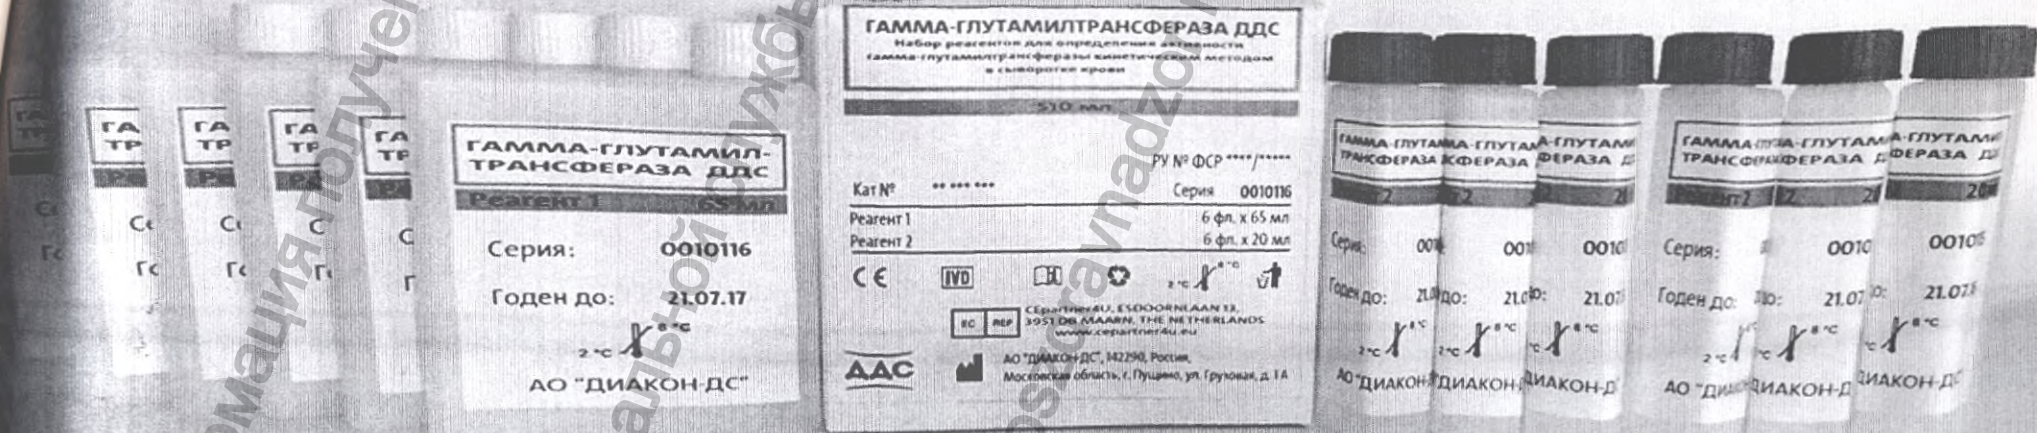

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 14



Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

# Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 15



Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
www.goszdramnadzor.ru

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)


Комплектация 16





Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)  
 Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
 (ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 17

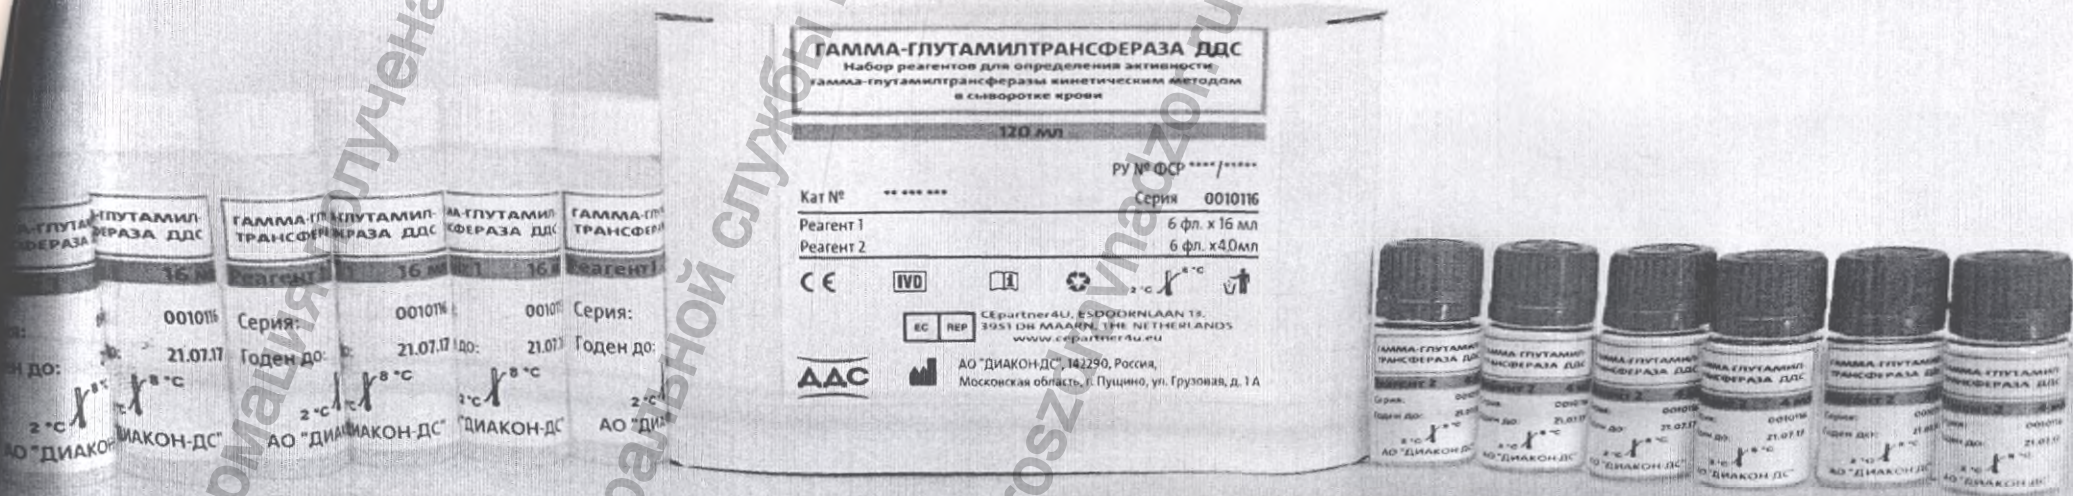

**ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
 Набор реагентов для определения активности  
 гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом  
 в сыворотке крови

120 мл

РУ № ФСР \*\*\*\*/\*\*\*\*\*

Кат № \*\* \*\*\* \*\* Серия 0010116

Реагент 1 6 фл. x 16 мл  
 Реагент 2 6 фл. x 4,0 мл

CE IVD IA 2°C 37°C

EC REP CE partner A1, ES-DOORNLAAN 1E,  
 3951 DR MAARN, THE NETHERLANDS  
 www.cerattier.nl

**ДАС** АО "ДИАКОН ДС", 142290, Россия,  
 Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС  
 16 мл РЕАГЕНТ 1  
 0010116 Серия:  
 21.07.17 Годен до:

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС  
 16 мл РЕАГЕНТ 2  
 0010116 Серия:  
 21.07.17 Годен до:

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС  
 16 мл РЕАГЕНТ 1  
 0010116 Серия:  
 21.07.17 Годен до:

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС  
 16 мл РЕАГЕНТ 2  
 0010116 Серия:  
 21.07.17 Годен до:

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС  
 16 мл РЕАГЕНТ 1  
 0010116 Серия:  
 21.07.17 Годен до:

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС  
 16 мл РЕАГЕНТ 2  
 0010116 Серия:  
 21.07.17 Годен до:

Информация получена с официального сайта  
 Федеральной службы по надзору в сфере  
 www.gosz.ru

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 18

ГАМ ТРА	ГАМ ТРА	ГАМ ТРА	ГАММА-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реаг	Реаг	Реаг	Реагент 1 62 мл
Сер	Сер	Сер	Серия: 0010116
Год	Год	Год	Годен до: 21.07.17
A	AC	AC	2°C АО "ДИАКОН-ДС"

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС  
Набор реагентов для определения активности  
гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом  
в сыворотке крови

320 мл

ПУ № ФСР \*\*\*\*/\*\*\*\*\*

Серия 0010116

Кат № \*\* \*\*\*\*

Реагент 1 4 фл. х 62 мл

Реагент 2 4 фл. х 18 мл

CE IVD

EC REP

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,  
3951 DB MAAKN, THE NETHERLANDS  
www.cepartner4u.eu


АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,  
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

ГАММА-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА ДДС	ГАММА-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА ДДС	ГАММА-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА ДДС	ГАММА-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА ДДС
Реагент 2 18 мл	Реагент 2 18 мл	Реагент 2 18 мл	Реагент 2 18 мл
Серия: 0010116	Серия: 0010116	Серия: 0010116	Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17	Годен до: 21.07.17	Годен до: 21.07.17	Годен до: 21.07.17
2°C АО "ДИАКОН-ДС"	2°C АО "ДИАКОН-ДС"	2°C АО "ДИАКОН-ДС"	2°C АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)



Комплектация 19

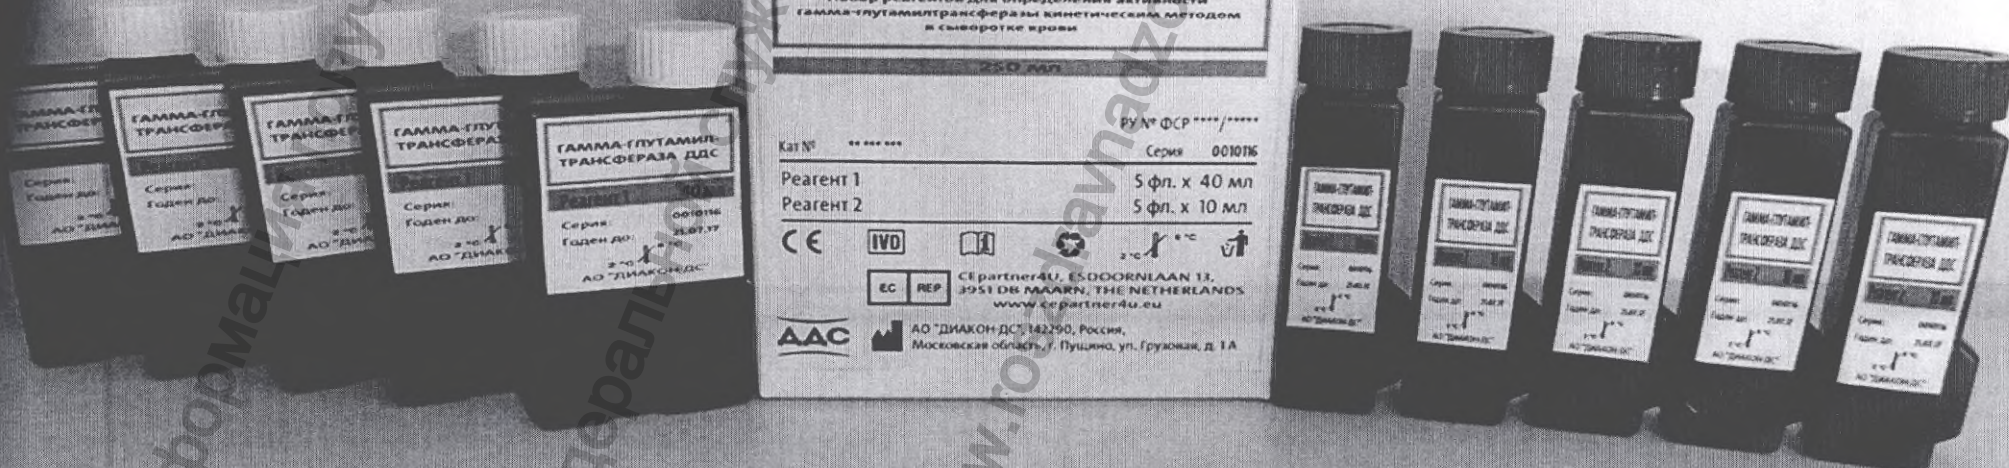

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 20

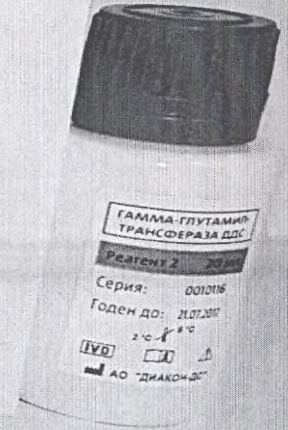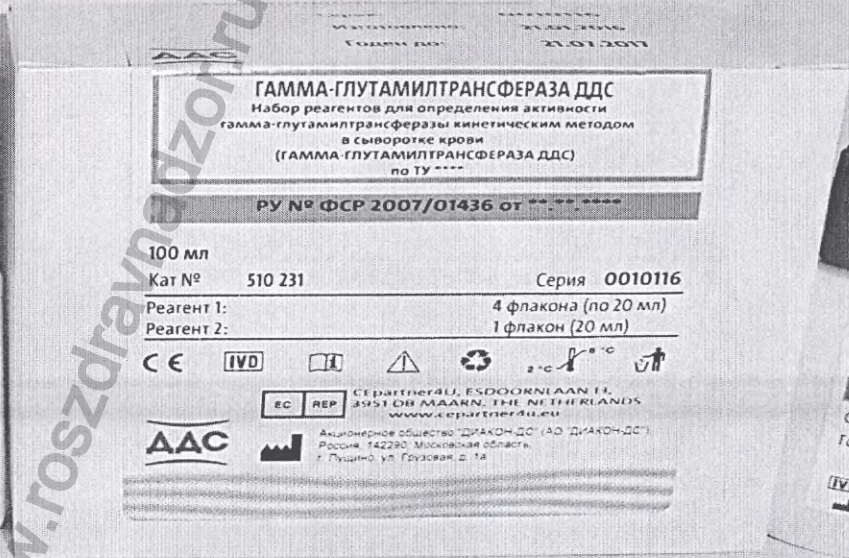

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 21



Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 22



Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)




Комплектация 23



Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови (ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 24

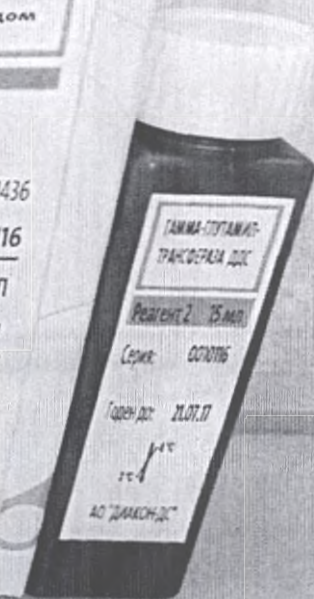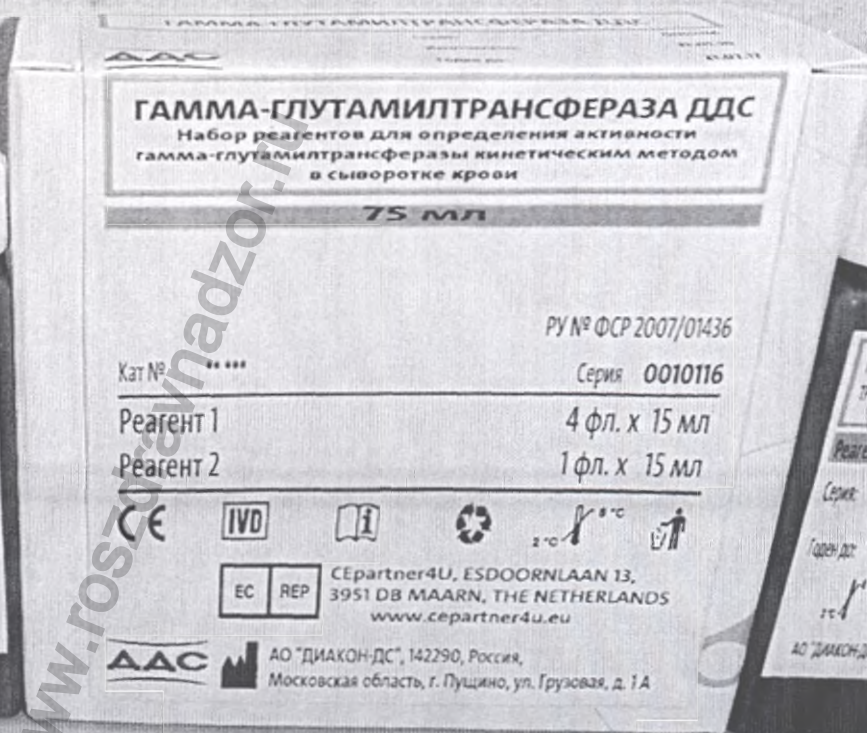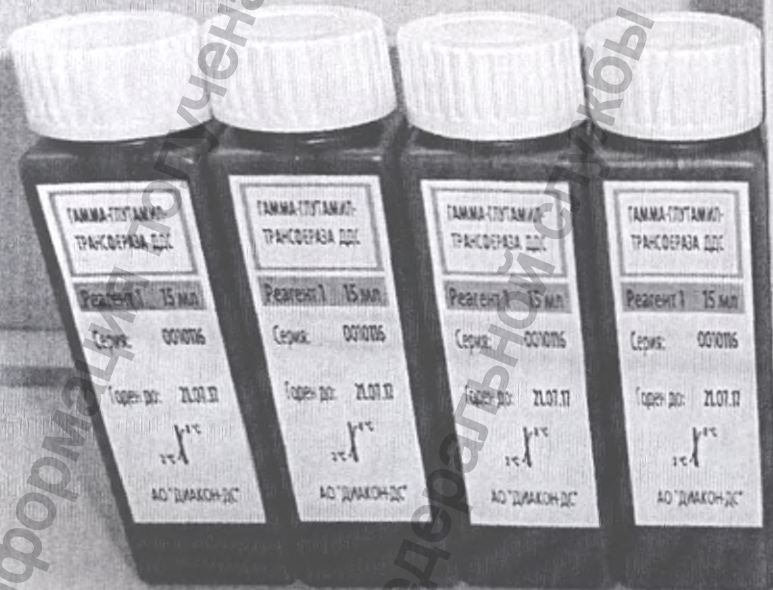



Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

ия 25

**ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
10000 мл  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
2°C  $\rightarrow$  8°C  
АО "ДИАКОН-ДС"







**ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС**


Срок:	0010116
Классификация:	Л.Р.В
Годен до:	21.07.17

**ААС**

**ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
Индикатор активности для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови

Код №:	РД-15444/85241
Срок:	0010116
Реагент 1:	1 x 10000 мл
Реагент 2:	1 x 2500 мл

CE, IVD,      

**ААС**  **ААС**


АО "ДИАКОН-ДС" ИСТОЧНИК: [www.diacon-ds.ru](http://www.diacon-ds.ru)  
Иркутская область, г. Улан-Удэ, ул. Сурганова, д. 7-Б

**ГАММА-ГЛУТАМИЛ-ТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
Серия: 0010116  
Годен до: 21.07.17  
АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид (комплектаций по РД-15444/85241 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 25

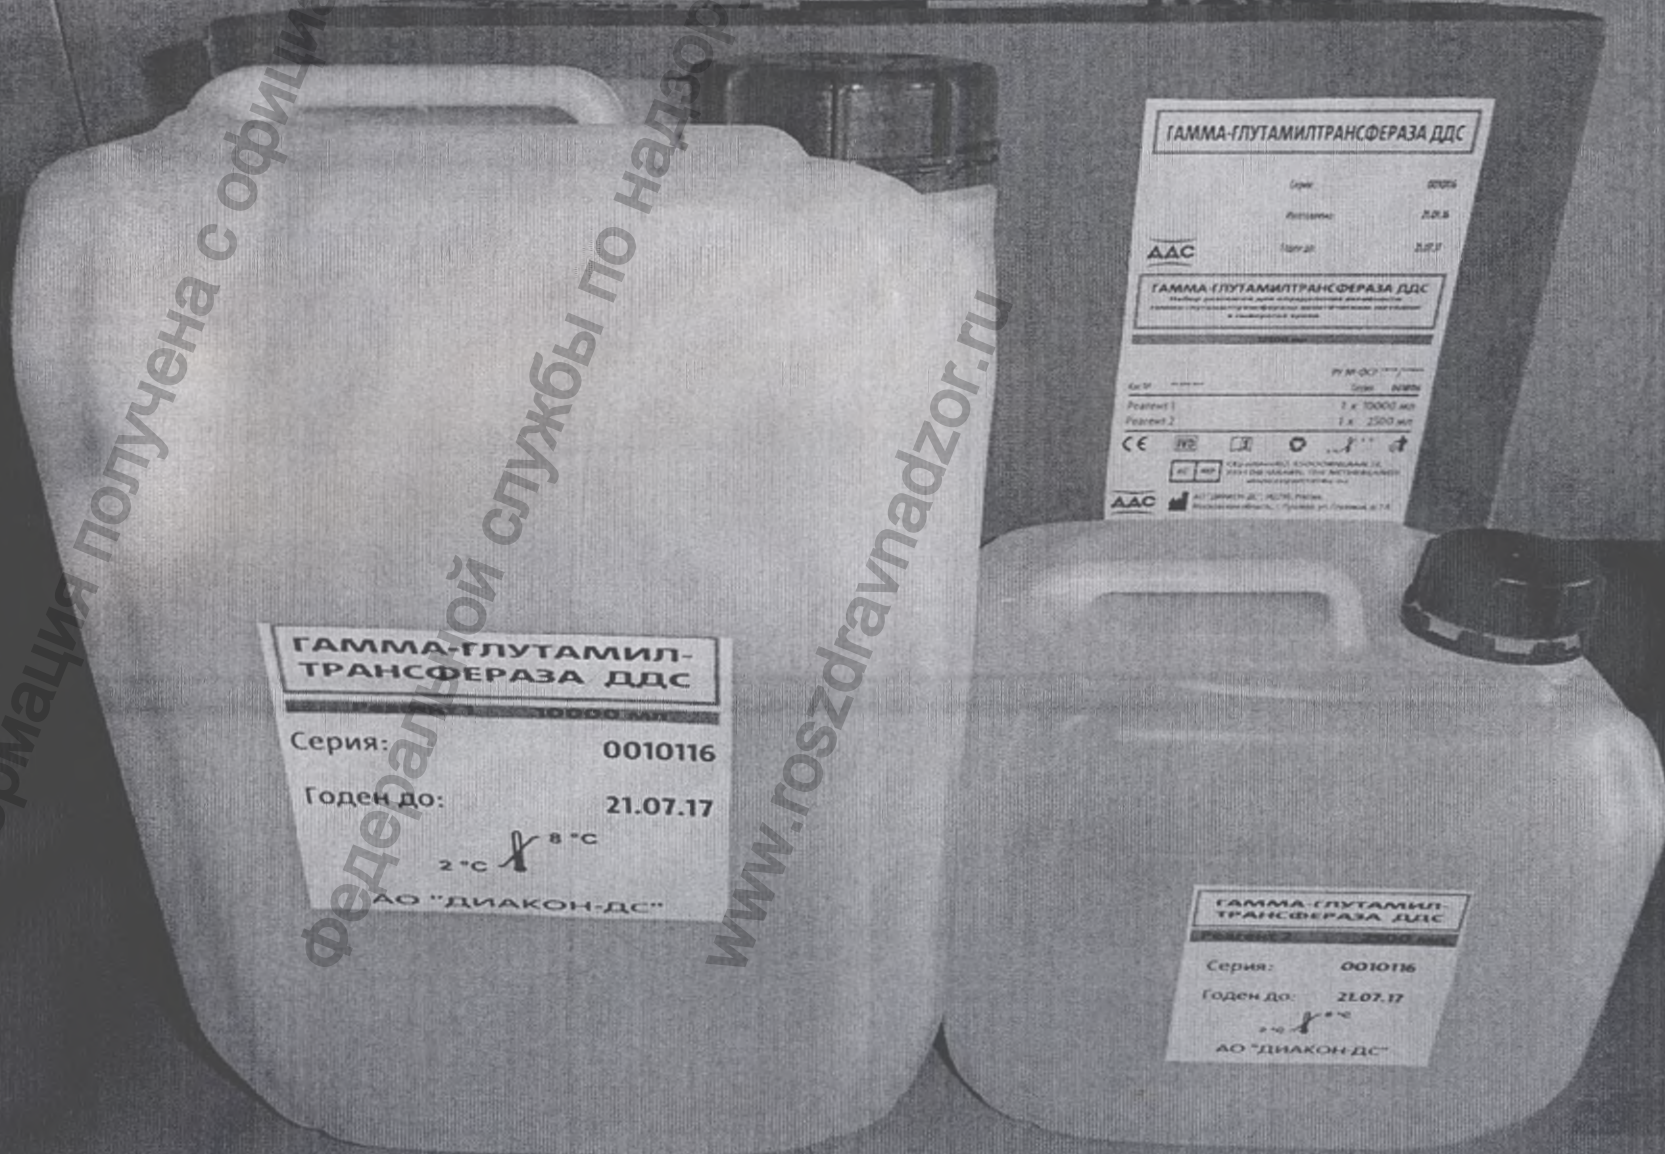

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере  
[www.roszdravnadzor.ru](http://www.roszdravnadzor.ru)

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 25




Генеральный директор  
АО «ДИАКОН-ДС»



 Т.Ю. Корзун


Внешний вид  
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 26

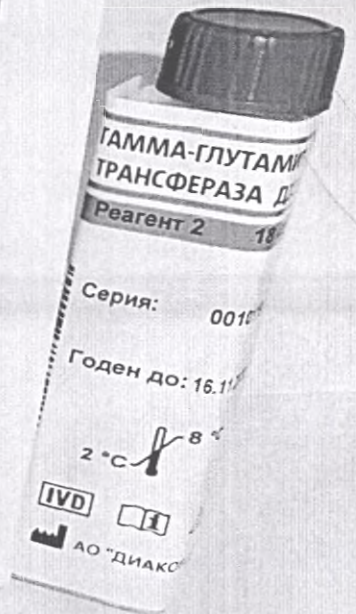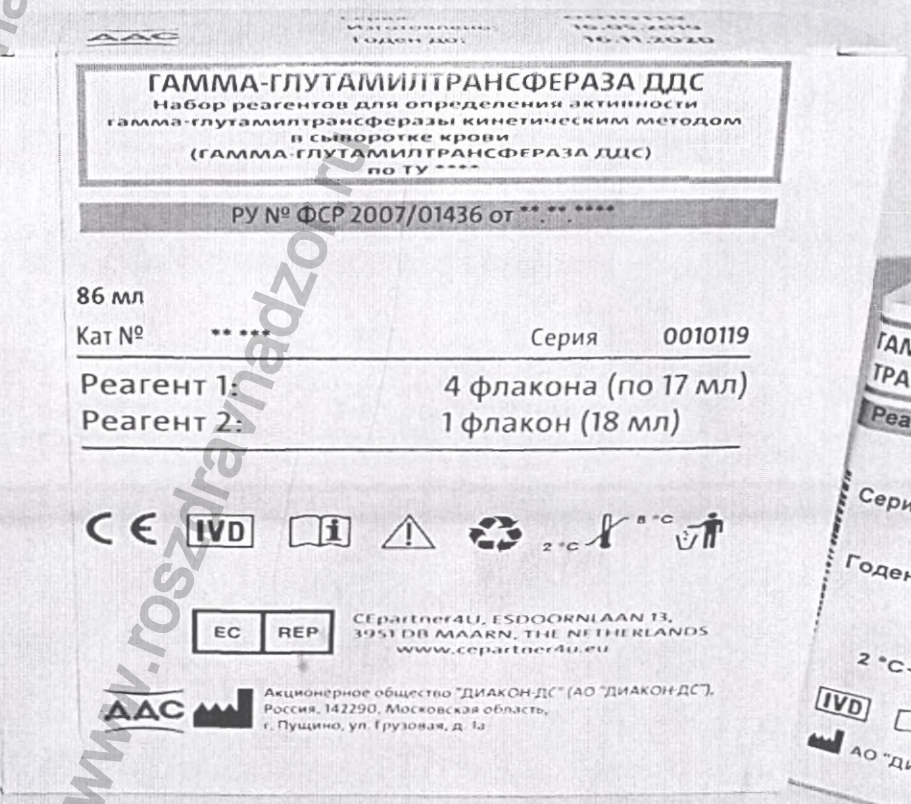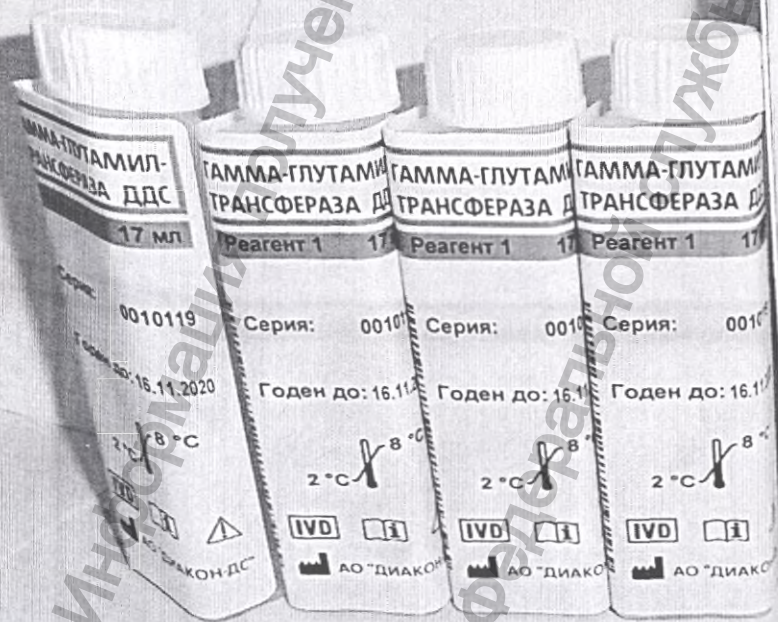

Внешний вид  
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

Комплектация 27

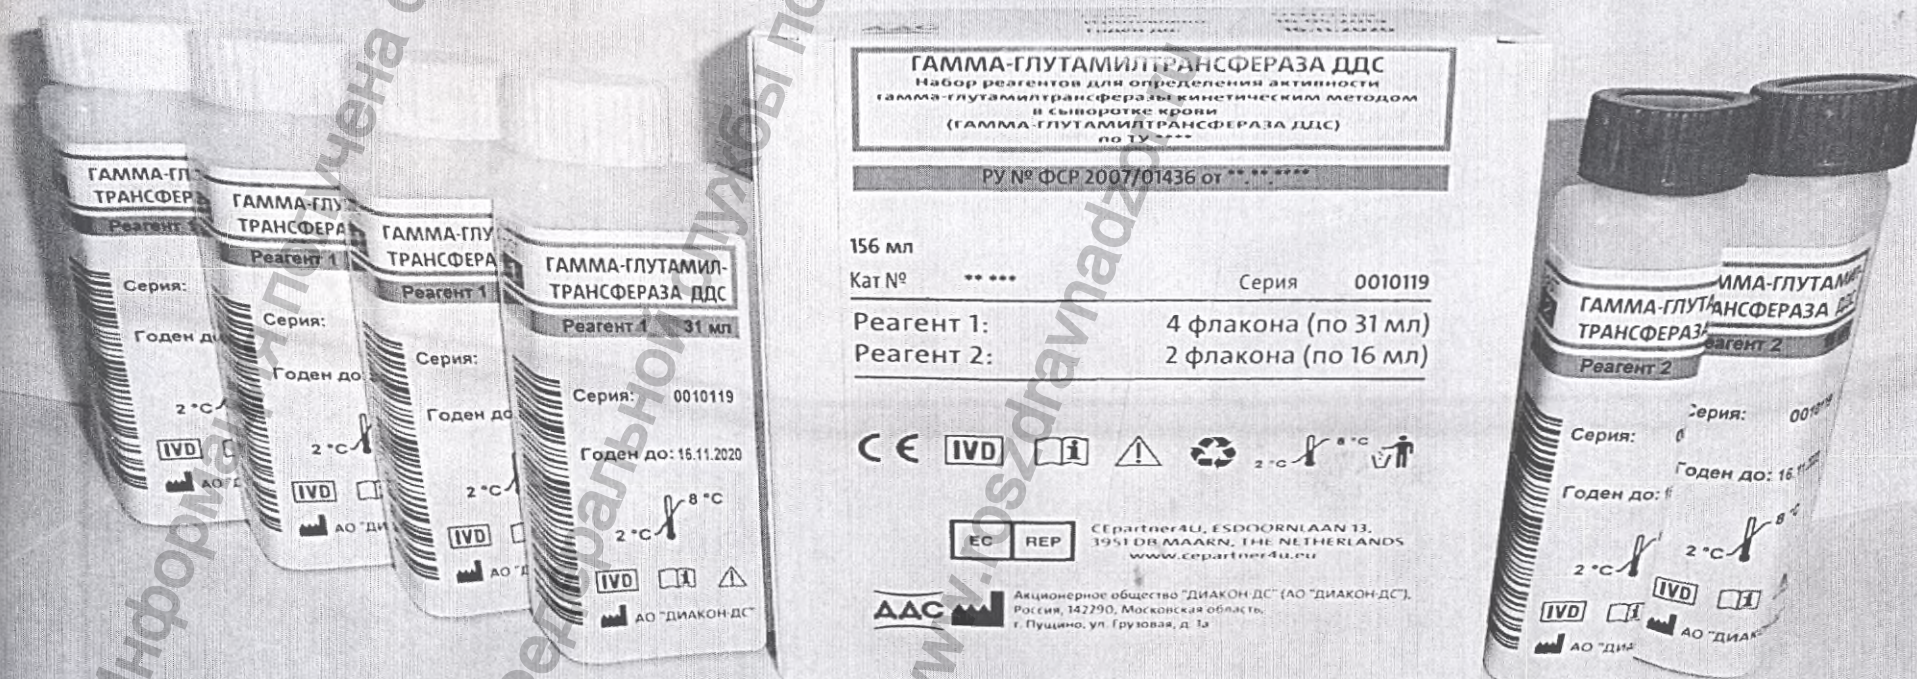

**ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
Набор реагентов для определения активности  
гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом  
в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)  
по ТУ \*\*\*\*\*

РУ № ФСР 2007/01436 от \*\* \*\* \*\*

156 мл  
Кат № \*\*\*\* Серия 0010119  
Реагент 1: 4 флакона (по 31 мл)  
Реагент 2: 2 флакона (по 16 мл)

CE IVD I I A 2°C 8°C


EC REP

Ce partner 4U, ESDOORNLAAN 13,  
3951 DR MAAKN, THE NETHERLANDS  
www.cepartner4u.eu

**ДАС** Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"),  
Рос (инв. 142290, Московская область,  
г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)  
Комплектация 1

Внешний вид

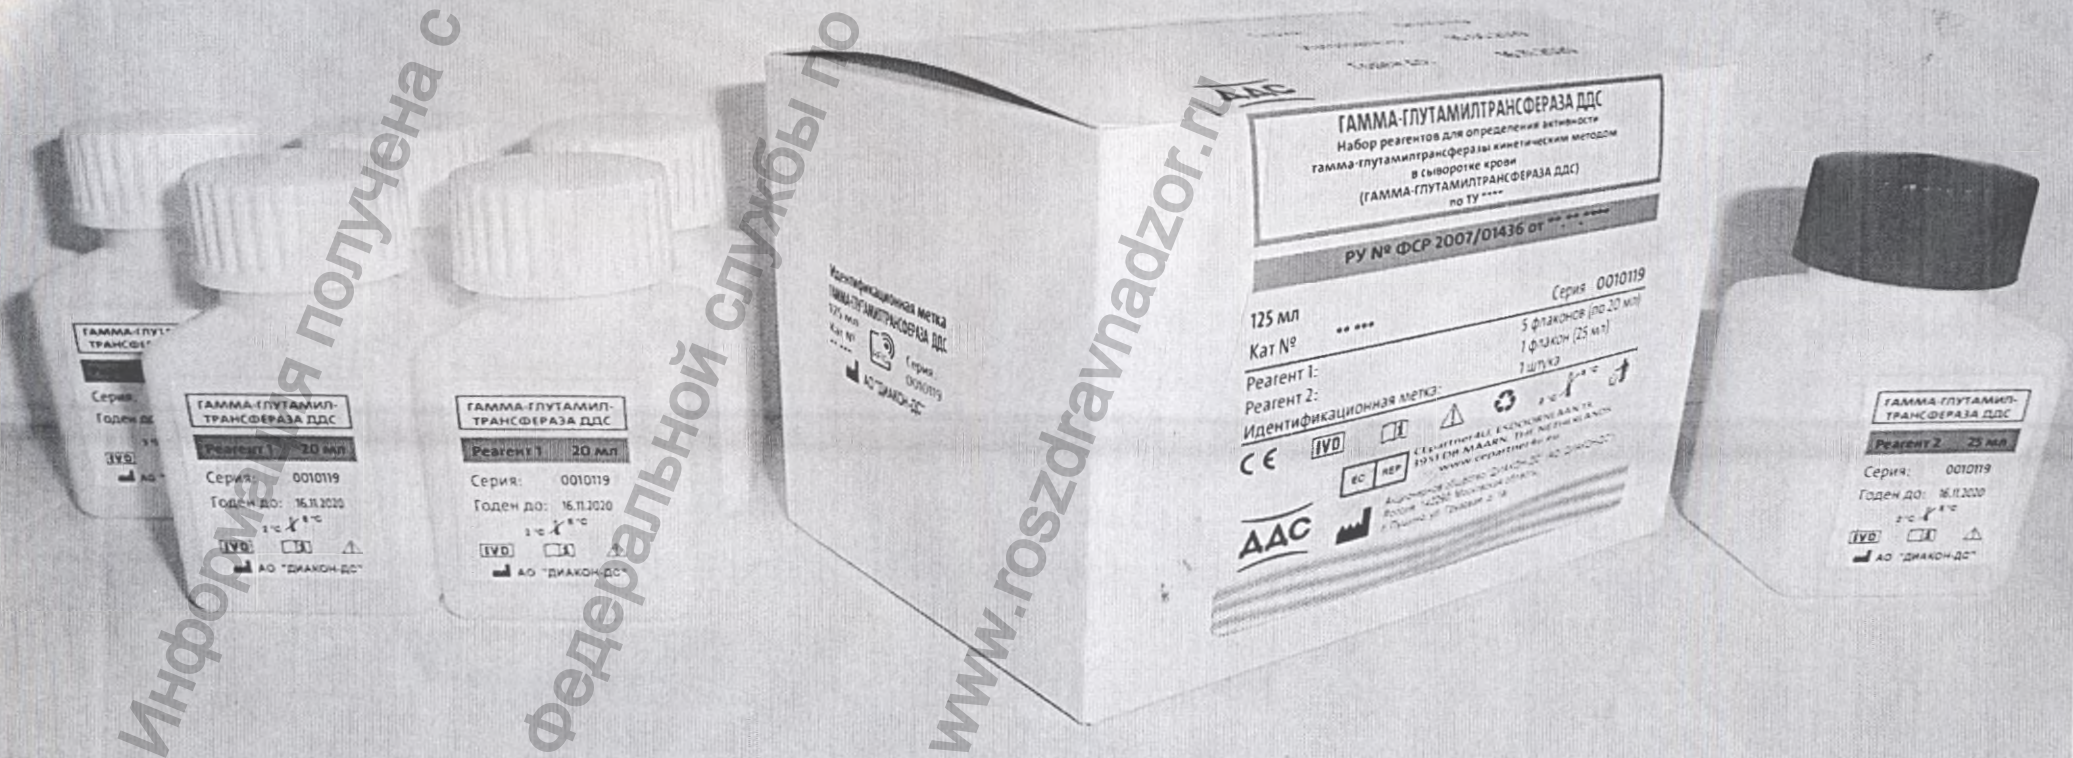

**ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС**  
Набор реагентов для определения активности  
гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом  
в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)  
по ту ----

ПУ № ФСР 2007/01436 от .....

125 мл  
Кат № .....

Реагент 1: .....  
Реагент 2: .....  
Идентификационная метка: .....

Серия: 0010119  
5 флаконов (по 20 мл)  
1 флакон (25 мл)  
1 штука

CE IVD


**ДДС**

Сертификат соответствия  
РОСТЕХНАДЗОР  
www.gosdrazhnadzor.ru

АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид  
Набора реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови  
(ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС)

2, Комплектация 2

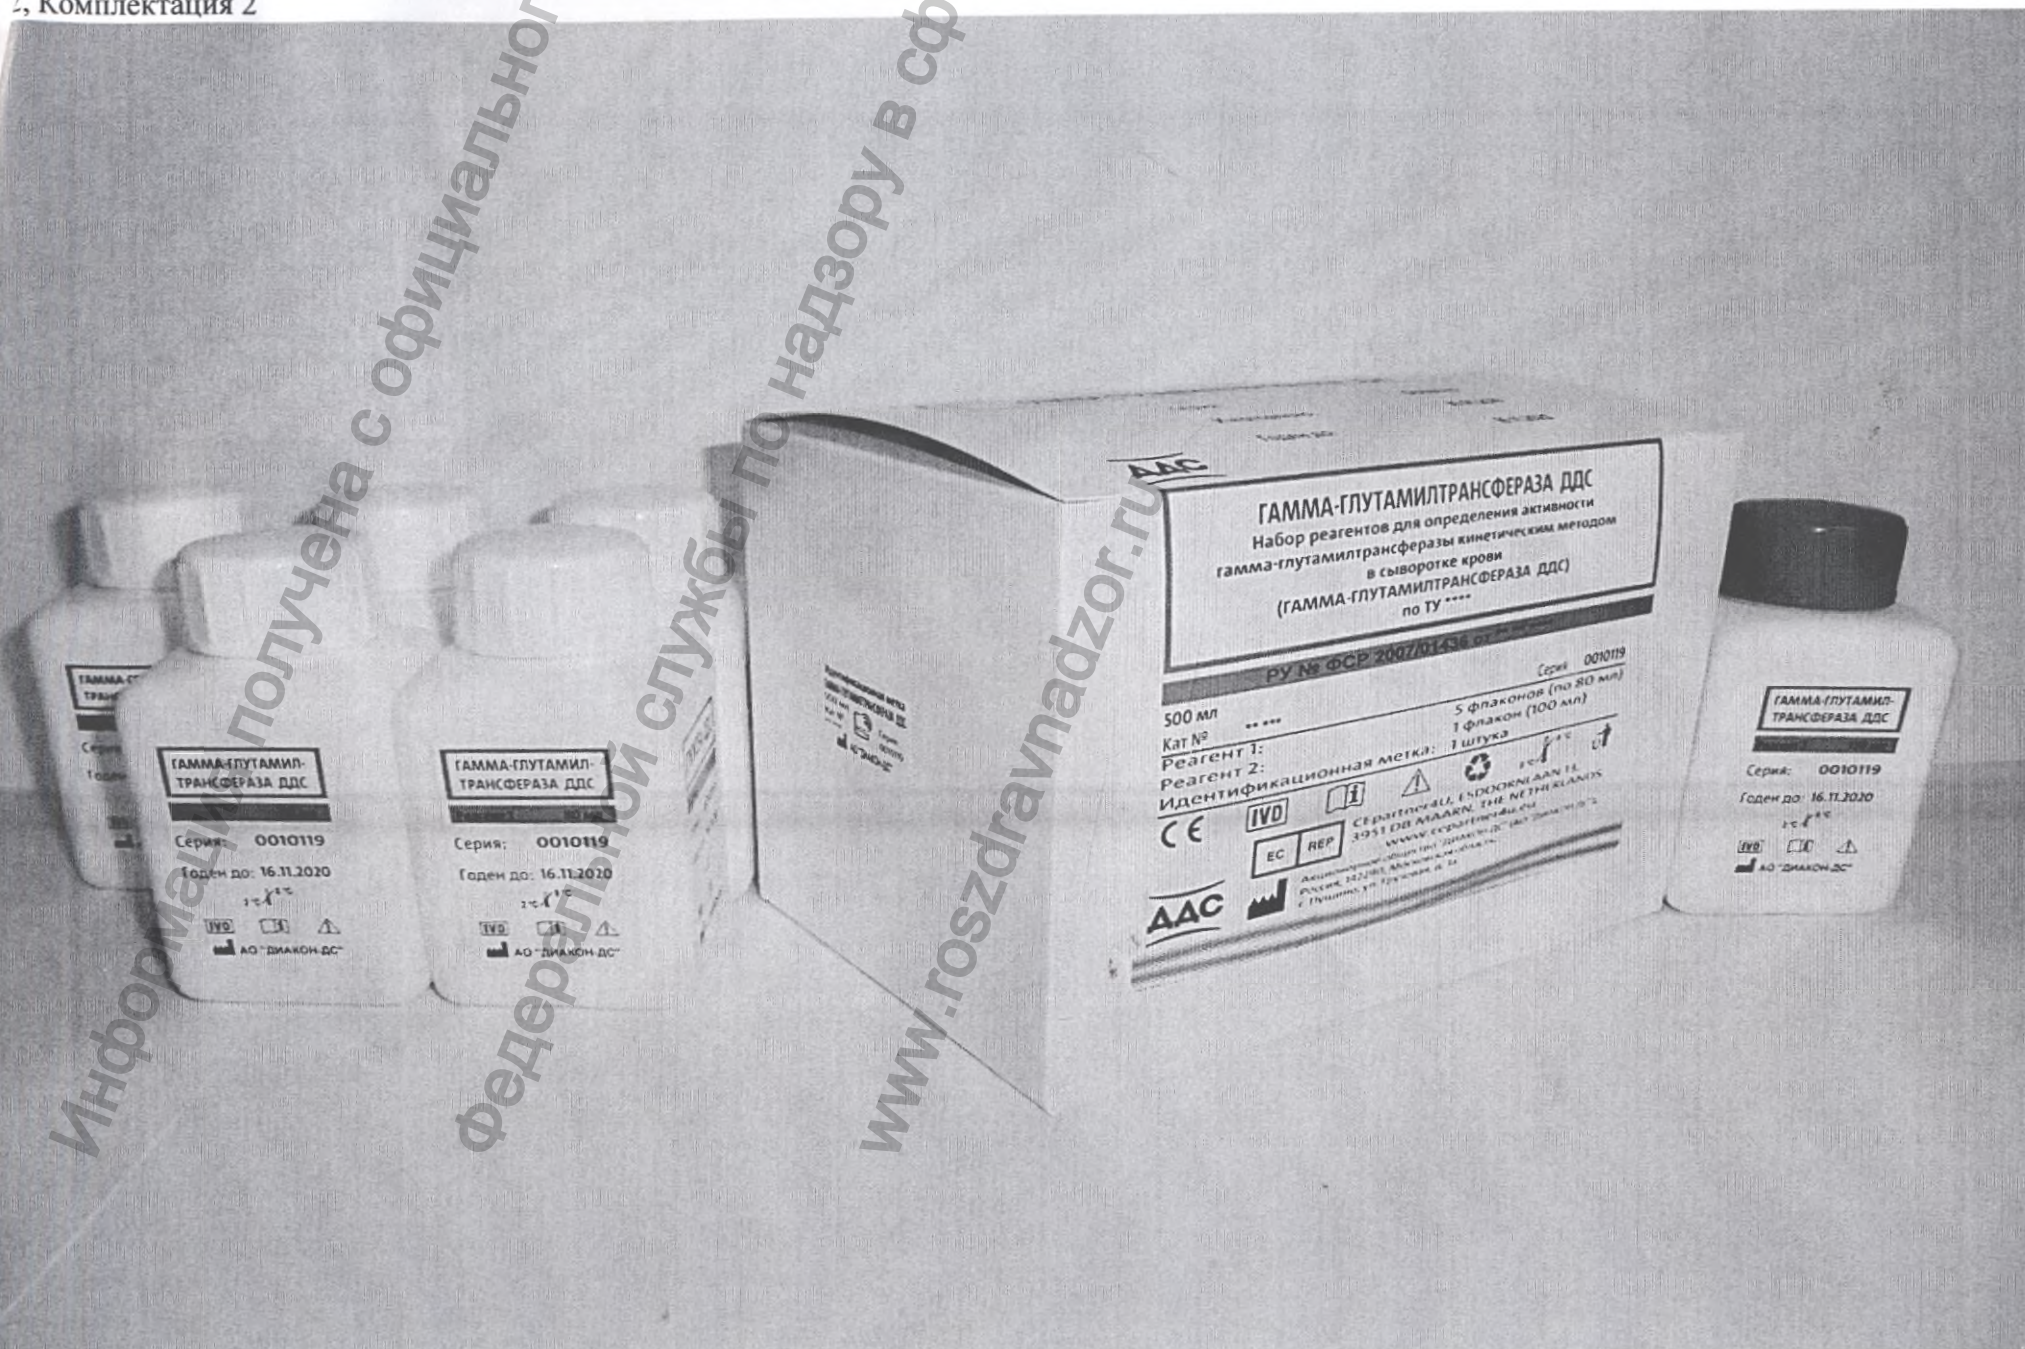

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере

www.goszdramnadzor.ru

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере  
[www.roszdravnadzor.ru](http://www.roszdravnadzor.ru)

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 4

Генеральный директор  
АО «ДИАКОН-ДС»



  
Т.Ю. Корзун